



Януари 2024 г.

Инструкции за употреба (наръчник) за QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2 Panel



Версия 2

За инвивто диагностика

За употреба с анализатори QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Rise

IVD

CE 0197

REF

691214



R1

QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden

Съдържание

Предвидена употреба	5
Кратко изложение и обяснение	6
Описание на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge	6
Информация за патогените	8
Принцип на процедурата	10
Описание на процедурата	10
Взимане на аликовотни части и зареждане на касетата	11
Приготвяне на аликовотни части, амплификация и откриване на нуклеинови киселини	13
Предоставени материали	14
Съдържание на набора	14
Необходими, но непредоставени материали	15
Предупреждения и предпазни мерки	16
Информация за безопасността	16
Предпазни мерки	17
Съхранение и работа с касетата	18
Работа с проби и тяхното съхранение и подготовка	18
Аликовотни части в течна транспортна среда	18
Аликовотни части със сух тампон	19
Вътрешна контрола	19
Протокол: Аликовотни части със сух тампон	20
Взимане, транспортиране и съхранение на аликовотни части	20
Зареждане на аликовотна част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge	20
Стартиране на тест на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0	24

Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Rise	31
Протокол: Аликовотни части в течна транспортна среда.....	46
Вземане, транспортиране и съхранение на аликовотни части.....	46
Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Analyzer 1.0	51
Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Rise	58
Приоритизиране на аликовотни части.....	71
Прекратяване на изпълняваща се аликовотна част	74
Интерпретиране на резултатите	77
Преглед на резултатите с QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0	77
Интерпретиране на резултатите с QIAstat-Dx Rise	89
Контрол на качеството	94
Ограничения	94
Работни характеристики	96
Клинични работни характеристики.....	96
Характеристики на анализа	104
Устойчивост на анализа.....	107
Ексклузивност (аналитична специфичност)	108
Инклузивност (аналитична реактивност)*	110
Коинфекции	114
Интерфериращи вещества	116
Пренасяне	117
Възпроизвеждимост	117
Стабилност на аликовотните части	124
Приложения	126
Приложение А: Инсталлиране на файла с дефиницията на анализа	126

Приложение В: Речник.....	129
Приложение С: Освобождаване от гаранции.....	131
Цитирани източници	132
Символи	133
Информация за поръчка	134
Хронология на редакциите на документа	136

Предвидена употреба

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel представлява качествен тест за наличие на вирусни или бактериални нуклеинови киселини, предназначен за анализиране на аликовотни части с назофарингеален тампон (Nasopharyngeal Swab, NPS) от пациенти, при които се подозира респираторна инфекция. The QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel може да приема както сухи тампони, така и аликовотни части в течна транспортна среда. Анализът е предназначен за употреба с QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise за интегрирано извлечане на нуклеинови киселини и откриване с мултиплексна real-time RT-PCR.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel открива и диференцира* SARS-CoV-2, грип A, грип A подтип H1N1/2009, грип A подтип H1, грип A подтип H3, грип B, коронавирус 229E, коронавирус HKU1, коронавирус NL63, коронавирус OC43, парагрипен вирус 1, парагрипен вирус 2, парагрипен вирус 3, парагрипен вирус 4, респираторен синцитиален вирус A/B, човешки метапневмовирус A/B, аденоовирус, бокавирус, риновирус/ентеровирус, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* и *Bordetella pertussis*.

* С QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel се откриват както ентеровирус, така и риновирус, но не се диференцират.

Резултатите от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel трябва да се интерпретират в контекста на всички приложими клинични и лабораторни констатации.

Работните характеристики на анализа са установени само за лица с респираторни симптоми.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е предназначен само за професионална употреба, а не за самоизследване.

За инвивто диагностика.

Кратко изложение и обяснение

Описание на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge представлява пластмасово изделие за еднократна употреба, което позволява извършване на напълно автоматизирани молекуларни анализи за откриване на респираторни патогени. Основните характеристики на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge включват съвместимост с респираторни аликовотни части върху сухи тампони (Copan® FLOQSwabs®, каталожен номер 503CS01) и аликовотни части в течна транспортна среда, херметично съхранение на предварително заредените реактиви, необходими за анализ, и напълно автономна работа. Всички стъпки за подготовка на аликовотната част и тестване на анализа се извършват в касетата.

Всички реактиви, необходими за цялостното изпълнение на теста, са предварително заредени и затворени в касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Не е необходимо потребителят да влезе в контакт с реактивите и/или да ги манипулира. По време на анализа реактивите се обработват в касетата в аналитичния модул на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise чрез пневматично направлявана микрофлуидика и не влизат в пряк контакт със задвижващите механизми. QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise имат въздушни филтри както за входящия, така и за изходящия въздушен поток, които допълнително предпазват околната среда. След теста касетата винаги остава херметически затворена, което значително улеснява безопасното ѝ депониране.

В касетата автоматично се извършват множество последователни стъпки, като се използва пневматично налягане за прехвърляне на аликовотните части и течностите през камерата за прехвърляне към целевите им местоположения.

След като QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с аликовотната част бъде поставена в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise, следните стъпки от анализа се изпълняват автоматично:

- Ресуспендиране на вътрешната контрола
- Клетъчно лизиране по механичен и/или химичен път
- Мембранно пречистване на нуклеинови киселини
- Смесване на пречистените нуклеинови киселини с лиофилизиирани реактиви от главната смес
- Преходвръляне на определените аликовоти от елюат/главна смес в различни реакционни камери
- Извършване на тестване с мултиплексна real-time RT-PCR във всяка реакционна камера

Забележка: Повишената флуоресценция, показваща откриване на целевия анализ, се открива директно във всяка реакционна камера.



Фигура 1. Външен вид на касета QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и нейните характеристики.

Информация за патогените

Острите респираторни инфекции може да бъдат причинени от различни патогени, включително бактерии и вируси, и обикновено се проявяват с почти неразличими клинични признания и симптоми. Бързото и точно определяне на наличието или отсъствието на потенциални причинители подпомага взимането на навременни решения относно лечението, приемането в болница, контрола на инфекциите и връщането на пациента на работа и сред семейството. Това може също така значително да помогне за подобряване на антимикробните дейности и други важни за общественото здраве инициативи.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge е касета за еднократна употреба, която съдържа всички реактиви, необходими за извлечение и амплификация на нуклеинови киселини и откриване на 23 вируса и бактерии (или техни подтипове), включително SARS-CoV-2*, които причиняват респираторни симптоми. Тестването изисква малък обем на аликовотната част и минимално време с участие на оператора, а резултатите се получават приблизително след един час.

* Целевият организъм на SARS-CoV-2 в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е проектиран в началото на 2020 г. при подавяне на първите налични 170 геномни последователности в публичните бази данни от SARS-CoV-2, определен като причинителя на епидемията от вирусна пневмония (COVID-19), възникната в Ухан, Хубей, Китай. Към днешна дата, покритие от повече от двадесет милиона налични геномни последователности поддържа инклузивността и добрите работни характеристики на откриване на SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 в този панел прицелва 2 гена на вирусния геном (Orf1b полиген (RdRp ген) и E гени), открити със същия флуоресцентен канал.

Патогените (и техните подтипове), които могат да се откриват и идентифицират с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, са изброени в Таблица 1.

Таблица 1. Патогени, открити с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel

Патоген	Класификация (геномен тип)
Грип А	Ортомиксовирус (РНК)
Грип А, подтип H1N1/2009	Ортомиксовирус (РНК)
Грип А подтип H1	Ортомиксовирус (РНК)
Грип А подтип H3	Ортомиксовирус (РНК)
Грип В	Ортомиксовирус (РНК)
Коронавирус 229E	Коронавирус (РНК)
Коронавирус HKU1	Коронавирус (РНК)
Коронавирус NL63	Коронавирус (РНК)
Коронавирус OC43	Коронавирус (РНК)
SARS-CoV-2	Коронавирус (РНК)
Парагрипен вирус 1	Парамиксовирус (РНК)
Парагрипен вирус 2	Парамиксовирус (РНК)
Парагрипен вирус 3	Парамиксовирус (РНК)
Парагрипен вирус 4	Парамиксовирус (РНК)
Респираторен синцитиален вирус A/B	Парамиксовирус (РНК)
Човешки метапневмовирус A/B	Парамиксовирус (РНК)
Аденовирус	Аденовирус (ДНК)
Бокавирус	Парвовирус (ДНК)
Риновирус/ентеровирус	Пикорнавирус (РНК)
Mycoplasma pneumoniae	Бактерия (ДНК)
Chlamydophila pneumoniae	Бактерия (ДНК)
Legionella pneumophila	Бактерия (ДНК)
Bordetella pertussis	Бактерия (ДНК)


Забележка: С QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel се откриват както ентеровирус, така и риновирус, но не се диференцират.

Принцип на процедурата

Описание на процедурата


Диагностичните тестове с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel се извършват на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise. Всички етапи на подготовка и анализ на аликовотните части се извършват автоматично от QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise. Аликовотни части се взимат и зареждат ръчно в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, в зависимост от вида на аликовотната част:

Опция 1: Поставяне на тампона в отвора за тампон, когато се използва аликовотна част със сух тампон (Фигура 2).

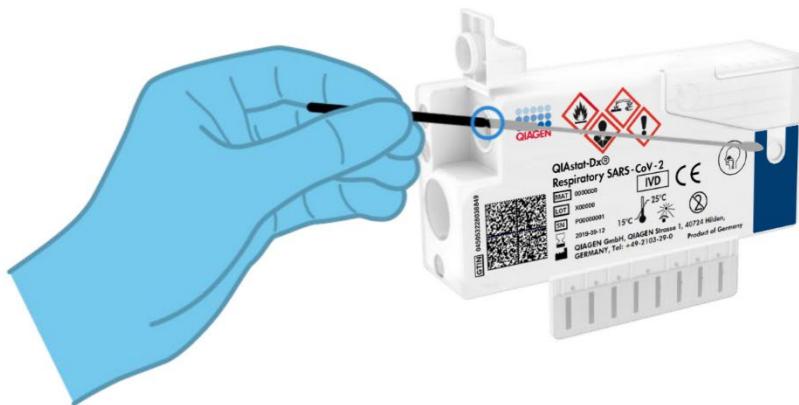

Фигура 2. Зареждане на аликовотната част със сух тампон в отвора за тампон.

Опция 2: Преносна пипета се използва за накапване на аликовотна част в течна транспортна среда в главния отвор (Фигура 3).

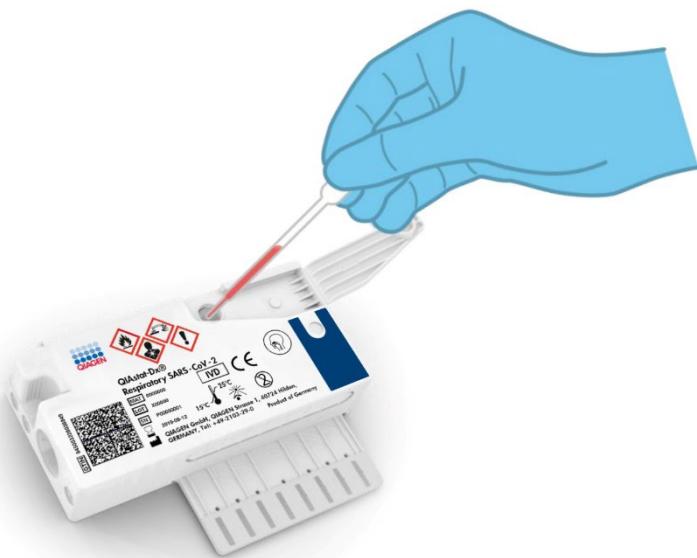

Фигура 3. Накапване на аликовотна част в течна транспортна среда в главния отвор.

Взимане на аликовотни части и зареждане на касетата


Взимането на аликовотни части и последващото им зареждане в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да се извършва от персонал, обучен за безопасна работа с биологични аликовотни части.

Включени са следните стъпки, които трябва да се изпълняват от потребителя:

1. Взима се аликовотна част с назофарингеален тампон за еднократна употреба.
2. Назофарингеалният тампон се поставя в епруветка за еднократна употреба, напълнена с транспортна среда само за аликовотните части в течна транспортна среда.

3. Информацията за аликовотната част се надписва ръчно или се закрепва етикет на аликовотната част върху QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.
4. Аликовотната част се зарежда ръчно в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge:
 - Аликовотна част със сух тампон: Аликовотната част с назофарингеален тампон се поставя в отвора за тампон на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.
 - Аликовотна част в течна транспортна среда: 300 µl от аликовотната част се накапват в главния отвор на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с една от включените преносни пипети.

ВАЖНО: Когато зарежда аликовотна част в течна транспортна среда, потребителят трябва да провери прозорчето (вижте следващата илюстрация), за да се увери, че течната аликовотна част е заредена (Фигура 4).

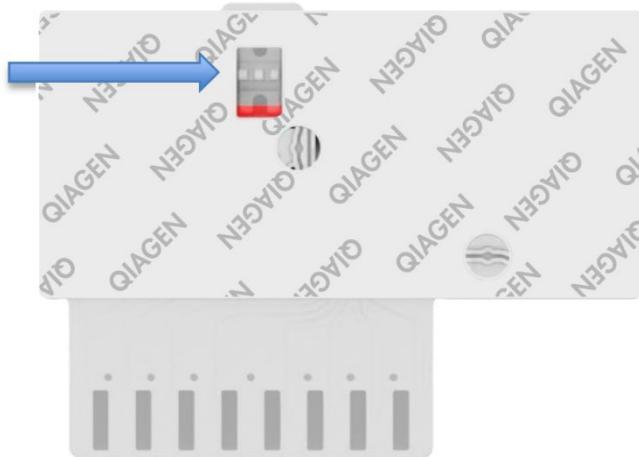

Фигура 4. Прозорче за проверка на аликовотната част (сина стрелка)

5. Баркодовете на аликовотната част и QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge се сканират в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 или QIAstat-Dx Rise.

6. Касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge се поставя в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 или QIAstat-Dx Rise.
7. Тестът се стартира на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 или QIAstat-Dx Rise.

Приготвяне на аликовотни части, амплификация и откриване на нуклеинови киселини

Извличането, амплификацията и откриването на нуклеинови киселини в аликовотната част се извършват автоматично от QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise.

1. Течната аликовотна част се хомогенизира и клетките се лизират в камерата за лизиране на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която съдържа ротор, въртящ се с висока скорост.
2. Нуклеиновите киселини се пречистват от лизираната аликовотна част чрез свързване със силициева мембрана в пречиствателната камера на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge при наличие на хаотропни соли и алкохол.
3. Пречистените нуклеинови киселини се елюират от мембранията в пречиствателната камера и се смесват с лиофилизираните чрез PCR химични вещества в камерата за сухи вещества на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.
4. Сместа от аликовотната част и реактивите за PCR се дозира в камерите за PCR на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, които съдържат лиофилизиирани, специфични за анализа праймери и сонди.
5. QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise създава оптимални температурни условия за провеждане на ефективна мултиплексна real-time RT-PCR и извършва флуоресцентни измервания в реално време за генериране на криви на амплификация.
6. Софтуерът на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise интерпретира получените данни и контроли на процеса и извежда фиш за теста.

Представени материали

Съдържание на набора

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	
Каталожен №	691214
Брой тестове	6
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge*	6
Transfer pipettes (Преносни пипети)†	6

* 6 поотделно опаковани касети, съдържащи всички реактиви, необходими за подготовка на аликовтни части и мултиплексна real-time RT-PCR, плюс вътрешна контрола.

† 6 поотделно опаковани преносни пипети за дозиране на течни аликовтни части в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

Необходими, но непредоставени материали

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е предназначен за използване с QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Rise. Преди да започнете тест, се уверете, че разполагате с:

- QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (поне един оперативен модул и един аналитичен модул) със софтуер версия 1.3 или по-нова* ИЛИ QIAstat-Dx Rise (за да работи апаратът, вътреш трябва да има поне два аналитични модула) със софтуер версия 2.2 или по-нова ИЛИ QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (поне един оперативен модул PRO и един аналитичен модул) със софтуер версия 1.6 или по-нова.
- *Ръководствата за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0* (да се използва с версия на софтуера 1.3 или по-нова) ИЛИ QIAstat-Dx Rise (да се използва с версия на софтуера 2.2 или по-нова) ИЛИ QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (да се използва с версия на софтуера 1.6 или по-нова)
- Последният софтуер за файлове с дефиниции на анализи QIAstat-Dx за респираторен панел SARS-CoV-2 Panel, инсталиран на оперативния модул или оперативния модул PRO

* Апарати DiagCORE® Analyzer със софтуер QIAstat-Dx версия 1.3 или по-нова могат да се използват като алтернатива на апаратите QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Забележка: Приложен софтуер версия 1.6 или по-висока не може да се инсталира на QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Предупреждения и предпазни мерки

За инвирто диагностика.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel трябва да се използва от лабораторни специалисти, обучени да използват QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, имайте предвид, че QIAstat-Dx Rise може да борави с до 18 касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge едновременно в рамките на входното отделение. Моля, имайте предвид също, че със софтуерна версия 2.2 или по-нова във входното отделение могат едновременно да се поставят и обработват различни панели.

Информация за безопасността

При работа с химикали винаги носете подходяща лабораторна престилка, ръкавици за еднократна употреба и защитни очила. За повече информация вижте съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ). Те са достъпни онлайн в PDF формат на www.qiagen.com/safety, където можете да намерите, прегледате и отпечатате информационния лист за безопасност (Safety Data Sheet, SDS) за всеки набор QIAGEN и неговите компоненти.

Третирайте всички аликовотни части, използвани касети и преносни пипети като агенти, пренасящи инфекции. Винаги съблюдавайте предпазните мерки, описани в съответните насоки, като например *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guidelines* (M29) (Зашита на лаборантите от професионално придобити инфекции, одобрени насоки M29) на Института за клинични и лабораторни стандарти (Clinical and Laboratory Standards Institute®, CLSI) или други подходящи документи, предоставени от:

- OSHA®: Occupational Safety and Health Administration (Администрация по безопасност и здраве при работа) (Съединени американски щати)
- ACGIH®: American Conference of Government Industrial Hygienists (Американска конференция на държавните индустритални хигиенисти САЩ)

- COSHH: Control of Substances Hazardous to Health (Контрол на опасни за здравето вещества) (Обединено кралство)

Спазвайте процедурите за безопасност на заведението си относно работа с биологични проби. Изхвърляйте аликовотните части, касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и преносните пипети съгласно съответните разпоредби.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge е затворено изделие за еднократна употреба, което съдържа всички реактиви, необходими за подготовка на аликовотни части и мултиплексна real-time RT-PCR в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise. Не използвайте QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която е с изтекъл срок на годност, изглежда повредена или изпуска течност. Изхвърляйте използваните или повредени касети в съответствие с всички национални, щатски и местни разпоредби и закони за здравето и безопасността.

Спазвайте стандартните лабораторни процедури за поддържане на работното място чисто и стерилно. Посочени са указания в публикации като Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (<https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/networks/disease-and-laboratory-networks/erlinet-biosafety>).

Предпазни мерки

Следните предупреждения за опасност и мерки за безопасност се отнасят за компонентите на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.



Съдържа: етанол; гуанидин хидрохлорид; гуанидин тиоцианат; изопропанол; протеиназа K; t-октилфеноксиолиетоксигетанол. Опасно! Силно запалими течност и пари. Вреден при погъщане или вдишване. Може да бъде вреден при контакт с кожата. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика сънливост или световрътеж. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. При контакт с киселини отделя силно токсичен газ. Има разядващо действие върху дихателните пътища. Да се лази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Пушенето забранено. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Носете средства за защита на дихателните пътища. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Продължавайте да промивате. ПРИ ЯВНА или предполагаема експозиция: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Съхранение и работа с касетата

Съхранявайте касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge на сухо, чисто място при стайна температура (15-25°C). Не изваждайте касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge или преносните пипети от отделните опаковки преди момента на употреба. При тези условия касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge могат да се съхраняват до датата на изтичане на срока на годност, отпечатана върху отделната опаковка. Датата на изтичане на срока на годност също е включена в баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и се прочита от QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 или QIAstat-Dx Rise, когато касетата бъде поставена в апарат за изпълнение на тест.

За работа с повредени касети вижте глава Информация за безопасността.

Работа с проби и тяхното съхранение и подготовка

Аликовтни части в течна транспортна среда

Аликовтни части с назофарингеален тампон трябва да се взимат и обработват според инструкциите на производителя.

Препоръчителните условия за съхранение на проби с NPS (назофарингеални тампони), ресуспендирали в универсална транспортна среда (Universal Transport Medium, UTM), са изброени по-долу:

- До 4 часа при стайна температура 15-25°C
- До 3 дни в хладилник при 2-8°C
- До 30 дни замразени от -25 до -15°C

Аликовотни части със сух тампон

Използвайте прясно взети проби със сух тампон за най-добра ефективност на теста. Ако непосредственото тестване не е възможно и с цел запазване на най-добрата ефективност, по-долу са изброени препоръчителните условия на съхранение на сухи тампони:

- До 45 минути при стайна температура 15-25°C
- До 7 часа в хладилник при 2-8°C

Вътрешна контрола

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge съдържа вътрешна контрола за цялата обработка, титрувана като бактериофаг MS2. Бактериофагът MS2 е вирус с едноверижна РНК, който е включен в касетата в сушено състояние и се рехидратира при зареждане на аликовотна част. Този материал на вътрешната контрола проверява всички стъпки от аналитичния процес, включително ресуспендиране/хомогенизиране на аликовотната част, лизиране, пречистване на нуклеиновите киселини, обратна транскрипция и PCR.

Положителен сигнал за вътрешната контрола показва, че всички стъпки на обработка, извършени от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, са успешни.

Отрицателният сигнал за вътрешната контрола не анулира положителните резултати за откритите и идентифицираните целеви организми, но прави невалидни всички отрицателни резултати в анализа. Затова, ако сигналът за вътрешната контрола е отрицателен, тестът трябва да се повтори.

Протокол: Аликовотни части със сух тампон

Взимане, транспортиране и съхранение на аликовотни части

Аликовотни части с назофарингеален тампон се взимат с тампони Copan FLOQSwabs (каталожен номер 503CS01) по указаните от производителя процедури.

Зареждане на аликовотна част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

Забележка: приложим за QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise

1. Отворете опаковката на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge по перфорациите от двете страни (Фигура 5).

ВАЖНО: След като се отвори опаковката, аликовотната част трябва да се вкара в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и да се зареди в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 в рамките на 120 минути, или в QIAstat-Dx Rise в рамките на 30 минути.



Фигура 5. Отваряне на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

2. Извадете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge от опаковката и я поставете с баркода към Вас.
3. Ръчно надпишете или залепете етикет с информация за аликовтната част върху QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Уверете се, че етикетът е поставен правилно и не закрива отвора на капака (Фигура 6). Вижте раздела с работна процедура на QIAstat-Dx Rise за правилно етикетиране на касетата.



Фигура 6. Поставяне на информация за аликовтната част от горната страна на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

4. Отворете капака на отвора за аликовтна част с тампон от лявата страна на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (Фигура 7).




Фигура 7. Отваряне на капака на отвора за аликовтна част с тампон.

5. Поставете тампона в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, така че отметката да се изравни с отвора за достъп (тампонът няма да влезе по-навътре) (Фигура 8).



Фигура 8. Поставяне на тампон в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

6. Счупете клечката на тампона при отметката и оставете останалата част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (Фигура 9).

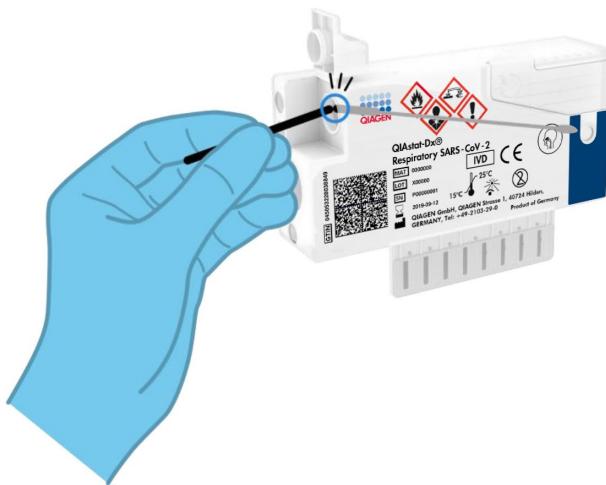

Фигура 9. Счупване на клечката на тампона.

7. Затворете добре капака на отвора за аликовотна част с тампон, така че да щракне (Фигура 10).

ВАЖНО: След като аликовотната част бъде поставена в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, касетата трябва да се зареди в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 в рамките на 90 минути, или да се постави върху таблата на QIAstat-Dx Rise, веднага след като всички аликовотни части бъдат заредени в касетите. Максималното време за изчакване за касета, която вече е заредена в QIAstat-Dx Rise (стабилност след зареждане в апарат) е около 300 минути. QIAstat-Dx Rise автоматично ще засече и ще предупреди потребителя, ако касетата е стояла в апарат по-дълго време от разрешеното.



Фигура 10. Затваряне на капака на отвора за аликовотна част с тампон.

Стартиране на тест на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0

1. Включете QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 с бутона за включване/изключване отпред на апаратта.
- Забележка:** Превключвателят на захранването в задната част на аналитичния модул трябва да бъде в положение „I“. Индикаторите за състояние на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще станат сини.
2. Изчакайте, докато се покаже **основният** еcran и индикаторите за състоянието на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 светнат в зелено и престанат да мигат.
3. Влезте в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, като въведете потребителско име и парола.
Забележка: Екранът **Login** (Влизане) ще се покаже, ако **User Access Control** (Контрол на потребителския достъп) е активиран. Ако **User Access Control** (Контрол на достъпа на потребителите) е деактивиран, няма да е необходимо потребителско име/парола и ще се покаже **основният** еcran.
4. Ако софтуерът за файлове с дефиниции на анализи не е инсталиран на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, изпълнете инструкциите за инсталациите, преди да изпълните теста (вижте „Приложение A: Инсталация на файла с дефиницията на анализа“ за допълнителна информация).
5. Натиснете бутона **Run Test** (Изпълнение на тест) в горния десен ъгъл на сензорния еcran на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
6. Когато получите указание, сканирайте баркода с идентификатора на аликвотната част с назофарингеален тампон (от блистера на тампона) или баркода с информация за пробата отгоре на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (вижте стъпка 3) с вградения преден баркод четец на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (Фигура 11).
Забележка: Можете също така да въведете идентификатора на аликвотната част с виртуалната клавиатура на сензорния еcran, като изберете полето **Sample ID** (Идентификатор на аликвотната част).

Забележка: В зависимост от избраната системна конфигурация може също така в този момент да се наложи да въведете идентификатора на пациента.

Забележка: Инструкциите от QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 се показват в лентата с инструкции в долната част на сензорния еcran.



Фигура 11. Сканиране на баркод с идентификатора на аликовтната част.

7. Когато получите указание, сканирайте баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която ще се използва (Фигура 12). QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично разпознава анализа, който ще се изпълнява, според баркода на касетата.

Забележка: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 не приема касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с истекъл срок на годност, вече използвани касети или касети за анализи, които не са инсталирани в апаратъа. В тези случаи ще се покаже съобщение за грешка и QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge ще бъде отхвърлена. Повече подробности за инсталирането на анализи ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0*.




Фигура 12. Сканиране на баркода на QiAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

8. Изберете съответния тип аликовотна част от списъка (Фигура 13).

administrator	Run Test Module 1	14:43 2017-03-30
1 UI administrator Resp Panel	2 Not installed	3 Not installed
TEST DATA	SAMPLE TYPE	
Sample ID 2430362	Swab	4 Not installed
Assay Type RP SARS-Co	UTM	
Sample Type		
	Select Sample Type	<input type="button" value="Cancel"/>

Фигура 13. Избор на типа на аликовотна част.

9. Ще се покаже екранът **Confirm** (Потвърждаване). Прегледайте въведените данни и направете необходимите промени, като избирате съответните полета на сензорния екран и редактирате информацията.
10. Когато всички показани данни са правилни, натиснете **Confirm** (Потвърждаване). Ако е необходимо, натиснете съответното поле, за да редактирате съдържанието му, или изберете **Cancel** (Отмяна), за да отмените теста (Фигура 14).

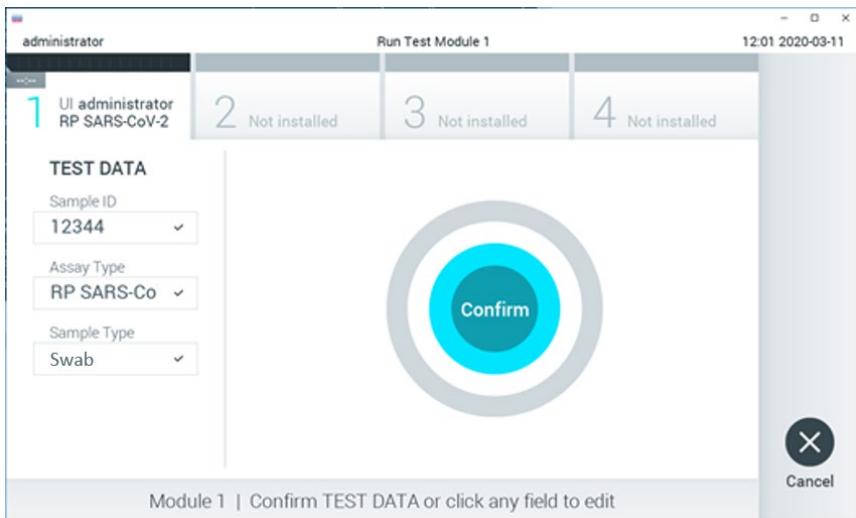

Фигура 14. Потвърждаване на въведени данни.

11. И двата капака за аликовотна част – на отвора за тампон и главния отвор – на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да бъдат здраво затворени. Когато входът за поставяне на касети отгоре на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 се отвори автоматично, поставете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с баркода отляво и реакционните камери отдолу (Фигура 15).

Забележка: Не е необходимо да поставяте QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Поставете я правилно във входа за поставяне на касети и QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично ще я придвижи в аналитичния модул.



Фигура 15. Поставяне на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

12. След като установи наличието на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично ще затвори капака на входа за поставяне на касети и ще стартира изпълнението на теста. За стартиране на цикъла не е необходимо допълнително действие от оператора.

Забележка: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Analyzer 2.0 няма да приемат QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която не е била използвана и сканирана при подготовката на теста. Ако е поставена касета, различна от сканираната, ще се генерира грешка и касетата автоматично ще бъде извадена.


Забележка: До този момент можете да отмените изпълнението на теста, като натиснете бутона **Cancel** (Отмяна) в долния десен ъгъл на сензорния екран.

Забележка: В зависимост от системната конфигурация може да е необходимо операторът отново да въведе потребителската парола, за да стартира изпълнението на теста.

Забележка: Капакът на входа за поставяне на касети ще се затвори автоматично след 30 секунди, ако във входа не бъде поставена QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Ако това се случи, повторете процедурата, като започнете от стъпка 16.

13. Докато се изпълнява тестът, оставащото време от изпълнението се показва на сензорния екран.
14. След като тестът бъде изпълнен, ще се покаже екранът **Eject** (Изваждане) (Фигура 16) и на лентата за състоянието на модулите ще се покаже резултатът от теста в един от следните варианти:
 - **TEST COMPLETED (ТЕСТЪТ Е ЗАВЪРШЕН):** Тестът е изпълнен успешно
 - **TEST FAILED (ТЕСТЪТ Е НЕУСПЕШЕН):** По време на теста е възникнала грешка
 - **TEST CANCELED (ТЕСТЪТ Е ОТМЕНЕН):** Потребителят е отменил теста

ВАЖНО: Ако тестът е неуспешен, в раздела „Отстраняване на проблеми“ в Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще намерите възможните причини и инструкции относно това как да продължите.

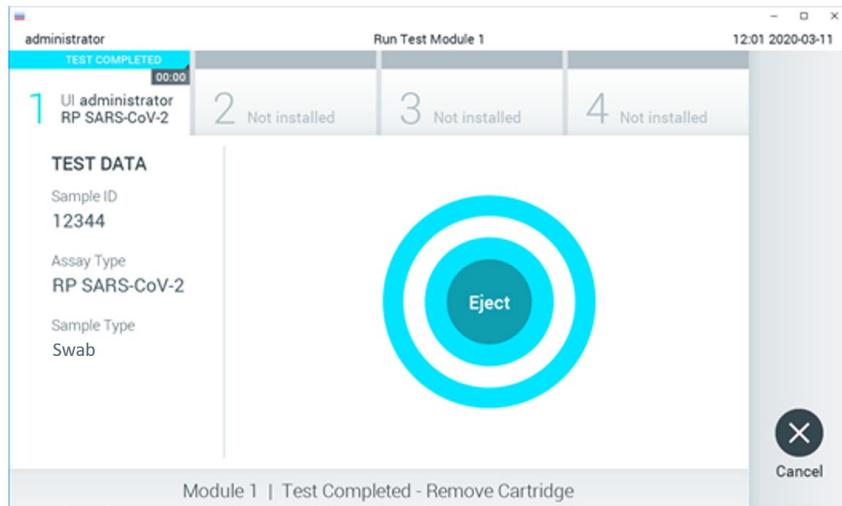

Фигура 16. Екран „Еject“ (Изваждане).

15. Натиснете  **Eject** (Изваждане) на сензорния екран, за да извадите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и я депонирайте като биологично опасен отпадък в съответствие с всички национални, щатски и местни нормативни разпоредби за здравето и безопасността. QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да се изведи, когато входът за поставяне на касети се отвори и извади касетата. Ако касетата не бъде извадена след 30 секунди, тя автоматично ще влезе обратно в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и капакът на входа за поставяне на касети ще се затвори. Ако това стане, натиснете **Eject** (Изваждане), за да отворите отново капака на входа за поставяне на касети, след което извадете касетата.

ВАЖНО: Използваните касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да се изхвърлят. Не може да се използват повторно касети за тестове, чието изпълнение е започнало, но след това е отменено от оператора, или за които е открита грешка.

16. След като QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge бъде извадена, ще се покаже екранът **Summary** (Резюме) с резултатите. Повече подробности ще намерите в „Интерпретиране на резултатите“. За да започнете процедурата за изпълнение на друг тест, натиснете **Run Test** (Изпълнение на тест).

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.


Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 2.0*.

Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Rise

Забележка: Фигурите в този раздел са само ориентировъчни и може да се различават при различните анализи.

Стартиране на QIAstat-Dx Rise

1. Натиснете бутона **ON/OFF** (Включване/Изключване) върху предния панел на QIAstat-Dx Rise, за да стартирате апаратата.
- Забележка:** Превключвателят на захранването в задната лява съединителна кутия трябва да бъде в положение „I“.
2. Изчакайте, докато се покаже еcranът за вход и светодиодните индикатори за състоянието станат зелени.
3. Влезте в системата, след като се появи еcranът за вход.

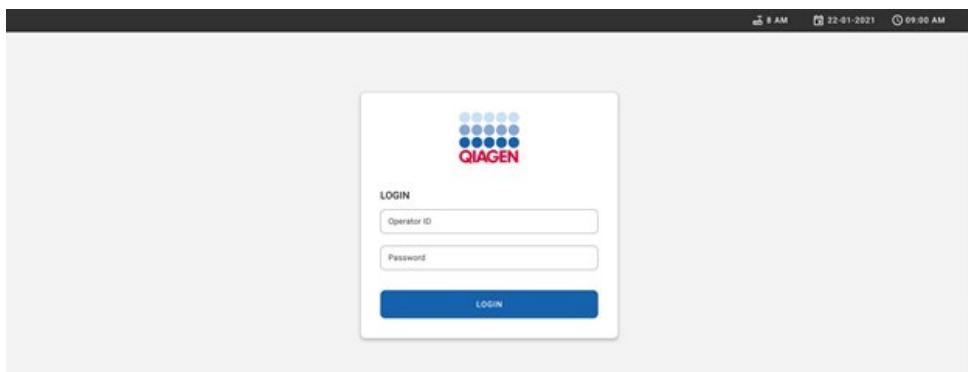

Фигура 17. Log in (Екран) за вход

Забележка: След успешното първоначално инсталиране на QIAstat-Dx Rise, системният администратор трябва да влезе в системата за първото конфигуриране на софтуера.

Подготовка на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

Извадете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge от опаковката. За подробности относно добавянето на аликовотната част към касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и за конкретна информация относно анализа, който ще се изпълнява, вижте „Зареждане на аликовотна част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge“.

След добавянето на аликовотната част в касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и двета капака за аликовотна част трябва да бъдат здраво затворени.

Добавяне на баркод на аликовотната част към QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

Поставете баркод върху горната дясна страна на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (обозначена със стрелката).



Фигура 18. Поставяне на баркод с идентификатор на аликовотна част

Максималният размер на баркода е: 22 mm x 35 mm. Баркодът винаги трябва да е от дясната страна на касетата (както е показано по-горе с червената маркирана зона), тъй като лявата страна на касетата е от решаващо значение за автоматичното откриване на аликовотната част (Фигура 19).

Забележка: За да обработвате аликовотни части на QIAstat-Dx Rise, е необходимо да поставите машинно четим баркод с идентификатора на аликовотната част върху QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.



Фигура 19. Разполагане на баркод с идентификатор на аликовотна част

Могат да бъдат използвани 1D и 2D баркодове. Използваемите 1D баркодове са следните: EAN-13 и EAN-8, UPC-A и UPC-E, Code128, Code39, Code 93 и Codabar. Използваемите 2D баркодове са Aztec Code, Data Matrix и QR код.


Уверете се, че качеството на баркода е достатъчно добро. Системата е способна да разчита качество на печат от степен C или по-добро, както е определено в ISO/IEC 15416 (линеен) или ISO/IEC 15415 (2D).

Процедура за изпълнение на тест

Забележка: Всички оператори трябва да носят подходящи лични предпазни средства, като ръкавици, лабораторно престиилка и защитни очила, когато работят с касетите и сензорния екран на QIAstat-Dx Rise.


1. Натиснете бутона **OPEN WASTE DRAWER** (ОТВАРЯНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОТПАДЪЦИ) в долния десен ъгъл на основния екран за провеждане на тест (Фигура 20).

2. Отворете отделението за отпадъци и извадете използваните касети от предишните цикли. Проверете отделението за отпадъци за разляти течности. Ако е необходимо, почистете отделението за отпадъци, както е описано в раздела „Поддръжка“ на Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Rise.
3. Затворете отделението за отпадъци, след като извадите касетите. Системата ще сканира таблата и ще се върне в основния экран (Фигура 20). Ако таблата е била извадена с цел поддръжка, уверете се, че е поставена правилно, преди да затворите отделението.
4. Натиснете бутона **OPEN INPUT DRAWER** (ОТВАРЯНЕ НА ВХОДНОТО ОТДЕЛЕНИЕ) в долния десен ъгъл на екрана (Фигура 20).

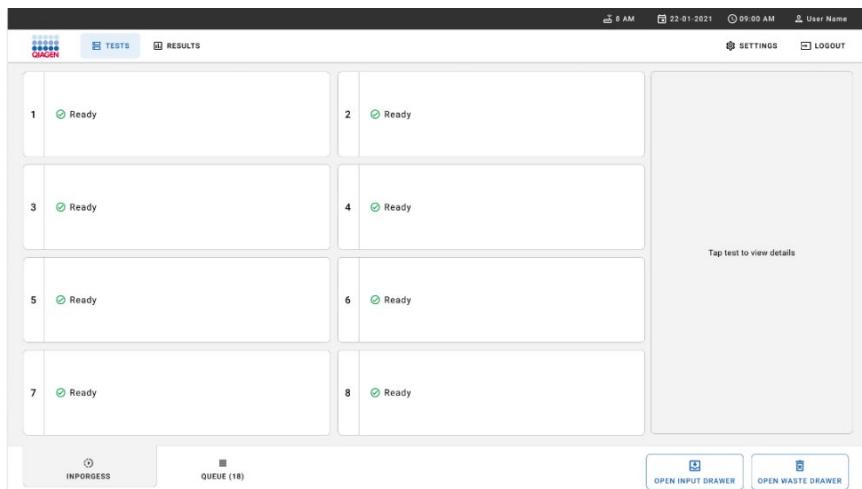


Фигура 20. Основен еcran за тест.

5. Изчакайте входното отделение да се отключи (Фигура 21).

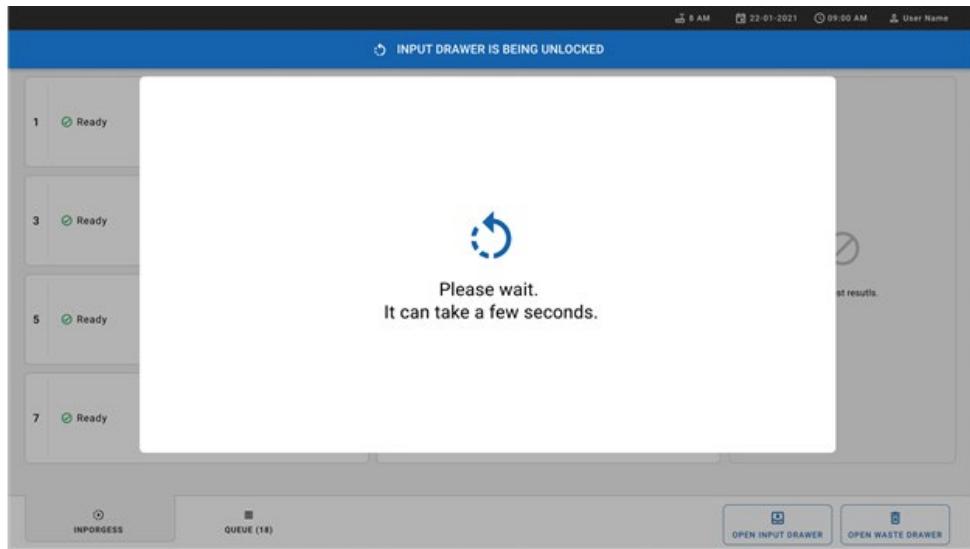


Фигура 21. Диалогов прозорец за изчакване на входното отделение.

6. Когато бъдете подканени, дръпнете входното отделение, за да го отворите (Фигура 22).

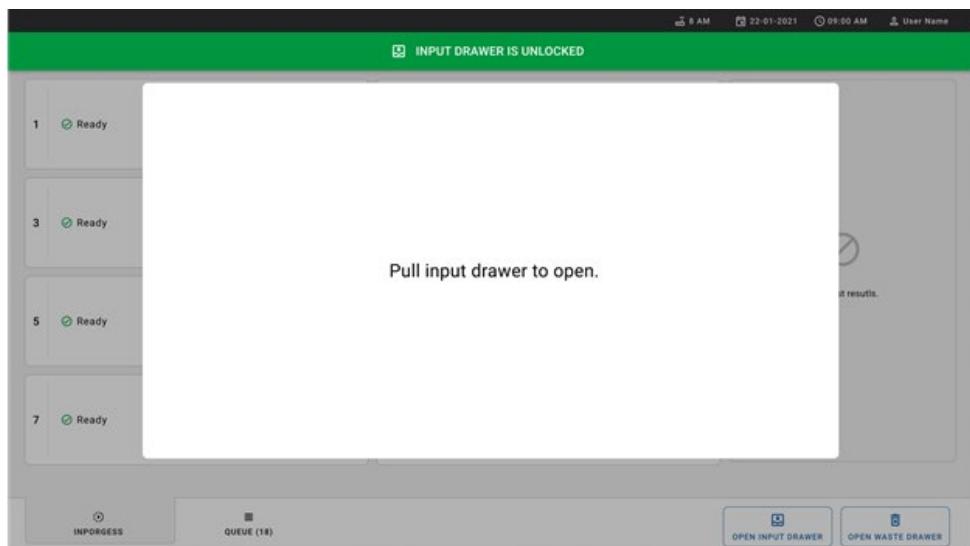

Фигура 22. Диалогов прозорец за отваряне на входното отделение.

7. Появява се диалоговият прозорец **Add Cartridge** (Добавяне на касета) и скенерът пред апаратът се активира. Сканирайте баркода с идентификатора на аликовтната част в горната част на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge пред апаратъта (позицията, обозначена със стрелката (Фигура 23)).

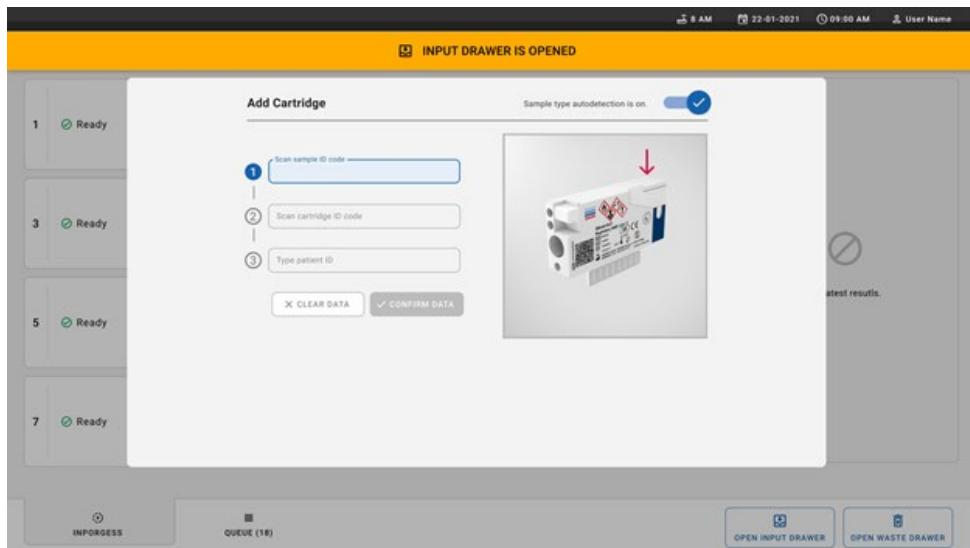


Фигура 23. Екран „Scan sample ID“ (Сканиране на идентификатор на аликовтна част).

8. След като въведете баркода на идентификатора на аликовтната част, сканирайте баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която ще се използва (позицията, обозначена със стрелката). QIAstat-Dx Rise автоматично ще разпознае анализа, който ще се изпълнява, според баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (Фигура 24).

Забележка: Уверете се, че **Sample type autodetection** (Автоматично установяване на типа аликовтна част) е зададено на **on** (включено). Системата автоматично ще разпознае използвания тип аликовтна част.


9. Ако **Sample type autodetection** (Автоматично откриване на вид на аликовтната част) е зададено на **off** (изкл.), може да е необходимо да изберете подходящия вид на аликовтната част ръчно (ако е приложимо за използвания анализ).

Забележка: QIAstat-Dx Rise не приема касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, които са с изтекъл срок на годност, които вече са били използвани или ако файлът с дефиниция на анализ на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel не е инсталиран на апаратта. В този случай ще се покаже съобщение за грешка.

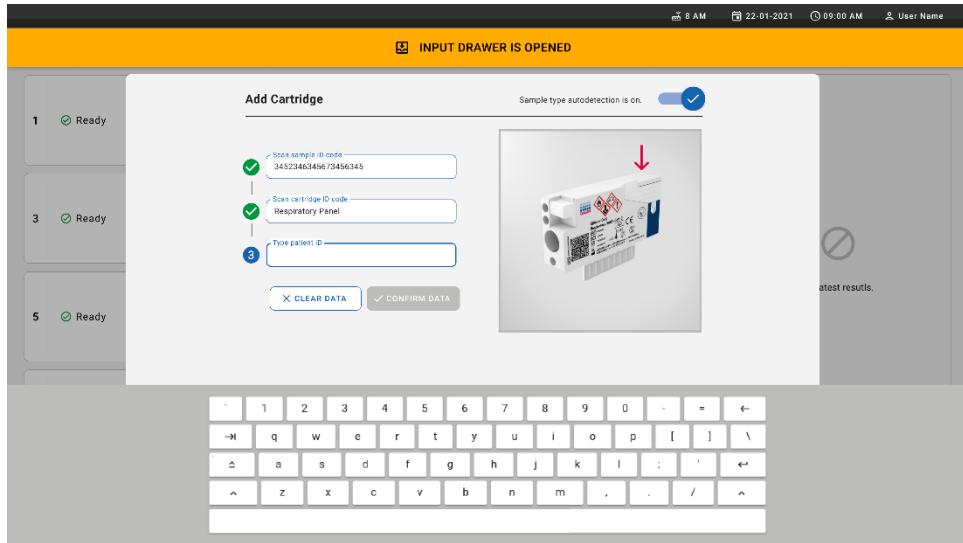


Фигура 24. Сканиране на экрана за идентификация на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

10. Въведете ID на пациента (Patient ID (ID на пациент) трябва да е зададено на **on** (вкл.)) (Фигура 25), след това потвърдете данните (Фигура 26).

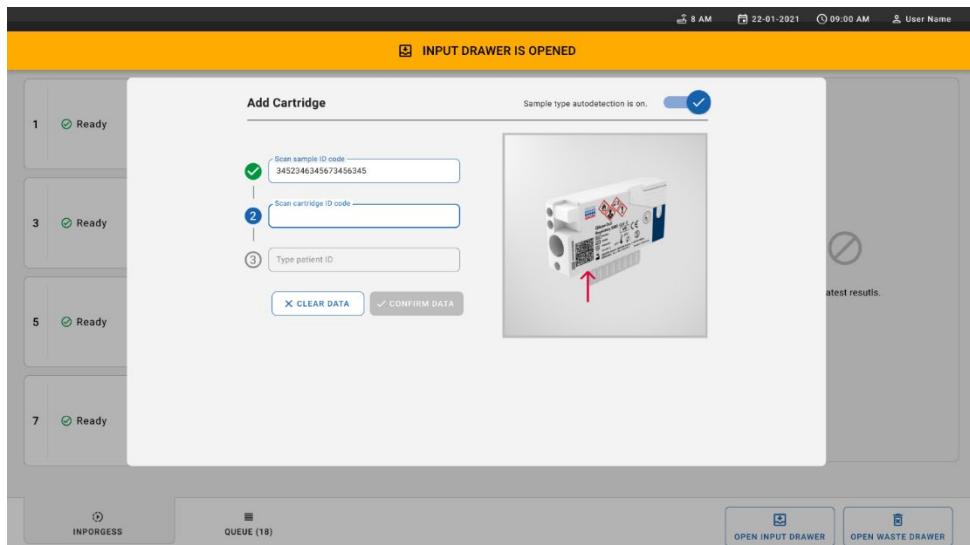


Фигура 25. Въвеждане на ID на пациента.

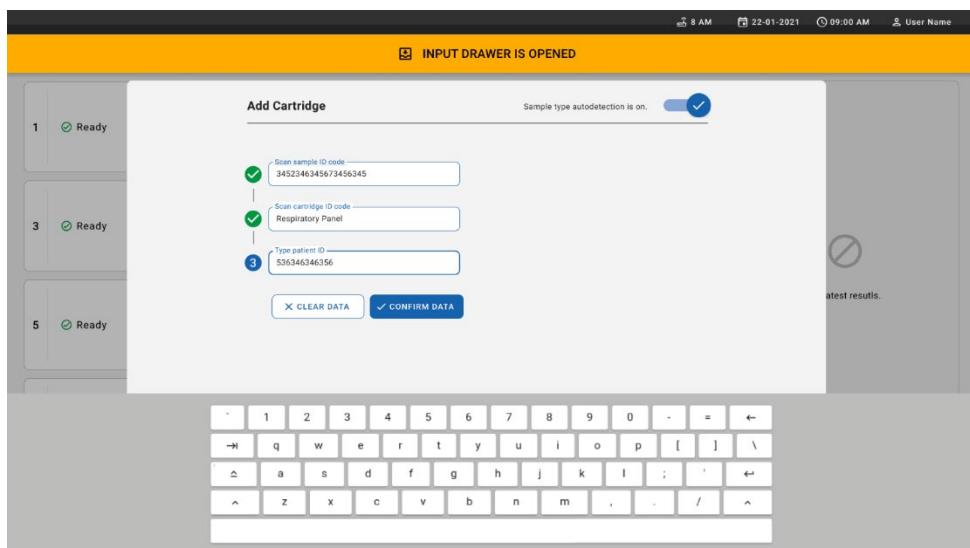

Фигура 26. Екран за въвеждане ID на пациента и последващо потвърждаване данните


11. След успешно сканиране в горната част на екрана за кратко се появява следният диалогов прозорец (Фигура 27).

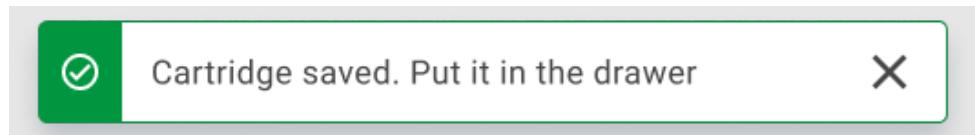

Фигура 27. Екран „Cartridge saved“ (Касетата е записана)


12. Поставете касетата във входното отделение. Уверете се, че касетата е правилно поставена в таблата (Фигура 28).
13. Продължете със сканирането и поставянето на касети, като следвате предишните стъпки. Можете да зареждате до 18 касети в отделението.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, имайте предвид, че QIAstat-Dx Rise може да борави с до 18 касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge едновременно в рамките на входното отделение. Моля, имайте предвид също, че със софтуерна версия 2.2 или по-нова във входното отделение могат едновременно да се поставят и обработват различни панели.

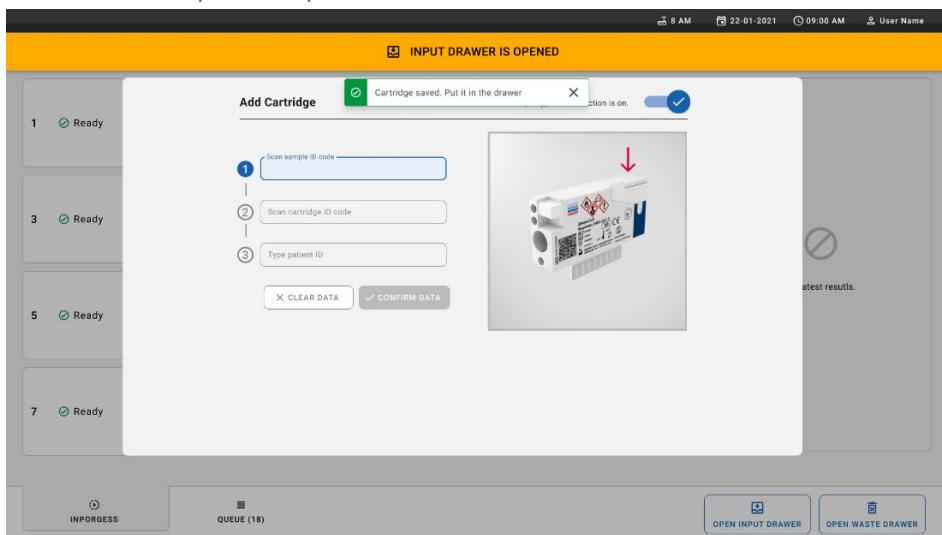


Фигура 28. Екран „Add cartridge“ (Добавяне на касета).

14. Затворете входното отделението, когато всички касети бъдат сканирани и поставени. Системата ще сканира касетите и ще подготви опашка (Фигура 29).

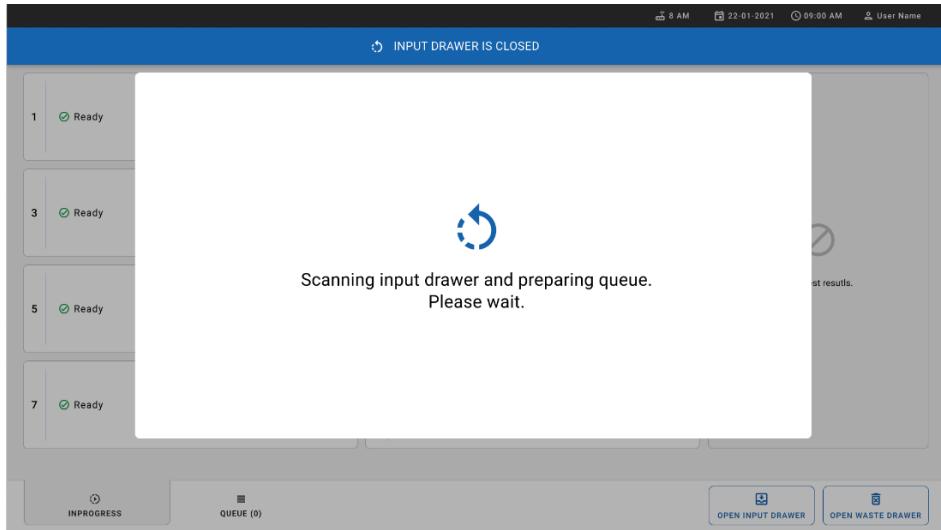

Фигура 29. Екран за подготвяне на опашка.

15. След успешно сканиране ще се покаже опашката (Фигура 30). Прегледайте показаните данни. В случай на грешка натиснете бутона **OPEN INPUT DRAWER** (ОТВАРЯНЕ НА ВХОДНО ОТДЕЛЕНИЕ), извадете съответната касета и сканирайте повторно касетата, като следвате стъпки 10-13.

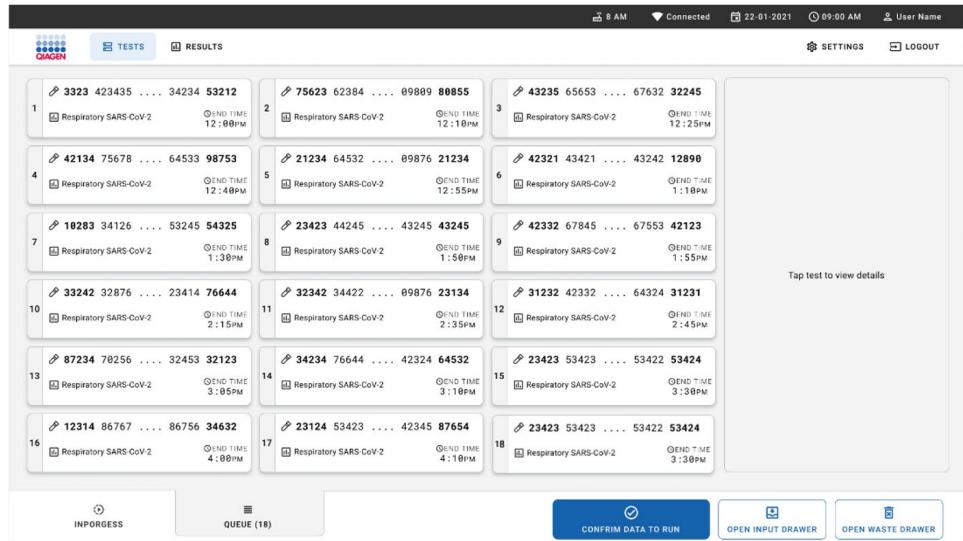

Фигура 30. Екран с аликовтните части в опашката.

Забележка: Редът на аликовтните части на екрана може да не съвпада с реда на касетите във входното отделение (съвпада само когато всички касети са поставени заедно в опашка) и не може да бъде променен без отваряне на таблата за зареждане и изваждане на касетите.

Аликовтните части в опашката/редът за обработка се генерират от QIAstat-Dx Rise въз основа на следните правила:

- Време на стабилност: Касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с най-кратко време на стабилност след зареждане в апарат ще бъдат приоритизирани, независимо от позицията им в таблата за зареждане.
- В рамките на същия тип анализ позицията в таблата за зареждане определя реда в опашката.

Ако изберете тест на сензорния экран, в раздела **TEST DETAILS** (ПОДРОБНОСТИ ЗА ТЕКСТА) на екрана се показва допълнителна информация (Фигура 31).

Забележка: Системата ще отхвърли касетите, които надвишават максималното време на стабилност след зареждане в апарат в рамките на входното отделение (около 300 минути)

TESTS		RESULTS		TEST DETAILS	
1	3323 423435 34234 53212 Respiratory SARS-CoV-2	2	75623 62384 09889 88855 Respiratory SARS-CoV-2	3	43235 65653 67632 32245 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 12:08PM		④ END TIME 12:18PM		④ END TIME 12:25PM
4	42134 75678 64533 98753 Respiratory SARS-CoV-2	5	21234 64532 09876 21234 Respiratory SARS-CoV-2	6	42321 43421 43242 12898 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 12:48PM		④ END TIME 12:55PM		④ END TIME 1:18PM
7	10283 34126 53245 54325 Respiratory SARS-CoV-2	8	23423 44245 43245 43245 Respiratory SARS-CoV-2	9	42332 67845 67553 42123 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 1:30PM		④ END TIME 1:58PM		④ END TIME 1:59PM
10	33242 32876 23414 76644 Respiratory SARS-CoV-2	11	32342 34422 09876 23134 Respiratory SARS-CoV-2	12	31232 42332 64324 31231 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 2:15PM		④ END TIME 2:15PM		④ END TIME 2:45PM
13	87234 78256 32453 32123 Respiratory SARS-CoV-2	14	34234 76644 42324 64532 Respiratory SARS-CoV-2	15	23423 53423 53422 53424 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 3:05PM		④ END TIME 3:18PM		④ END TIME 3:08PM
16	12314 86767 86756 34632 Respiratory SARS-CoV-2	17	23124 53423 42345 87654 Respiratory SARS-CoV-2	18	23423 53423 53422 53424 Respiratory SARS-CoV-2
	④ END TIME 4:08PM		④ END TIME 4:10PM		④ END TIME 3:08PM
INPOGRESS		QUEUE (18)		CONFIRM DATA TO RUN	
SETTINGS		OPEN INPUT DRAWER		OPEN WASTE DRAWER	

Фигура 31. Екран с аликовните части в опашката и показаната допълнителна информация за избрания анализ.

В раздела **Test Details** (Подробности за теста) се показва следната информация (Фигура 32):

- Sample ID (Идентификатор на аликовтна част)
 - Sample Type (Тип аликовтна част) (в зависимост от анализа)
 - Assay Type (Тип анализ)
 - Patient ID (Идентификатор на пациент)
 - Operator ID (Идентификатор на оператора)
 - Input Tray Load time (Време на зареждане на таблата за зареждане)
 - Estimated end time (Приблизително време на завършване)
 - Position in Input-drawer (Позиция във входното отделение)
 - Позиция в опашката от чакащи (**Забележка:** позицията може да се различава в зависимост от времето на стабилност на аликовтните части)
 - Cartridge serial number (Сериен номер на касетата)
 - Cartridge expiration date (Срок на годност на касетата)
 - Onboard time left (Оставащо време след зареждане в апарат)

Забележка: Времето след зареждане в апарат (около 300 минути) задейства реда на аликовотните части в опашката от чакащи.

TEST DETAILS		X
Sample ID 83746466367738383	Sample Type Swab	
Assay Type QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2		
Patient ID 23423412342342354		
Operator OperatorID		
Input tray Load time 22:10 22-10-2021	Estimated end time 22:59	
Position in input tray 5	Position in Queue 1	
Cartridge Serial Number 23432452	Cartridge Expiration Date 30-10-2021	
Onboard time left 120min		

Фигура 32. Подробности за теста

16. Натиснете бутона **CONFIRM DATA TO RUN** (ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ) в дъното на екрана, когато всички показани данни са правилни (Фигура 31). След това е необходимо финално потвърждение от страна на оператора, за да се изпълнят тестовете.
17. Докато тестовете се изпълняват, оставащото време за изпълнение, както и друга информация за всички тестове на опашката, се показват на сензорния екран (Фигура 33).

The screenshot shows a software interface for managing COVID-19 tests. At the top, there are tabs for 'TESTS' and 'RESULTS'. On the right, there are buttons for 'SETTINGS', 'LOGOUT', and a user name indicator. The main area displays a grid of test slots:

- Slot 1:** Sample ID: 3231 423435 32453 ..., End Time: 22:30PM, Status: TEST COMPLETED.
- Slot 2:** Sample ID: 12121 097773 23232 ..., End Time: 4:30PM, Status: TEST COMPLETED.
- Slot 3:** Sample ID: 34532 63534 24424 ..., End Time: 5:10PM, Status: TEST COMPLETED.
- Slot 4:** Sample ID: 34323 424224 44342 ..., End Time: 5:45PM, Status: TEST COMPLETED.
- Slot 5:** Sample ID: 34345 44354 53432 ..., End Time: 22:30PM, Status: LOADING.
- Slot 6:** Sample ID: 23423 423435 32453 ..., End Time: 22:30PM, Status: LOADING.
- Slot 7:** Status: Ready.
- Slot 8:** Status: Ready.


On the right side, there is a 'TEST DETAILS' panel with the following information:

- Sample ID:** 12121 097773 23232...
- Sample Type:** Swab
- Assay Type:** QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2
- Patient ID:** 2341 2321 2489 4423
- Cartridge Serial Number:** 234234
- Cartridge Expiration Date:** 22-10-2020
- ADF Version:** 1.2
- Operator:** OperatorID
- Load time:** 22:10 22-10-2021
- Estimated end time:** 22:59
- SW Version:** 1.2.0
- Analytical module SN:** 231241341341

At the bottom, there are buttons for 'OPEN INPUT DRAWER' and 'OPEN WASTE DRAWER'.


Фигура 33. Екран с информация за изпълнението на тест в опашката.

Ако—касетата се зарежда в аналитичен модул, се показва съобщение **LOADING** (ЗАРЕЖДА СЕ), както и очакваното време за приключване (Фигура 34).

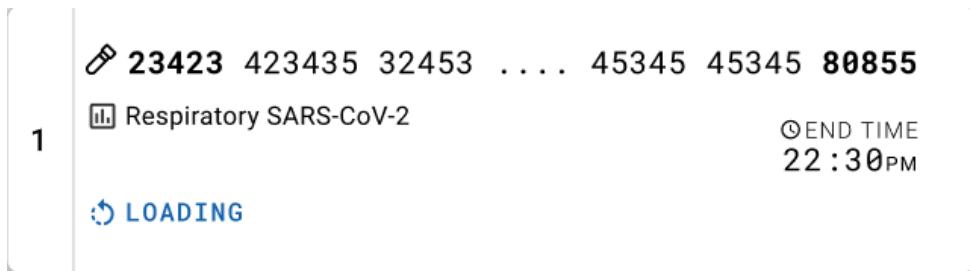


Фигура 34. Съобщение за зареждане на теста и крайно време.

Ако тестът се изпълнява, се показват изминалото време от изпълнението и приблизителното време за приключване (Фигура 35).

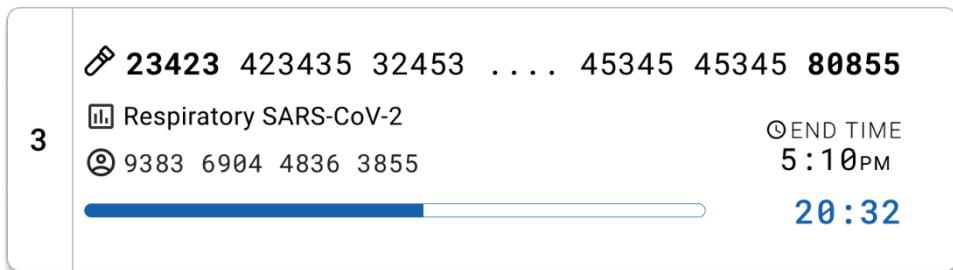

Фигура 35. Изглед на изминалото време за изпълнение и приблизителното време на завършване.

Ако тестът е завършен се показват съобщение „test completed“ (тестът е завършен) и крайното време за изпълнението (Фигура 36).

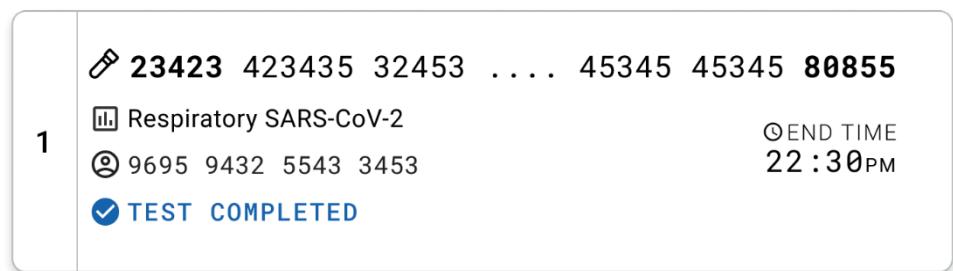

Фигура 36. Изглед „Test completed“ (Тестът е завършен)

Протокол: Аликовотни части в течна транспортна среда

Взимане, транспортиране и съхранение на аликовотни части

Вземете аликовотни части с назофарингеален тампон съгласно процедурите, препоръчани от производителя на тампона, и поставете тампона в универсална транспортна среда (Universal Transport Medium, UTM).

Зареждане на аликовотна част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

Забележка: приложим за QIAstat-Dx 1.0 и QIAstat-Dx Rise

1. Отворете опаковката на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge по перфорациите от двете страни (Фигура 37).

ВАЖНО: След като се отвори опаковката, аликовотната част трябва да се вкара в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и да се зареди в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 в рамките на 120 минути, или в QIAstat-Dx Rise в рамките на 30 минути.



Фигура 37. Отваряне на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

2. Извадете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge от опаковката и я поставете с баркода към Вас.
3. Ръчно надпишете или залепете етикет с информация за аликовотната част върху QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Уверете се, че етикетът е поставен правилно и не закрива отвора на капака (Фигура 38).



Фигура 38. Поставяне на информация за аликовотната част от горната страна на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.


4. Отворете капака на главния отвор за аликовотна част отпред на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (Фигура 39).



Фигура 39. Отваряне на капака на главния отвор за аликовотна част.


5. Отворете епруветката с аликовотната част за тестване. С доставената преносна пипета изтеглете течност до третото деление на пипетата (тоест $300 \mu\text{l}$) (Фигура 40).

ВАЖНО: Внимавайте да не изтеглите въздух в пипетата. Ако използвате универсална транспортна среда Copan UTM®, внимавайте да не аспирирате някое от зърната в епруветката. Ако в пипетата изтеглите въздух или зърна, внимателно върнете течността от пипетата обратно в епруветката и отново я изтеглете. Използвайте алтернативни стерилни и градуирани пипети, в случай че всичките шест пипети, предоставени с комплекта, са били използвани.

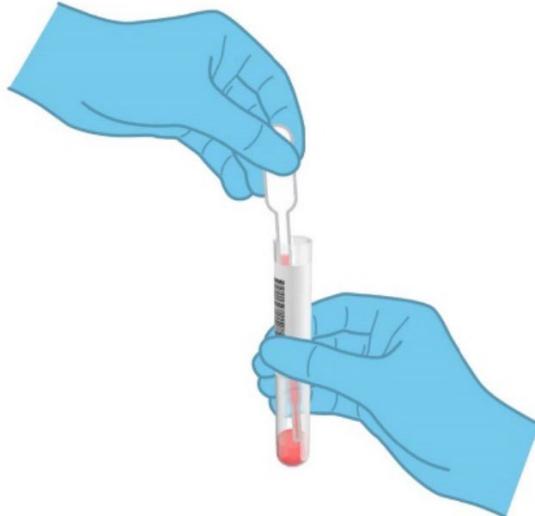

Фигура 40. Изтегляне на аликовотна част в доставената преносна пипета.

6. Внимателно накапете 300 µl от обема на аликовотната част в главния отвор на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с доставената преносна пипета за еднократна употреба (Фигура 41).

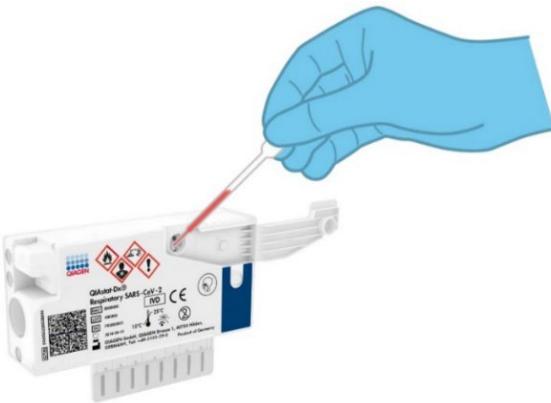

Фигура 41. Прехвърляне на аликовотна част към главния отвор на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

7. Затворете добре капака на главния отвор за аликовотна част така, че да щракне (Фигура 42).



Фигура 42. Затваряне на капака на главния отвор за аликовотна част.

8. Вижте прозорчето за проверка на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, за да се уверите, че аликовотната част е заредена (Фигура 43).

ВАЖНО: След като аликовотната част бъде поставена в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, касетата трябва да се зареди в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 в рамките на 90 минути, или да се постави върху таблата на QIAstat-Dx Rise, веднага след като всички аликовотни части бъдат заредени в касетите. Максималното време за изчакване за касета, която вече е заредена в QIAstat-Dx Rise е около 300 минути. QIAstat-Dx Rise автоматично ще засече и ще предупреди потребителя, ако касетата е стояла в апаратът по-дълго време от разрешеното.



Фигура 43. Прозорче за проверка на аликовотната част (синя стрелка)

Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Analyzer 1.0

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ще намерите в Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще намерите в Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

1. Включете QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 с бутона за включване/изключване отпред на апарата.

Забележка: Превключвателят на захранването в задната част на аналитичния модул трябва да бъде в положение „I“. Индикаторите за състояние на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще станат сини.

2. Изчакайте, докато се покаже основният екран и индикаторите за състоянието на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 светнат в зелено и престанат да мигат.
3. Влезте в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, като въведете потребителско име и парола.

Забележка: Екранът **Login** (Влизане) ще се покаже, ако **User Access Control** (Контрол на потребителския достъп) е активиран. Ако **User Access Control** (Контрол на достъпа на потребителите) е деактивиран, няма да е необходимо потребителско име/парола и ще се покаже основният екран.

4. Ако софтуерът за файлове с дефиниции на анализи не е инсталиран на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, изпълнете инструкциите за инсталациите, преди да изпълните теста (вижте „Приложение A: Инсталација на файла с дефиницијата на анализа“ за допълнителна информация).
5. Натиснете бутона **Run Test** (Изпълнение на тест) в горния десен ъгъл на сензорния екран на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
6. Когато получите указание, сканирайте баркода с идентификатора на епруветката с аликвотна част в универсална транспортна среда (Universal Transport Medium, UTM) или баркода с информация за пробата отгоре на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (вижте стъпка 3) с вградения преден баркод четец на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 (Фигура 44).

Забележка: Можете също така да въведете идентификатора на аликовтната част с виртуалната клавиатура на сензорния екран, като изберете полето **Sample ID** (Идентификатор на аликовтната част).

Забележка: В зависимост от избраната системна конфигурация може също така в този момент да се наложи да въведете идентификатора на пациента.

Забележка: Инструкциите от QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 се показват в лентата с инструкции в долната част на сензорния екран.



Фигура 44. Сканиране на баркод с идентификатора на аликовтната част.

Когато получите указание, сканирайте баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която ще се използва (Фигура 45). QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично разпознава анализа, който ще се изпълнява, според баркода на касетата.

Забележка: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Analyzer 2.0 не приема касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с истекъл срок на годност, вече използвани касети или касети за анализи, които не са инсталирани в апаратта. В тези случаи ще се покаже съобщение за грешка и QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge ще бъде отхвърлена. Повече подробности за инсталрирането на анализи ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.



Фигура 45. Сканиране на баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.


Изберете съответния тип аликовотна част от списъка (Фигура 46).

administrator	Run Test Module 1	20:58 2019-02-13
1 Ul administrator RP	2 Available	3 Available
TEST DATA	SAMPLE TYPE	
Sample ID 12345	Swab	4 Available
Assay Type RP SARS-Co	UTM	
Sample Type UTM	Select Sample Type	
	<input type="button" value="Cancel"/>	

Фигура 46. Избор на типа на аликовотна част.

Ще се покаже еcranът **Confirm** (Потвърждаване). Прегледайте въведените данни и направете необходимите промени, като избирате съответните полета на сензорния еcran и редактирате информацията.

Когато всички показани данни са правилни, натиснете **Confirm** (Потвърждаване). Ако е необходимо, натиснете съответното поле, за да редактирате съдържанието му, или изберете **Cancel** (Отмяна), за да отмените теста (Фигура 47).

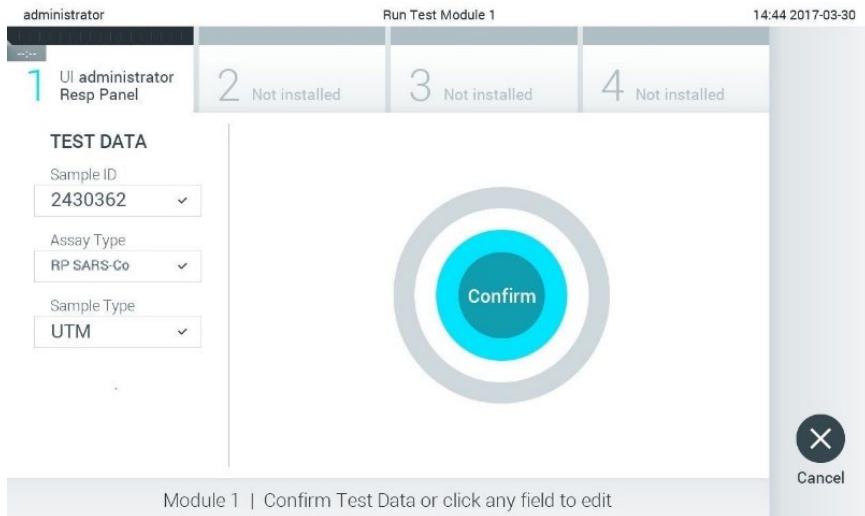

Фигура 47. Потвърждаване на въведени данни.

И двата капака за аликовтова част – на отвора за тампон и главния отвор – на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да бъдат здраво затворени. Когато входът за поставяне на касети отворе на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Analyzer 2.0 се отвори автоматично, поставете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с баркода отляво и реакционните камери отдолу (Фигура 48).

Забележка: Не е необходимо да поставяте QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Поставете я правилно във входа за поставяне на касети и QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично ще я придвижи в аналитичния модул.



Фигура 48. Поставяне на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

След като установи наличието на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично ще затвори капака на входа за поставяне на касети и ще стартира изпълнението на теста. За стартиране на цикъла не е необходимо допълнително действие от оператора.

Забележка: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 няма да приемат QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel Cartridge, която не е била използвана и сканирана при подготовката на теста. Ако е поставена касета, различна от сканираната, ще се генерира грешка и касетата автоматично ще бъде извадена.

Забележка: До този момент можете да отмените изпълнението на теста, като натиснете бутона **Cancel** (Отмяна) в долния десен ъгъл на сензорния еcran.

Забележка: В зависимост от системната конфигурация може да е необходимо операторът отново да въведе потребителската парола, за да стартира изпълнението на теста.


Забележка: Капакът на входа за поставяне на касети ще се затвори автоматично след 30 секунди, ако във входа не бъде поставена QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Ако това се случи, повторете процедурата, като започнете от стъпка 17.

Докато се изпълнява тестът, оставащото време от изпълнението се показва на сензорния екран.

След като тестът бъде изпълнен, ще се покаже екранът **Eject** (Изваждане) (Фигура 49) и на лентата за състоянието на модулите ще се покаже резултатът от теста в един от следните варианти:

- **TEST COMPLETED (ТЕСТЪТ Е ЗАВЪРШЕН):** Тестът е изпълнен успешно
- **TEST FAILED (ТЕСТЪТ Е НЕУСПЕШЕН):** По време на теста е възникнала грешка
- **TEST CANCELED (ТЕСТЪТ Е ОТМЕНЕН):** Потребителят е отменил теста

ВАЖНО: Ако тестът е неуспешен, в раздела „Отстраняване на проблеми“ в Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 ще намерите възможните причини и инструкции относно това как да продължите.

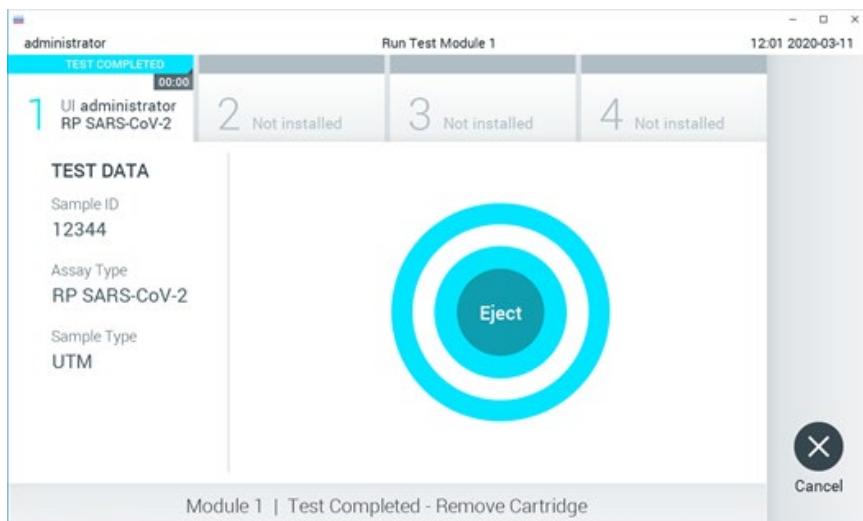

Фигура 49. Екран „Eject“ (Изваждане).

Натиснете **Eject** (Изваждане) на сензорния екран, за да извадите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и я депонирайте като биологично опасен отпадък в съответствие с всички национални, щатски и местни нормативни

разпоредби за здравето и безопасността. QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да се извади, когато входът за поставяне на касети се отвори и извади касетата. Ако касетата не бъде извадена след 30 секунди, тя автоматично ще влезе обратно в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и капакът на входа за поставяне на касети ще се затвори. Ако това стане, натиснете **Eject** (Изваждане), за да отворите отново капака на входа за поставяне на касети, след което извадете касетата.

ВАЖНО: Използваните касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge трябва да се изхвърлят. Не може да се използват повторно касети за тестове, чието изпълнение е започнало, но след това е отменено от оператора, или за които е открита грешка.

След като QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge бъде извадена, ще се покаже екранът **Summary** (Резюме) с резултатите. Повече подробности ще намерите в „Интерпретиране на резултатите“. За да започнете процедурата за изпълнение на друг тест, натиснете **Run Test** (Изпълнение на тест).

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ще намерите в *Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Analyzer 2.0*.


Изпълнение на тест на QIAstat-Dx Rise

Забележка: Повече информация за използването на QIAstat-Dx Rise ще намерите в Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Rise.

Забележка: Фигурите в този раздел са само ориентировъчни и може да се различават при различните анализи.

Стартиране на QIAstat-Dx Rise

- Натиснете бутона **ON/OFF** (Включване/Изключване) върху предния панел на QIAstat-Dx Rise, за да стартирате апаратата.
Забележка: Превключвателят на захранването в задната лява съединителна кутия трябва да бъде в положение „I“.
- Изчакайте, докато се покаже еcranът за вход и светодиодните индикатори за състоянието станат зелени.
- Впишете се в системата, след като се появи еcranът за вход (Фигура 50).

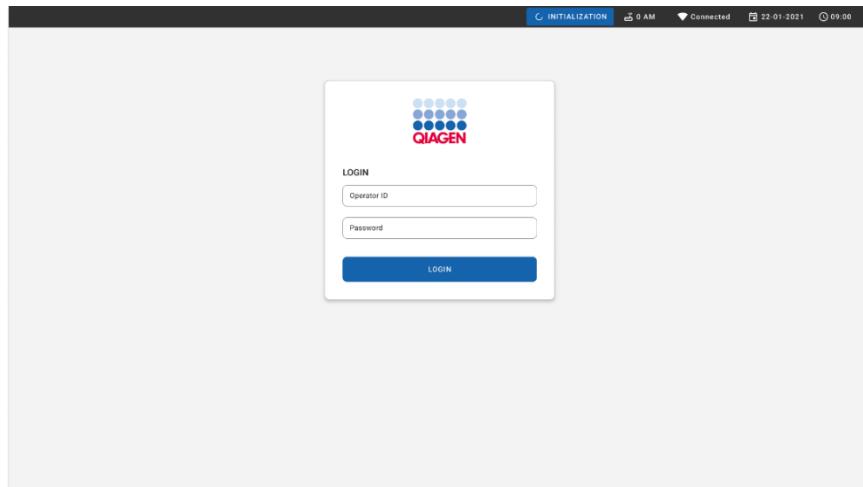

Фигура 50. Еcran за вход

Забележка: След успешното първоначално инсталиране на QIAstat-Dx Rise, системният администратор трябва да влезе в системата за първото конфигуриране на софтуера.

Подготовка на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с универсални аликовотни части в течна транспортна среда

Извадете QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge от опаковката. За подробности относно добавянето на аликовотната част към касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и за конкретна информация относно анализа, който ще се изпълнява, вижте „Зареждане на аликовотна част в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge“.

След добавянето на аликовотната част в касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и двата капака за аликовотна част трябва да бъдат здраво затворени.

Добавяне на баркод на аликовотна част към QIAstat-Dx

Поставете баркод върху горната дясна страна на QIAstat-Dx Cartridge (обозначена със стрелката) (Фигура 51).



Фигура 51. Поставяне на баркод с идентификатор на аликовотна част

Максималният размер на баркода е: 22 mm x 35 mm. Баркодът трябва винаги да е от дясната страна на касетата (както е показано по-горе със синята маркирана зона), тъй като лявата страна на касетата е от решаващо значение за автоматичното откриване на аликовотната част (Фигура 52).

Забележка: За да обработвате аликовотни части на QIAstat-Dx Rise, е необходимо да поставите машинно четим баркод с идентификатора на аликовотната част върху QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.



Фигура 52. Разполагане на баркод с идентификатор на аликовотна част


Могат да бъдат използвани 1D и 2D баркодове. Използваемите 1D баркодове са следните: EAN-13 и EAN-8, UPC-A и UPC-E, Code128, Code39, Code 93 и Codabar. Използваемите 2D баркодове са Aztec Code, Data Matrix и QR код.

Уверете се, че качеството на баркода е достатъчно добро. Системата е способна да разчита качество на печат от степен C или по-добро, както е определено в ISO/IEC 15416 (линеен) или ISO/IEC 15415 (2D).

Процедура за изпълнение на тест


- Натиснете бутона **OPEN WASTE DRAWER** (ОТВАРЯНЕ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ОТПАДЪЦИ) в долния десен ъгъл на основния екран за провеждане на тест (Фигура 53).

2. Отворете отделението за отпадъци и извадете използваните касети от предишните цикли. Проверете отделението за отпадъци за разляти течности. Ако е необходимо, почистете отделението за отпадъци, както е описано в раздела „Поддръжка“ на Ръководството за потребителя на QIAstat-Dx Rise.
3. Затворете отделението за отпадъци, след като извадите касетите. Системата ще сканира таблата и ще се върне в основния екран (Фигура 53). Ако таблата е била извадена с цел поддръжка, уверете се, че е поставена правилно, преди да затворите отделението.
4. Натиснете бутона **OPEN INPUT DRAWER** (ОТВАРЯНЕ НА ВХОДНОТО ОТДЕЛЕНИЕ) в долния десен ъгъл на екрана (Фигура 53).

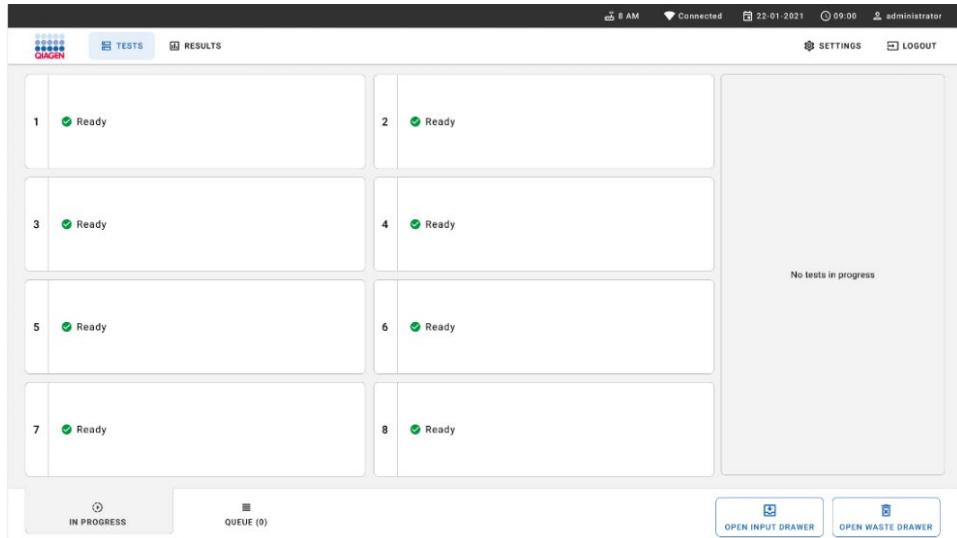


Фигура 53. Основен екран за тест.

5. Изчакайте входното отделение да се отключи (Фигура 54).

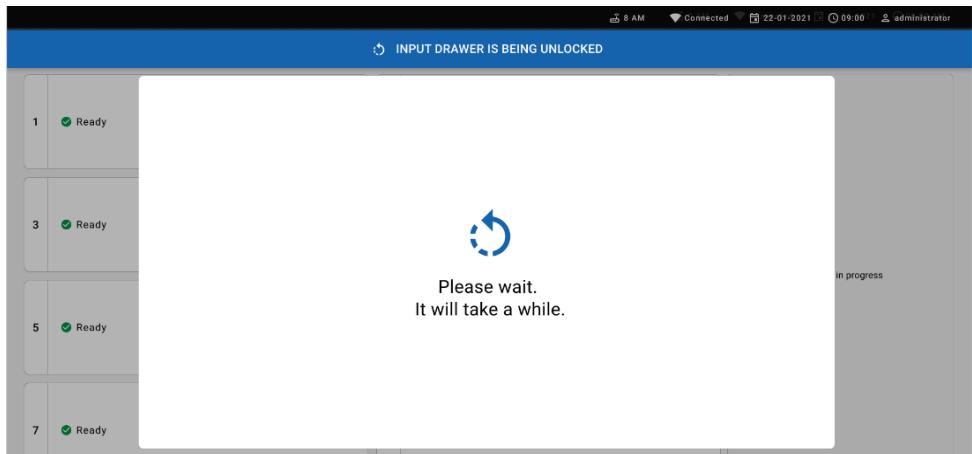


Фигура 54. Диалогов прозорец за чакаща входна табла.

6. Когато бъдете подканени, дръпнете входното отделение, за да го отворите (Фигура 55).

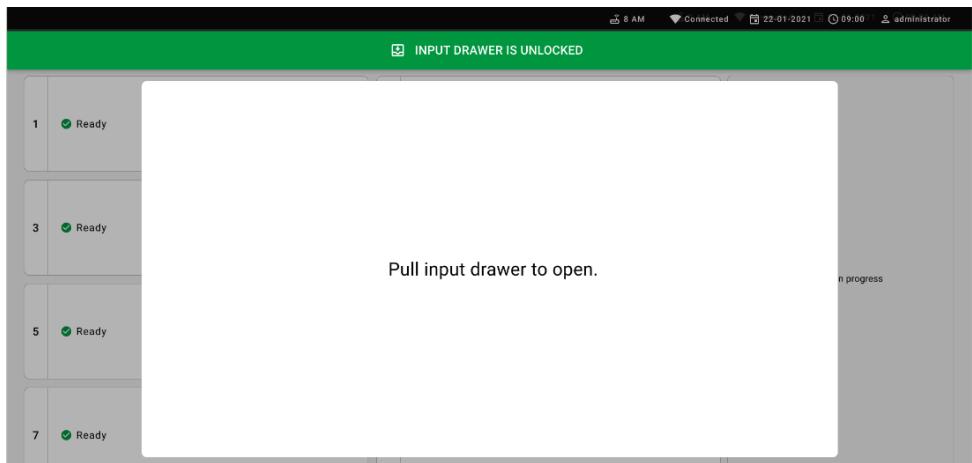

Фигура 55. Диалогов прозорец за отворено входно отделение.

7. Появява се диалоговият прозорец **Add cartridge** (Добавяне на касета) и скенерът в предната част се активира. Сканирайте идентификационния баркод на аликовотната част от горната страна на касетата QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge в предната част на апаратта (позицията, обозначена със стрелката (Фигура 56).

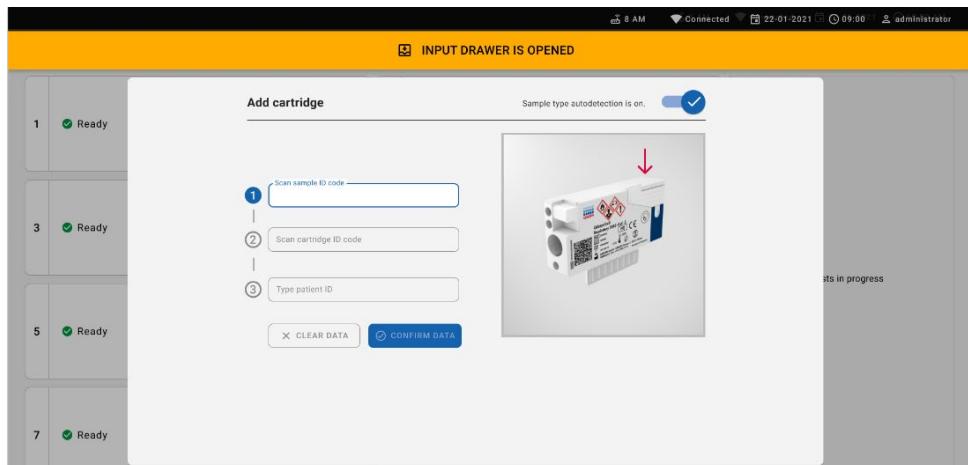


Фигура 56. Екран „Scan sample ID“ (Сканиране на идентификатор на аликовотна част)

8. След като въведете баркода на идентификатора на аликовтната част, сканирайте баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, която ще се използва (позицията, обозначена със стрелката). QIAstat-Dx Rise автоматично ще разпознае анализа, който ще се изпълнява, според баркода на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (Фигура 57).

Забележка: Уверете се, че **Sample type autodetection** (Автоматично установяване на типа аликовтна част) е зададено на **on** (включено). Системата автоматично ще разпознае използвания тип аликовтна част (ако е приложимо за използвания анализ).


Ако **Sample type autodetection** (Автоматично откриване на вид на аликовтната част) е зададено на **off** (изкл.), може да е необходимо да изберете подходящия вид на аликовтната част ръчно (ако е приложимо за използвания анализ).

Забележка: QIAstat-Dx Rise не приема касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с истекъл срок на годност, вече използвани касети или касети за анализи, които не са инсталирани в апаратът. В тези случаи ще се покаже съобщение за грешка.

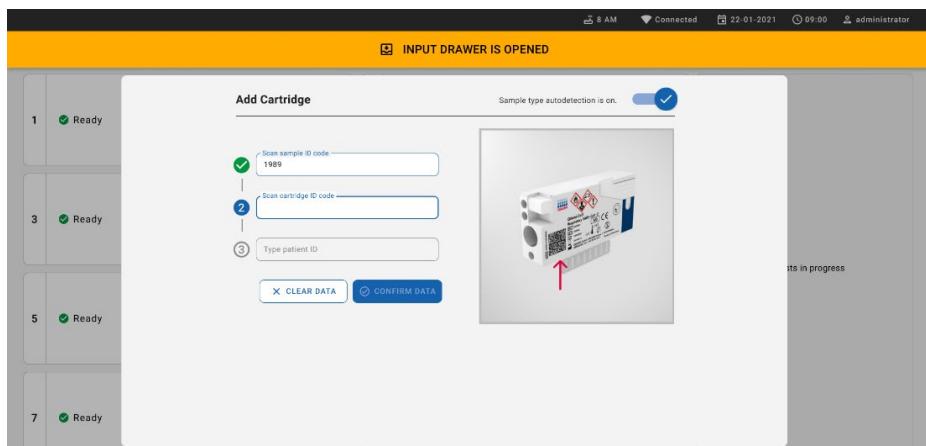


Фигура 57. Екран за сканиране на идентификатор на касета

9. Въведете ID на пациента (Patient ID (ID на пациент) трябва да е настроено на **on** (вкл.)), след което потвърдете данните (Фигура 58).

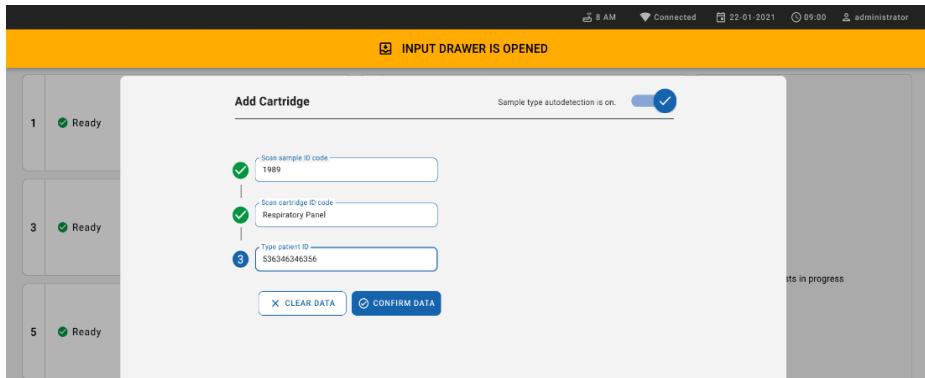


Фигура 58. Въвеждане на ID на пациента

10. След успешно сканиране в горната част на екрана за кратко се появява следния диалогов прозорец (Фигура 59)

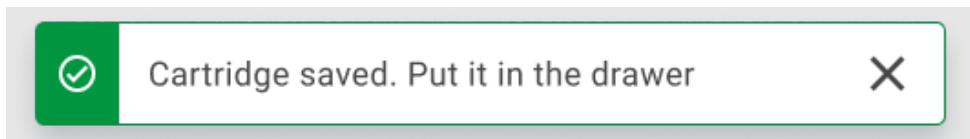


Фигура 59. Екран „Cartridge saved“ (Касетата е записана)

11. Поставете касетата във входното отделение. Уверете се, че касетата е правилно поставена в таблата.
12. Продължете със сканирането и поставянето на касети, като следвате предишните стъпки. Можете да зареждате до 18 касети в отделението.
- ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:** Моля, имайте предвид, че QIAstat-Dx Rise може да борави с до 18 касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge едновременно в рамките на входното отделение. Моля, имайте предвид също, че със софтуерна версия 2.2 или по-нова във входното отделение могат едновременно да се поставят и обработват различни панели.

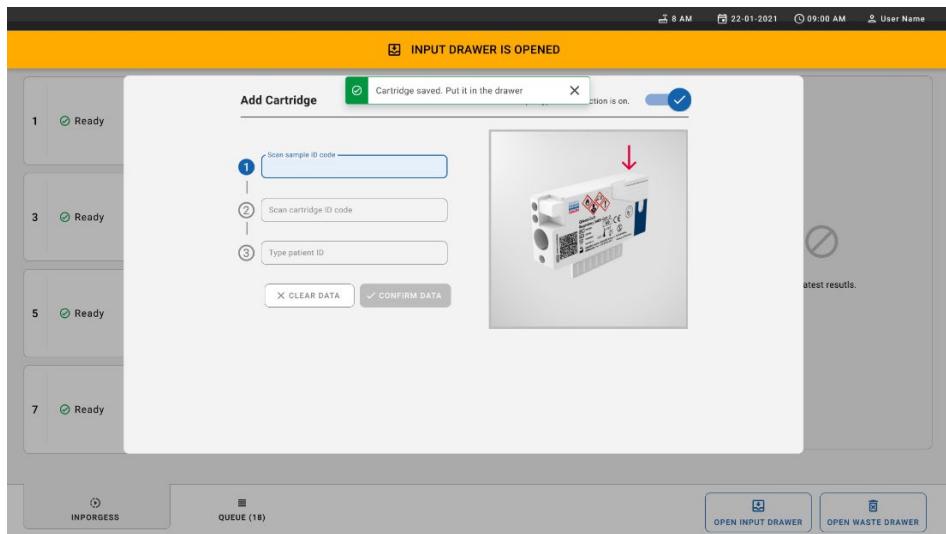


Фигура 60. Екран „Add cartridge“ (Добавяне на касета).

13. Затворете входното отделението, когато всички касети бъдат сканирани и поставени. Системата ще сканира касетите и ще подгответи опашка (Фигура 61).

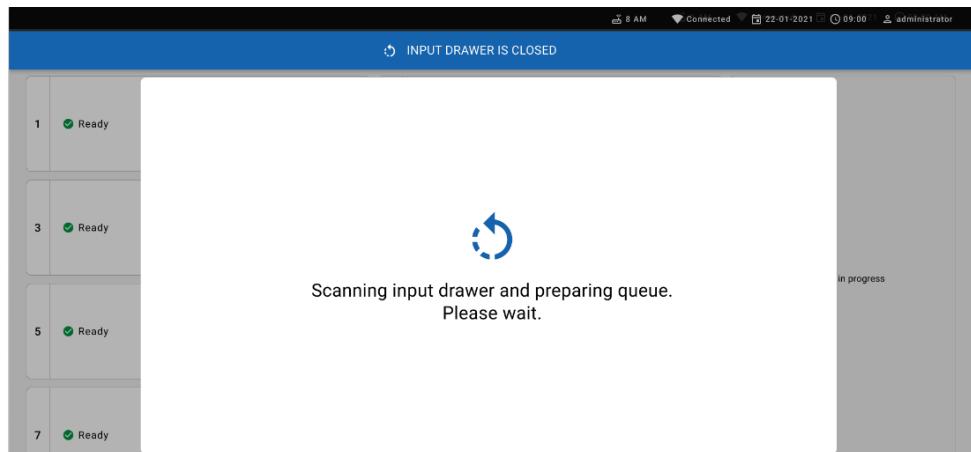

Фигура 61. Екран за подгответие на опашка.

След успешно сканиране ще се покаже опашката (Фигура 62). Прегледайте показаните данни. В случай на грешка, натиснете бутона „open input drawer“ (отваряне на входното отделение), извадете съответната касета и сканирайте касетата повторно, като следвате стъпки 10-13.

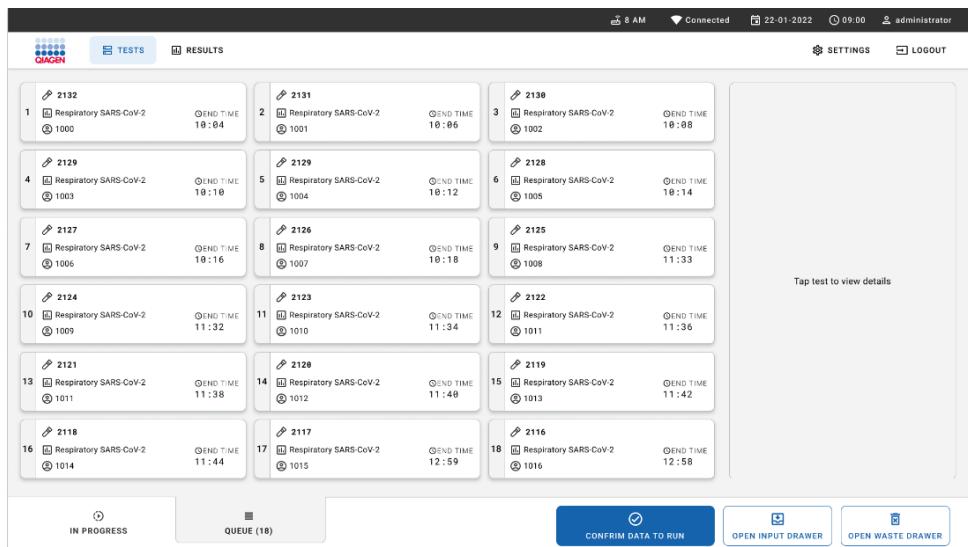

Фигура 62. Екран с аликовотните части в опашката.

Забележка: Редът на аликовотните части на екрана може да не съвпада с реда на касетите във входното отделение (съвпада само когато всички касети са поставени заедно в опашка)-и не може да бъде променен без отваряне на таблата за зареждане и изваждане на касетите.

Аликовотните части в опашката/редът за обработка се генерират от QIAstat-Dx Rise въз основа на следните правила:

- Време на стабилност: Касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge с най-кратко време на стабилност след зареждане в апаратът ще бъдат приоритизирани, независимо от позицията им в таблата за зареждане.
- В рамките на същия тип анализ позицията в таблата за зареждане определя реда в опашката.

Ако изберете тест на сензорния екран, в раздела за преглед на подробности на екрана се показва допълнителна информация (Фигура 63).

Забележка: Системата ще отхвърли касетите, които надвишават максималното време на стабилност след зареждане в апаратът в рамките на входното отделение (около 300 минути)

The screenshot shows a software interface for managing COVID-19 tests. At the top, there are tabs for 'TESTS' and 'RESULTS'. On the right, there are buttons for 'SETTINGS' and 'LOGOUT'. The main area displays a grid of 18 samples, each with a unique ID, sample type (Respiratory SARS-CoV-2), and end time. Sample 13 is highlighted with a blue border. To the right of the grid, under 'TEST DETAILS', is a detailed panel for Sample 13. This panel includes fields for Sample ID (2128), Sample Type (UTM), Assay (QIAstat-Dx ® Respiratory SARS-CoV-2 Panel), Patient ID (1015), Cartridge Serial Number (11231241414212), Cartridge Expiration Date (22-12-2022), Operator (administrator), Input Drawer Load time (22-10-2022 12:41:05), Estimated End Time (22-10-2022 13:05:24), Position in Input Drawer (5), Position in Queue (3), and a note about Onboard time left (120min). There is also a checkbox labeled 'URGENT'.

Sample ID	Sample Type
2128	UTM
Assay	QIAstat-Dx ® Respiratory SARS-CoV-2 Panel
Patient ID	1015
Cartridge Serial Number	11231241414212
Cartridge Expiration Date	22-12-2022
Operator	administrator
Input Drawer Load time	22-10-2022 12:41:05
Estimated End Time	22-10-2022 13:05:24
Position in Input Drawer	5
Position in Queue	3
Onboard time left	120min

Фигура 63. Екран с аликовтните части в опашката и показаната допълнителна информация за избрания анализ.

В раздела **test details** (подробности за теста) се показва следната информация (Фигура 64):


- Sample ID (Идентификатор на аликовтна част)
- Sample Type (Тип аликовтна част) (в зависимост от анализа)
- Assay Type (Тип анализ)
- Patient ID (Идентификатор на пациент)
- Operator ID (Идентификатор на оператора)
- Input Tray Load time (Време на зареждане на таблата за зареждане)
- Estimated end time (Приблизително време на завършване)
- Position in Input-drawer (Позиция във входното отделение)
- Position in Queue (**Note:** the position may differ, based on sample stability time)
(Позиция в опашката от чакащи (**Забележка:** позицията може да се различава в зависимост от времето на стабилност на аликовтните части))
- Cartridge serial number (Сериен номер на касетата)
- Cartridge expiration date (Срок на годност на касетата)
- Onboard time left (Оставащо време след зареждане в апаратта)

Забележка: Времето след зареждане в апарат (около 300 минути) задейства реда на аликовтните части в опашката от чакащи.

TEST DETAILS	
Sample ID 83746466367738383	Sample Type UTM
Assay Type QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2	
Patient ID 23423412342342354	
Operator OperatorID	
Input tray Load time 22:10 22-10-2021	Estimated end time 22:59
Position in input tray 5	Position in Queue 1
Cartridge Serial Number 23432452	Cartridge Expiration Date 30-10-2021
Onboard time left 120min	


Фигура 64. Подробности за теста

14. Натиснете бутона **confirm data to run** (потвърждаване на данните за изпълнение) в дъното на екрана, когато всички показани данни са правилни (Фигура 63). След това е необходимо финално потвърждение от страна на оператора, за да се изпълнят тестовете (Фигура 65).

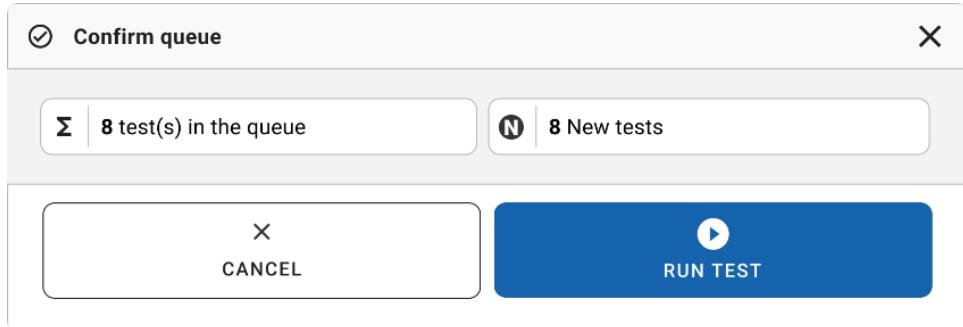

Фигура 65. Диалогов прозорец за потвърждаване на опашка

Докато се изпълняват тестовете, оставащото време от изпълнението, както и друга информация за всички тестове в опашката, се показват на сензорния еcran (Фигура 66).

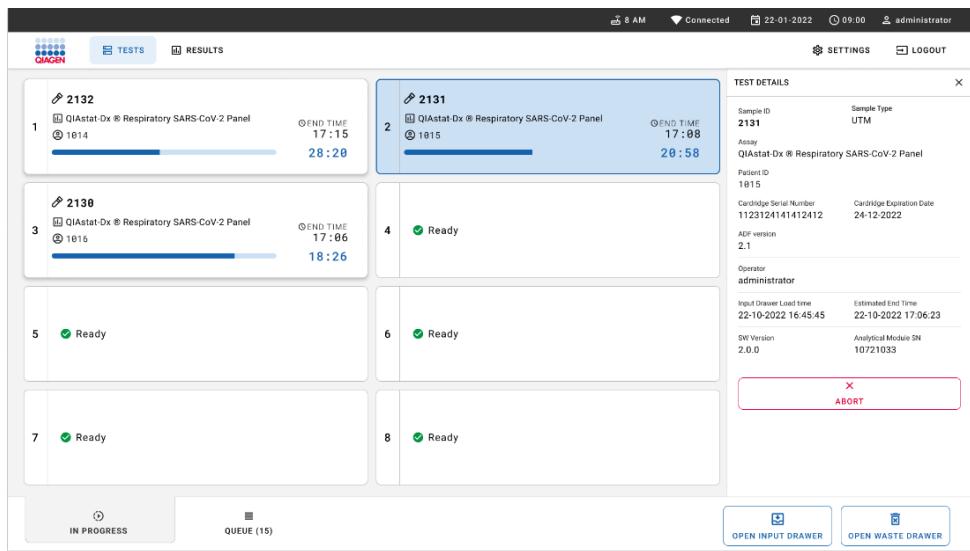


Фигура 66. Еcran с информация за изпълнението на тест в опашката.

Ако касетата е заредена в аналитичен модул, се показва съобщението „test loading“ (тестът се зарежда) и очакваното време за завършване (фигура 67).




Фигура 67. Съобщение за зареждане на теста и крайно време.

Ако тестът се изпълнява, се показват изминалото време от изпълнението и приблизителното време за приключване (Фигура 68).

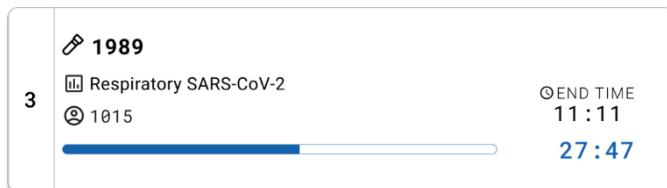

Фигура 68. Изглед на изминалото време за изпълнение и приблизителното време на завършване.

Ако тестът е завършен се показват съобщение „**test completed**“ (тестът е завършен) и крайното време за изпълнението (Фигура 69).

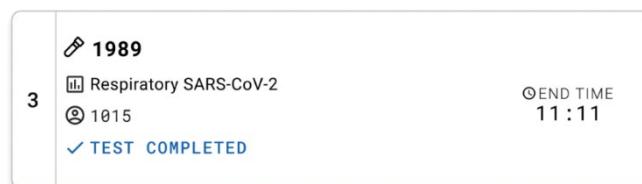

Фигура 69. Изглед „Test completed“ (Тестът е завършен)


Приоритизиране на аликовотни части

Ако аликовотна част трябва да бъде изпълнена спешно е възможно да изберете тази аликовотна част от екрана с чакащи на опашка аликовотни части и да се изпълни като първа аликовотна част (Фигура 70). Имайте предвид, че не е възможно да приоритизирате аликовотна част след потвърждаване на опашката.

Приоритизиране на аликовотна част преди стартиране на цикъл


Спешната аликовотна част е избрана на екрана с аликовотните части в опашката и е маркирана като **URGENT** (СПЕШНА) от дясната страна на екрана с аликовотните части в опашката преди *confirm data to run* (потвърждаване на данни за изпълнение). (Фигура 70). След това аликовотната част се придвижва в първата позиция от опашката чакащи (Фигура 71). Имайте предвид, че може да се приоритизира само една аликовотна част.

Забележка: необходимо е да отворите и затворите входното отделение, в противен случай приоритизирането на касета, която вече е била потвърдена не е възможно. В този момент бутона **Urgent** (Спешна) не е активен. Операторът трябва да превключи между разделите **QUEUE** (ОПАШКА) и **IN PROGRESS** (В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ) на GUI, за да види активния бутона **Urgent** (Спешна).

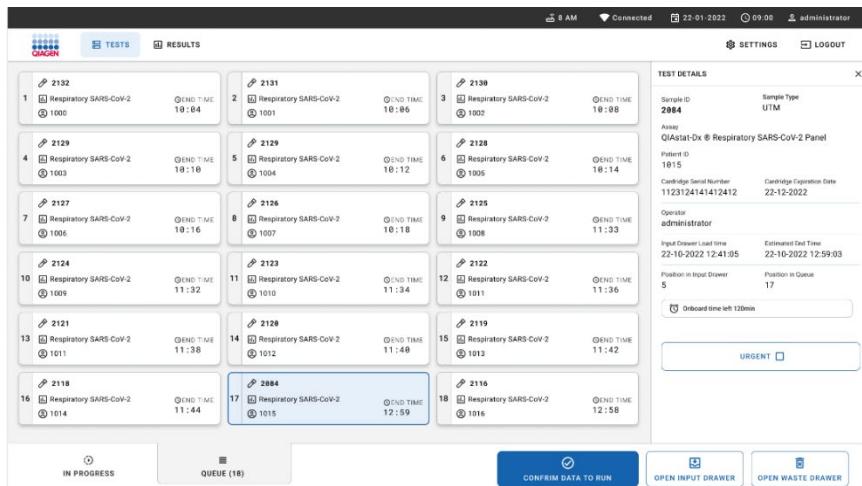


Фигура 70. Екран с опашка от чакащи аликовотни части при избор на аликовотна част за приоритизиране

Времето на стабилност на някои други аликовотни части може да изтече поради приоритизиране на аликовотна част. Това предупреждение може да се види в десния ъгъл на екрана (Фигура 71).

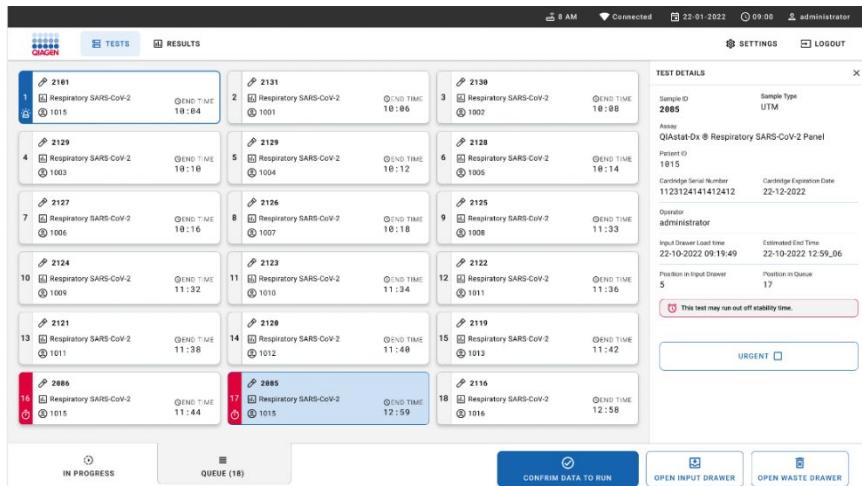

Фигура 71. Екран с аликовотните части в опашката след приоритизиране на аликовотна част


След потвърждаване на опашката от чакащи, цикълът може да бъде стартиран (Фигура 72).

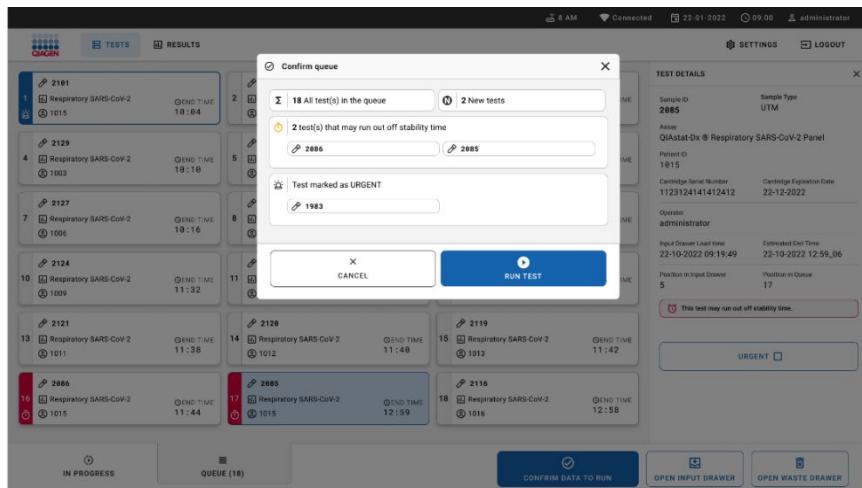

Фигура 72. Потвърждаване на екрана с цикъла

Приоритизиране на аликовотна част по време на цикъл

Аликовотна част може да се приоритизира по всяка причина по време на цикъла. В този случай, ако няма наличен АМ, друга текуща аликовотна част трябва да бъде прекратена, за да се извърши приоритизиране (Фигура 73).

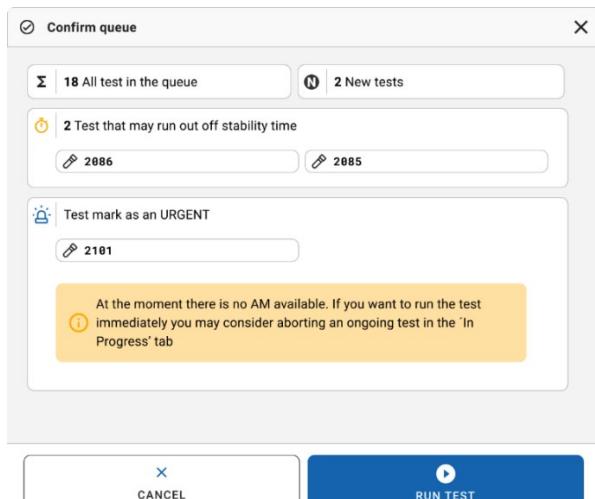


Фигура 73. Диалогов прозорец за потвърждаване по време на цикъл

Прекратяване на изпълняваща се аликовотна част

Аликовотна част може да бъде прекратена по време на сканиране, зареждане и обработка. Имайте предвид, че аликовотната част не може да се използва повторно, след като бъде прекратена, това важи и за аликовотната част, която е прекратена по време на сканиране и зареждане.


За да прекратите аликовотна част, отидете в раздела „in progress“ (в процес на изпълнение) на екрана, изберете аликовотната част и натиснете опцията „abort“ (прекратяване) в десния ъгъл на екрана (Фигура 74).

Не е възможно да се прекъсне изпълнението, докато дадена аликовотна част е на път да се зареди в АМ или е на път да завърши изпълнението и системата извлича данни за резултатите или/и технически регистрационни файлове от съответния АМ.

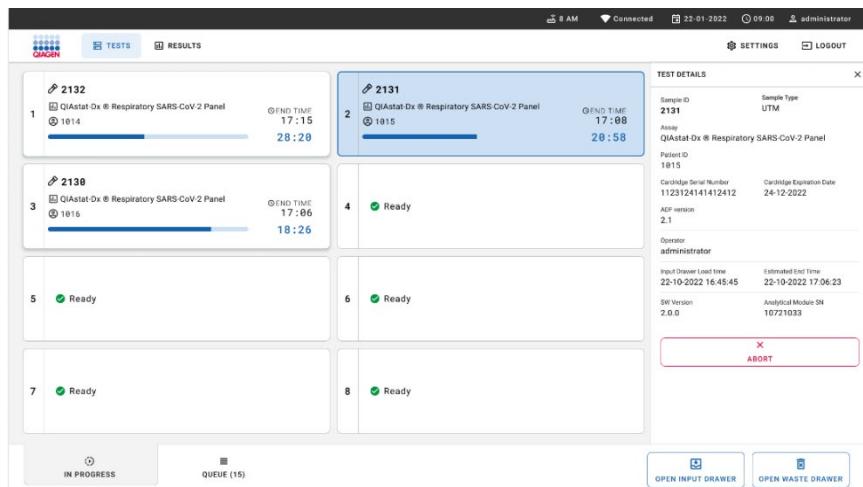


Фигура74. Прекратяване на аликовтна част в процес на изпълнение

Системата изиска потвърждение за прекратяване на аликовтната част (Фигура 75).

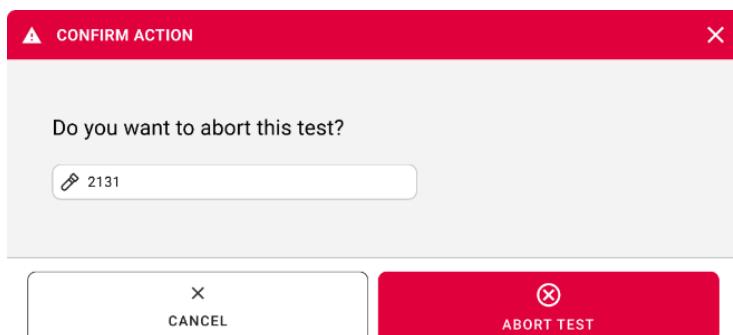


Фигура 75. Диалогов прозорец за потвърждаване на прекратяване на аликовтна част в процес на изпълнение

След известно време аликовтната част може да бъде видяна като „aborted“ (прекратена) на екрана (Фигура 76 и 77).

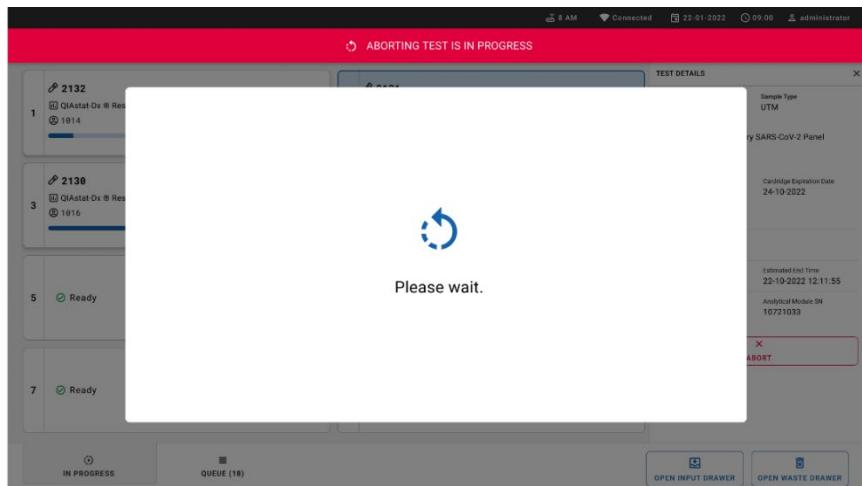

Фигура 76. Диалогов прозорец за изчакване на прекратяване на аликовотна част

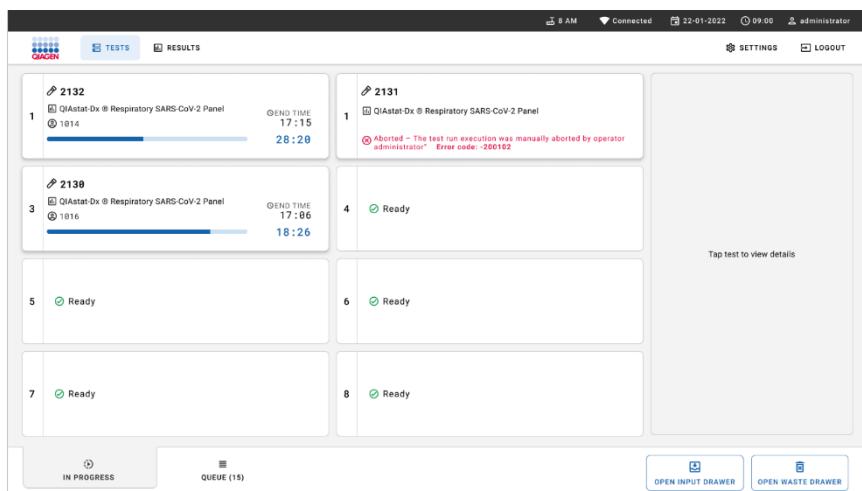


Фигура 77. Прекратена проба след потвърждаване на прекратяването

Интерпретиране на резултатите

Преглед на резултатите с QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 автоматично интерпретира и запазва резултатите от теста. След изваждане на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge автоматично се показва екранът **Summary** (Резюме) с резултатите (Фигура 78).

Фигура 78 показва екрана за QIAstat-Dx Analyzer 1.0

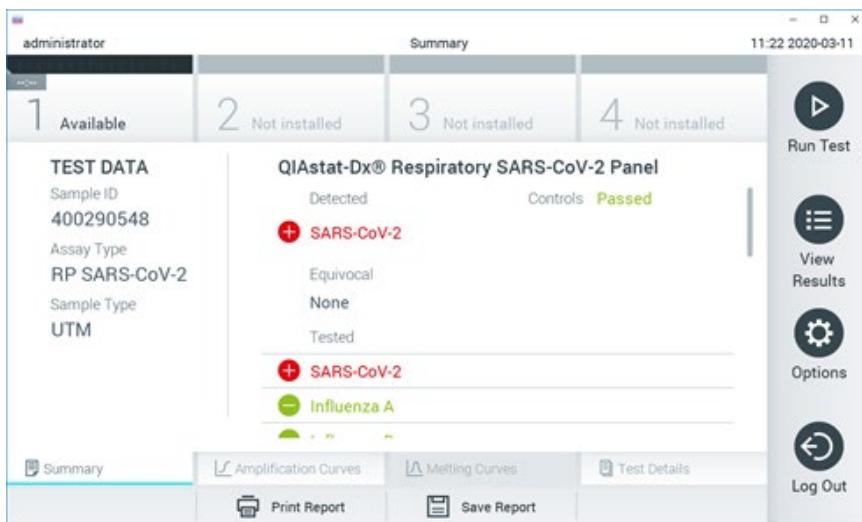


Фигура 78. Примерен екран „Summary“ (Резюме) с резултатите, показващ „Test Data“ (Данни за теста) в лявото каре и „Summary“ (Резюме) за теста в основното каре в QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

От този еcran са достъпни други раздели с повече информация, която ще бъде обяснена в следващите глави:

- Криви на амплификация
- Криви на стопяване. Този раздел е деактивиран за QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.
- Подробности за теста.

Фигура 79 показва екрана за QIAstat-Dx Analyzer 2.0

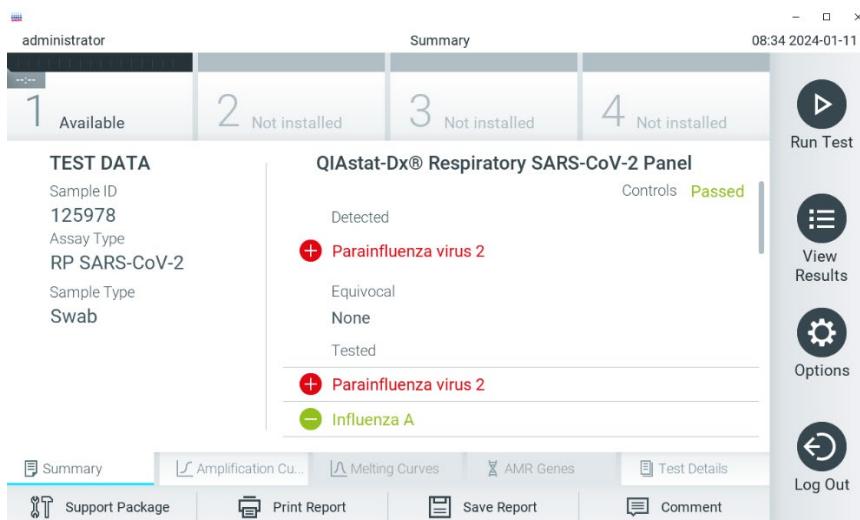

Фигура 79. Примерен екран „Summary“ (Резюме) с резултатите, показващи „Test Data“ (Данни за теста) в лявото каре и „Summary“ (Резюме) за теста в основното каре в QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

QIAstat-Dx Analyzer 2.0 включва допълнителен раздел:

- AMR гени. Той е деактивиран за QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Забележка: От този момент нататък ще се използват примерни екранни снимки, когато се говори за QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и/или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, където обяснените функции са едни и същи.

Основната част от екрана съдържа следните три списъка и обозначава резултатите с оцветяване и символи:

- Първият списък, под заглавието „Detected“ (Открити), включва всички открити и идентифицирани патогени в аликовтната част, със знак + отпред и оцветени в червено.

- Вторият списък, под заглавието „Equivocal“ (Двусмислени), не се използва. Резултатите „Equivocal“ (Двусмислени) не са приложими за QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. Затова списъкът „Equivocal“ (Двусмислени) винаги ще бъде празен.
- Третият списък, под заглавието „Tested“ (Тествани), включва всички тествани патогени в аликовотната част. Патогените, които са открити и идентифицирани в аликовотната част, се предшестват от знака и са в червено. Патогените, които са тествани, но не са открити, се предшестват от знака и са в зелено.

Забележка: Откритите и идентифицираните патогени в аликовотната част се изброяват и в двата списъка – „Detected“ (Открити) и „Tested“ (Тествани).

Ако тестът не завърши успешно, ще се покаже съобщение **Failed** (Неуспешен), следвано от конкретния код на грешката.

В лявата част на екрана се показват следните Test Data (данни за теста):

- Sample ID (Идентификатор на аликовотна част)
- Assay Type (Тип анализ)
- Sample Type (Тип аликовотна част)

В зависимост от правата за достъп на оператора се дават допълнителни данни за анализа в разделите в долната част на екрана (напр. графики на амплификация и подробности за теста).

Може да се експортира отчет с данните от анализа към външно USB устройство за съхранение. Поставете USB устройството за съхранение в един от USB портовете на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и натиснете „**Save Report**“ (Записване на отчет) в долната лента на екрана. Този отчет може да се експортира по всяко време след това чрез избиране на теста от списъка **View Result** (Преглед на резултатите).

Отчетът може да се изпрати и към принтер чрез натискане на **Print Report** (Отпечатване на отчета) в най-долната лента на екрана.

Преглед на кривите на усилване

За да видите кривите на амплификация от теста на откритите патогени, натиснете раздела  **Amplification Curves** (Криви на амплификация) (Фигура 80).



Фигура 80. Екран **Amplification Curves** (Криви на амплификация) (раздел **PATHOGENS** (ПАТОГЕНИ)).

Вляво се показват подробности за тестваните патогени и контроли, а в центъра – кривите на амплификация.

Забележка: Ако **User Access Control** (Контрол на достъпа на потребителите) е включен на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, экранът **Amplification Curves** (Криви на амплификация) е достъпен само за оператори със съответните права на достъп.

Натиснете раздела **PATHOGENS** (ПАТОГЕНИ) отляво, за да се покажат графиките, съответстващи на тестваните патогени. Натиснете името на патогена, за да изберете кои патогени да се показват в графиката на амплификацията. Може да изберете един, няколко или нито един патоген. На всеки патоген в избрания списък ще се зададе цвет, съответстващ на кривата на амплификация, свързана с патогена. Неизбранные патогени ще се показват в сиво.

Съответните стойности на Ct и флуоресценция в крайна точка (EP) са дадени под всяко име на патоген.

Натиснете раздела **CONTROLS** (КОНТРОЛИ) от лявата страна, за да видите контролите в графиката на амплификацията. Натиснете кръгчето до името на контролата, за да я изберете или отмените нейния избор (Фигура 81).



Фигура 81. Екран **Amplification Curves** (Криви на амплификация) (раздел **CONTROLS** (КОНТРОЛИ)).

Графиката на амплификация показва кривата от данните за избраните патогени или контроли. За да превключите между логаритмична и линейна скала за оста Y, натиснете бутона **Lin** (Линейна) или **Log** (Логаритмична) в долния ляв ъгъл на графиката.


Машабът на осите X и Y може да се регулира със **сините хващащи** на всяка ос. Натиснете и задръжте **син хващац**, след което го придвижете до желаното място по оста. Придвижете **син хващац** до началото на оста, за да върнете стойностите по подразбиране.

Преглед на подробности за теста

Натиснете  **Test Details** (Подробности за теста) в лентата с разделите в долната част на сензорния екран, за да прегледате резултатите по-подробно. Превърнете надолу, за да видите пълния фиш.

В центъра на екрана се показват следните Test Details (Подробности за теста) (Фигура 82):


- User ID (Идентификатор на потребител)
- Cartridge SN (Сериен номер на касетата)
- Cartridge Expiration Date (Срок на годност на касетата)
- Module SN (Сериен номер на модула)
- Test Status (Състояние на теста) – Completed (Изпълнен), Failed (Неуспешен) или Canceled by operator (Отменен от оператора)
- Error Code (Код на грешката) (ако има)
- Test Start Date and Time (Начална дата и час на теста)
- Test Execution Time (Време за изпълнение на теста)
- Assay Name (Име на анализа)
- Test ID (Идентификатор на теста)
- Test Result (Резултат от теста):
 - Positive (Положителен) (ако поне един респираторен патоген е открит/идентифициран)
 - Negative (Отрицателен) (няма открит респираторен патоген)
 - Invalid (Невалиден)
- Списък на тестваните анализи в анализа, със Ct и флуоресценция в крайна точка при положителен сигнал
- Вътрешна контрола със Ct и флуоресценция в крайна точка

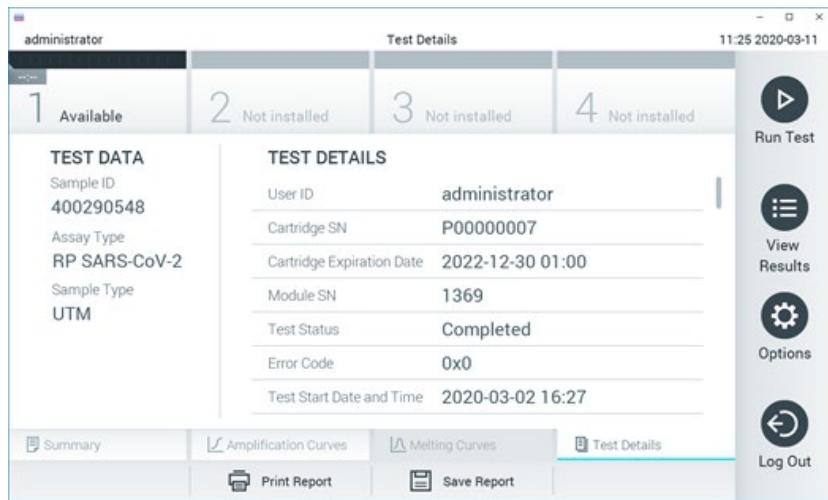

Фигура 82. Примерен екран, показващ „Test Data“ (Данни за теста) в левия панел и „Test Details“ (Подробности за теста) в основния панел.

Преглед на резултатите от предишни тестове

За да видите резултати от предишни тестове, съхранени в хранилището за резултати, натиснете  **View Results** (Преглед на резултатите) на лентата с главното меню (Фигура 83).

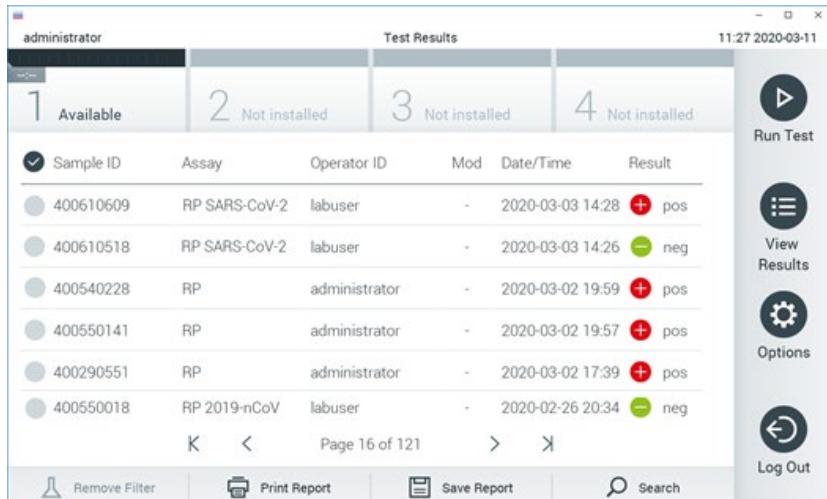

1 Available	2 Not installed	3 Not installed	4 Not installed		
Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
400610609	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:28	pos
400610518	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:26	neg
400540228	RP	administrator	-	2020-03-02 19:59	pos
400550141	RP	administrator	-	2020-03-02 19:57	pos
400290551	RP	administrator	-	2020-03-02 17:39	pos
400550018	RP 2019-nCoV	labuser	-	2020-02-26 20:34	neg

Фигура 83. Примерен екран „View Results“ (Преглед на резултатите).

За всеки изпълнен тест се дава следната информация (Фигура 84):

- Sample ID (Идентификатор на аликвотна част)
- Assay (Анализ) (име на анализ за тест, което е „RP“ за Respiratory Panel (Респираторен панел))
- Operator ID (Идентификатор на оператора)
- Mod (аналитичен модул, в който е изпълнен тестът)
- Date/Time (Дата/час) (датата и часът на завършване на теста)
- Result (Резултат) (резултатът от теста: positive (положителен) [pos], negative (отрицателен) [neg], failed (неуспешен) [fail] или successful (успешен) [suc])

Забележка: Ако **User Access Control** (Контрол на достъпа на потребителите) е включен на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, данните, за които потребителят няма права на достъп, ще бъдат скрити със звездички.

Изберете един или повече резултати от тестове, като натиснете **сивото кръгче** вляво от идентификатора на аликовотната част. До избраните резултати ще се покаже **отметка**. Можете да отмените избора на резултати от тестове, като натиснете тази **отметка**. Целият списък с резултати може да се избере с натискане на **кръгчето с отметка** на горния ред (Фигура 84).

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
400610609	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:28	pos
400610518	RP SARS-CoV-2	labuser	-	2020-03-03 14:26	neg
400540228	RP	administrator	-	2020-03-02 19:59	pos
400550141	RP	administrator	-	2020-03-02 19:57	pos
400290551	RP	administrator	-	2020-03-02 17:39	pos
400550018	RP 2019-nCoV	labuser	-	2020-02-26 20:34	neg

Фигура 84. Примерен екран на избор на резултати от теста във „View Results“ (Преглед на резултатите).

Натиснете някъде в реда с теста, за да видите резултата за конкретен тест.

Натиснете заглавие на колона (напр. **Sample ID** (Идентификатор на аликовотна част)), за да сортирате списъка във възходящ или низходящ ред според този параметър. Във всеки момент списъкът може да се сортира само по една графа.

В графата **Result** (Резултат) е показан резултатът от всеки тест (Таблица 2):

Таблица 2. Описания на резултатите от теста

Резултат	Резултат	Описание
Positive (Положителен)	pos	Поне един патоген е положителен
Negative (Отрицателен)	neg	Не са открити патогени

Failed (Неуспешен)	 fail	Тестът е неуспешен поради възникнала грешка или отмяна от страна на потребителя
Successful (Успешен)	 suc	Тестът е положителен или отрицателен, но потребителят няма необходимите права за достъп, за да прегледа резултатите от теста

С QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 трябва да има свързан принтер и правилният драйвер трябва да бъде инсталиран. Натиснете **Print Report** (Отпечатване на отчета), за да отпечатате отчет(и) за избрания(ите) резултат(и).

Натиснете **Save Report** (Записване на отчета), за да запишете отчета/ите за избрания(ите) резултат(и) в PDF формат на външно USB устройство за съхранение.

Изберете вида на фиша: **List of Tests** (Списък с тестове) или **Test Reports** (Отчети за тестове).

Натиснете **Search** (Търсене), за да търсите резултатите от тестовете по „Sample ID“ (Идентификатор на аликовтната част), „Assay“ (Анализ) и „Operator ID“ (Идентификатор на оператор). Въведете текста за търсене с виртуалната клавиатура и натиснете **Enter** (Въвеждане), за да започнете търсенето. В резултатите от търсенето ще се покажат само записите, съдържащи търсения текст.

Ако списъкът с резултати е бил филтриран, търсенето ще се извършва само във филтрирания списък.

Натиснете и задръжте заглавие на колона, за да приложите филтър по съответния параметър. За някои параметри, като **Sample ID** (Идентификатор на аликовтната част), ще се покаже виртуалната клавиатура, за да може да се въведе текста за търсене на филтъра.

За други параметри – например **Assay** (Анализ) – ще се отвори диалогов прозорец със списък от анализи, съхранени в хранилището. Изберете един или повече анализи, за да филтрирате само тестовете, които са изпълнени с избраните анализи.

Символът  вляво от заглавието на графата показва, че филтърът по тази графа е активен.

Може да премахнете филтър, като натиснете **Remove Filter** (Премахване на филтър) в лентата с подменюто.

Експортиране на резултати в USB устройство

От всеки раздел на екрана **View Results** (Преглед на резултатите) можете да изберете **Save Report** (Записване на отчета), за да експортирате и запишете копие от резултатите от теста в PDF файл на USB устройство. USB портът е разположен отпред на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Отпечатване на резултати

С QIAstat-Dx Analyzer 1.0 трябва да има свързан принтер и правилният драйвер трябва да бъде инсталиран. Натиснете **Print Report** (Отпечатване на отчет), за да изпратите копие от резултатите от теста към принтера.

Интерпретиране на резултатите

Резултатът за респираторен организъм се интерпретира като положителен, когато съответстващият анализ с PCR е положителен освен за грип А. Анализът на грип А в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е предназначен за откриване съответно на грип А, както и грип А подтип H1N1/2009, грип А подтип H1 или грип А подтип H3. Помислено това означава:

Ако щам H1 на сезонен грип А бъде открит от анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, два сигнала ще се генерират и покажат на екрана на QIAstat-Dx Analyzer 1.0: един за грип А и втори за щама H1.

Ако щам H3 на сезонен грип А бъде открит от анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, два сигнала ще се генерират и покажат на екрана на QIAstat-Dx Analyzer 1.0: един за грип А и втори за щама H3.

Ако щам H1N1/2009 на пандемичен грип А бъде открит, два сигнала ще се генерират и покажат на екрана на QIAstat-Dx Analyzer 1.0: един за грип А и втори за H1N1/2009.

ВАЖНО: Ако има само сигнал за грип А и няма друг генериран сигнал за някой от подтиповете, това може да се дължи на ниска концентрация или – в много редки случаи – на нов вариант или щам на грип А, различен от H1 и H3 (например H5N1, който може да заразява хора). В случаите, когато се открие само сигнал за грип А и има клинично съмнение за несезонен грип А, се препоръчва повторно тестване. По същия начин, в случай че се открие само някой от подтиповете на грип А и няма допълнителен сигнал за грип А, това също може да се дължи на ниска концентрация на вируса.

За всеки друг патоген, който може да се открие с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, ще се генерира само един сигнал, ако патогентът присъства в аликовотната част.

Интерпретиране на вътрешната контрола

Резултатите от вътрешната контрола се интерпретират по Таблица 3.

Таблица 3. Интерпретиране на резултати от вътрешна контрола

Резултат за контролата	Обяснение	Действие
Passed (Успешен)	Амплификацията на вътрешната контрола е успешна	Изпълнението е успешно. Всички резултати са валидни и могат да се съобщат. Откритите патогени се съобщават като positive (положителни), а неоткритите – като negative (отрицателни).
Failed (Неуспешен)	Вътрешната контрола е неуспешна	Отчитат се положително откритите патогени, но всички отрицателни резултати (тествани, но неоткрити патогени) са невалидни. Повторете тестването, като използвате нова QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.

Интерпретиране на резултатите с QIAstat-Dx Rise

Преглед на резултатите с QIAstat-Dx Rise

QIAstat-Dx Rise автоматично интерпретира и записва резултатите от теста. След като цикълът завърши, резултатите могат да се видят в екрана с обобщение на резултатите **Results (РЕЗУЛТАТИ)** (Фигура 85).

Забележка: Видимата информация ще зависи от правата за достъп на оператора.

Sample ID / Patient ID	Operator ID	End day & time	Assay Type	Result
2342 0 1015	administrator	22-03-2022 17:25:01	RP SARS-CoV-2	Positive
2341 0 1013	administrator	22-03-2022 17:38:02	RP SARS-CoV-2	Negative
2340 0 1014	administrator	22-03-2022 17:52:34	RP SARS-CoV-2	Negative
2339 0 1011	administrator	22-03-2022 18:08:33	RP SARS-CoV-2	Negative
2338 0 1012	administrator	22-03-2022 18:22:11	RP SARS-CoV-2	Positive
2337 0 1088	administrator	22-03-2022 18:37:12	RP SARS-CoV-2	Negative
2336 0 1010	administrator	22-03-2022 18:50:01	RP SARS-CoV-2	Negative
2335 0 1089	administrator	22-03-2022 19:04:45	RP SARS-CoV-2	Negative
2334 0 1066	administrator	22-03-2022 19:21:09	RP SARS-CoV-2	Negative
2332 0 1087	administrator	22-03-2022 19:35:06	RP SARS-CoV-2	Negative

Фигура 85. Екранът за обобщение „Results“ (Резултати).

Основната част от екрана предоставя преглед на изпълнените цикли и обозначава резултатите с оцветяване и символи:

- Ако поне един патоген е открит в аликовотната част, думата **Positive** (Положителен) се показва в колоната с резултати, със знак + пред нея.
- Ако не е открит патоген и вътрешната контрола е валидна, думата **Negative** (Отрицателен) се показва в колоната с резултати, със знак - пред нея.
- Ако в аликовотната част е открит поне един патоген и вътрешната контрола е невалидна, терминът **Positive with warning** (Положителен с предупреждение) се показва в графата с резултати, предшестван от знака +!.

- Ако тестът не завърши успешно, ще се покаже съобщение Failed (Неуспешен), следвано от конкретния код на грешката.

На екрана се показват следните Test Data (Данни за теста) (Фигура 85)

- Sample ID/Patient ID (Идентификатор на аликовотната част/ Идентификатор на пациента)
- Operator ID (Идентификатор на оператора)
- End day and time (Краен ден и час)
- Assay Type (Тип анализ)

Преглед на подробности за теста

В зависимост от правата за достъп на оператора се дават допълнителни данни за анализа чрез бутона **Details** (Подробности) в дясната част на екрана (например графики на амплификация и подробности за теста (Фигура 86)).

The screenshot shows the 'TESTS' tab selected in the top navigation bar. Below it, the 'RESULTS' tab is active. A sub-menu bar includes 'RESULTS', 'DETAILS', 'SETTINGS', and 'LOGOUT'. The main content area displays test details for a sample identified by Sample ID 2091. The assay type is RPP SARS-CoV-2 IUO, and the sample type is UTM. The test result is Positive, and the internal control status is Passed. The test status is Completed. On the left, a sidebar lists detected viruses: Parainfluenza virus 3, Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, and SARS-CoV-2. The right side shows a table titled 'Tested viruses' with rows for various viruses, each with a status indicator (green dot for Not detected, red dot for Detected). The table also includes a 'CL/EP' column with values like 37.1 / 102,154. At the bottom, there are tabs for 'SUMMARY' and 'AMPLIFICATION CURVE', and a 'SAVE REPORT' button.

Assay Type	Sample Type	Sample ID	Test Result	Internal Control	Test status
RPP SARS-CoV-2 IUO	UTM	2091	Positive	Passed	Completed

Tested viruses		
Influenza A	Not detected	
Influenza B	Not detected	
Influenza A H1N1 pdm09	Not detected	
Coronavirus 229E	Not detected	
Coronavirus OC43	Not detected	
Coronavirus NL63	Not detected	
Coronavirus HKU1	Not detected	
Parainfluenza virus 1	Not detected	
Parainfluenza virus 2	Not detected	
Parainfluenza virus 3	Detected	CL/EP: 37.1 / 102,154
Parainfluenza virus 4	Not detected	
Influenza A H1	Not detected	
Influenza A H3	Not detected	
Rhinovirus/Enterovirus	Not detected	
Adenovirus	Detected	CL/EP: 37.1 / 102,154


Фигура 86. Екран „Test details“ (Подробности за теста).

В горната част на екрана е показана обща информация за теста. Тя включва типа на анализа и типа на аликовотната част, идентификатора на аликовотната част, общи резултати от теста, статуса на вътрешната контрола и статуса на теста.

В лявата част на екрана са показани всички открити патогени, в средата на екрана са показани всички патогени, които анализът може да открие. В дясната страна на екрана се показват следните подробности за теста: Идентификатор на аликовотната част, идентификатор на оператора, номер на партидата с касети, сериен номер на касетата, дата на изтичане на срока на годност на касетата, дата и час на зареждане на касетата, дата и час на изпълнение на теста, продължителност на изпълнението на теста, версия на софтуера и ADF версия, и сериен номер на аналитичния модул.

Преглед на кривите на усилване

За да прегледате кривите на амплификация от теста, натиснете раздела Amplification Curves (Крива на амплификация) в долната част на екрана (Фигура 87).

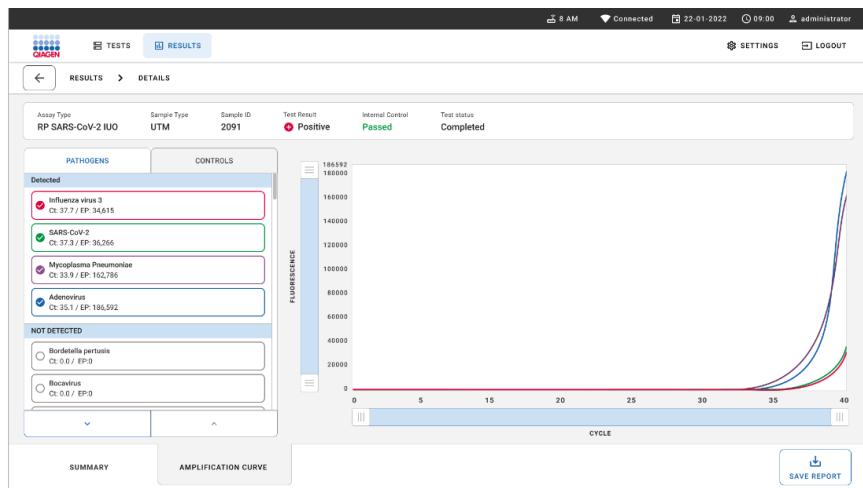

Фигура 87. Екран „Amplification Curves“ (Криви на амплификация).

Натиснете раздела **PATHOGENS** (ПАТОГЕНИ) отляво, за да се покажат графиките, съответстващи на тестваните патогени. Натиснете **името на патогена**, за да изберете кои патогени да се показват в графиката на амплификацията. Може да изберете един, няколко или нито един патоген. На всеки патоген в избрания списък ще се зададе цвят, съответстващ на кривата на амплификация, свързана с патогена. Неизбранныте патогени няма да се покажат.

Съответните стойности на Ст и флуоресценция в крайна точка са дадени под всяко име на патоген. Патогените се групират в **detected** (открити) и **not detected** (неоткрити).

Натиснете раздела **CONTROLS** (КОНТРОЛИ) отляво, за да прегледате контролите и да изберете кои от тях да се показват в графиката на амплификацията.

Преглед на резултатите от предишни тестове

За да видите резултати от предишни тестове, съхранени в хранилището за резултати, използвайте функцията за търсене в основния еcran с резултати (Фигура 88).

Забележка: Тази функция може да е ограничена или деактивирана поради настройките на потребителския профил.

Sample ID / Patient ID	Operator ID	End day & time	Assay Type	Result	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory Panel	Negative	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory Panel	Positive	Details
23423 423415 32453 88855	User Name	22-03-2021 19:35	Respiratory SARS-CoV-2	Negative	Details

Фигура 88. Функцията за търсене на екрана „Results“ (Резултати).

Експортиране на резултати към USB устройство за съхранение

От екрана **Results** (Резултати) изберете отделно или всички с бутона **Select All** (Избор на всички), за да експортирате и запазите копие от отчети от теста в PDF формат в USB устройство за съхранение. USB портът се намира в предната част на апаратът.

Забележка: Препоръчва се USB устройството за съхранение да се използва само за краткосрочно съхранение и пренос на данни. Използването на USB устройство за съхранение подлежи на ограничения (напр. размера на паметта или риска от презаписване), които трябва да се вземат предвид преди употреба.

Контрол на качеството

В съответствие със сертифицираната по ISO система за управление на качеството на QIAGEN всяка партида от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е преминала изпитване по предварително определени спецификации, за да се гарантира постоянно качество на продукта.

Ограничения

- Резултатите от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel не са предназначени да служат като единствена основа за диагностициране, лечение или други решения относно пациента.
- Положителните резултати не изключват коинфекция с организми, които не са включени в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. Откритите агенти може да не са категоричната причина за заболяването.
- Отрицателните резултати не изключват възможност за инфекция на горните дихателни пътища. Чрез този анализ не се откриват всички агенти на остра респираторна инфекция, а чувствителността при някои клинични условия може да се различава от описаната в листовката.
- Отрицателният резултат от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel не изключва инфекциозното естество на синдрома. Отрицателните резултати от анализа може да се дължат на няколко фактора и комбинирането им, включително неправилно боравене с аликовотните части, отклонения в последователностите на нуклеиновите киселини, изследвани от анализа, инфекции от организми, които не са включени в анализа, нива на включени в анализа организми, които са под границата на откриване за анализа, както и употреба на определени лекарства, терапии или агенти.
- QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel не е предназначен за тестване на аликовотни части, различни от описаните в настоящите инструкции за употреба. Работните характеристики на теста са установени само с аликовотни части с назофарингеален тампон, взети в транспортна среда, от лица с остри респираторни симптоми.

- QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel е предназначен за употреба съвместно с използваните при стандартните грижи култури за възстановяване, серотипизиране и/или тестване за антимикробна податливост на организмите, когато е приложимо.
- Резултатите от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel трябва да се интерпретират от обучен здравен специалист в контекста на всички приложими клинични, лабораторни и епидемиологични констатации.
- QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel може да се използва само с анализатори QIAstat-Dx Analyzer 1.0, QIAstat-Dx Analyzer 2.0 и QIAstat-Dx Rise*.
- QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel представлява качествен анализ и не дава количествена стойност за откритите организми.
- Възможно е да има упорити вирусни и бактериални нуклеинови киселини ин виво, дори ако организмът не е жизнеспособен или инфекциозен. Откриването на целеви маркер не означава, че съответният организъм е причинителят на инфекцията или клиничните симптоми.
- Откриването на вирусни и бактериални нуклеинови киселини зависи от правилното взимане, боравене, транспортиране, съхранение и зареждане на аликвотните части в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Неправилното изпълнение на всеки от гореспоменатите процеси може да доведе до неправилни резултати, включително грешни положителни или грешни отрицателни.
- Чувствителността и специфичността на анализа за конкретни организми и общо за всички организми са характерни параметри за ефективността на даден анализ и не трябва да се променят в зависимост от преваленса. За разлика от това, както отрицателните, така и положителните прогностични стойности в резултатите от теста зависят от преваленса на заболяването/организма. Имайте предвид, че по-висок преваленс благоприятства положителните, а по-нисък – отрицателните прогностични стойности в резултатите от теста.
- Не използвайте повредени касети. За работа с повредени касети вижте глава Информация за безопасността.

* Апарати DiagCORE Analyzer със софтуер QIAstat-Dx версия 1.3 или по-нова могат да се използват като алтернатива на апаратите QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Работни характеристики

Анализът QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (каталожен № 691214) е разработен чрез въвеждане на целеви организъм на SARS-CoV-2 в отделна реакционна камера на анализа QIAstat-Dx Respiratory Panel (каталожен № 691211). Известно е, че подготвянето на пробата и RT-qPCR в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge са обичайни стъпки за всички целеви организми. В касетата, сборната аликовотна част и PCR ензимната смес са разпределени равномерно във всяка реакционна камера. В резултат на това и/или на наличността на клинични преби на SARS-CoV-2, някои проучвания, показани по-долу, не са извършени или повторени с използване на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Клинични работни характеристики

Клиничните работни характеристики, показани по-долу, са демонстрирани с помощта на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Analyzer 2.0. QIAstat-Dx Rise използва същите аналитични модули като QIAstat-Dx Analyzer 1.0, поради което работните характеристики не се влияят от QIAstat-Dx Rise or QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

Преби в течна транспортна среда

Работните характеристики на анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel са оценени в многоцентрово клинично изпитване в осем (8), географски различни изследователски центрове: пет (5) центъра в САЩ и три (3) центъра в Европейския съюз. Характеристиките на преба с назофарингеален тампон бяха оценени с универсална транспортна среда (UTM) (Copan Diagnostics); MicroTest™ M4®, M4RT®, M5®, и M6™ (Thermo Fisher Scientific); BD™ Universal Viral Transport (UVT) System (Becton Dickinson и Company); HealthLink® Universal Transport Medium (UTM) System (HealthLink Inc.); Universal Transport Medium (Diagnostic Hybrids Inc.); V-C-M Medium (Quest Diagnostics); UniTranz-RT® Universal Transport Media (Puritan Medical Products Company); и сухи преби от назофарингеален тампон (FLOQSwabs, Copan, кат.№ 503CS01). Когато използвате тампон, той се вкарва директно в отвора за тампон на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge след вземане на пребата, като се избягва прехвърлянето в течна среда.

Това проучване е конфигурирано като обсервационно проспективно-ретроспективно проучване с употреба на аликовотни части, останали от участници с признания и симптоми на остра респираторна инфекция. От участващите центрове се изисква да тестват пресни и/или замразени клинични аликовотни части съгласно протокол и конкретни за центъра инструкции.

Аликовотни части, тествани с използване на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, се сравняват с резултатите от метода(ите), използвани в стандартните грижи (Standard Of Care, SOC) в центровете, както и с разнообразни утвърдени и достъпни на пазара молекулярни методи. Този подход осигурява резултати за патогени, които не се откриват чрез SOC и/или позволяват окончателно разрешаване на несъответствията в несъгласуваните резултати. Резултатите от анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel са сравнени с анализи FilmArray® Respiratory Panel 1.7 & 2 и SARS-CoV-2 RT-PCR, разработени от Института по вирусология, Университетска болница „Charité“, Берлин, Германия.

В проучването участват общо 3065 клинични UTM проби от пациенти. Общо 121 преби не изпълняват критериите за включване и изключване и следователно са изключени от анализа.

Клиничната чувствителност или процентът на съвпадение на положителните резултати (Positive Percent Agreement, PPA) е изчислен като $100\% \times (TP/[TP + FN])$. Верен положителен (True Positive, TP) означава, че QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel и сравнителните методи дават положителен резултат за организма, а грешен отрицателен (False Negative, FN) означава, че QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel дава отрицателен резултат, а резултатите от сравнителните методи са положителни.

Специфичността или процентното съвпадение на отрицателните резултати (Negative Percent Agreement, NPA) са изчислени като $100\% \times [TN/(TN + FP)]$. Верен отрицателен (True Negative, TN) означава, че QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel и сравнителните методи дават отрицателен резултат, а грешен положителен (False Positive, FP) означава, че QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel дава положителен резултат, а резултатите от сравнителните методи са отрицателни. За изчисляване на клиничната специфичност на отделните патогени бяха използвани общите налични резултати, като съответните истински и фалшиво положителни резултати за организма бяха извадени. За всяка точкова оценка е изчислен точен биномен двустранен 95% доверителен интервал.

Общата клинична чувствителност (Overall Clinical Sensitivity, PPA) и общата клинична специфичност (Overall Clinical Specificity, NPA) са изчислени от 2579 резултати от преби.

Констатирани са общо 2575 верни положителни и 52 925 верни отрицателни резултати от QIAstat-Dx Respiratory Panel и QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel, както и 76 грешни отрицателни и 104 грешни положителни резултати.

В Таблица 4 са дадени клиничната чувствителност (или процент на съвпадение на положителните резултати) и клиничната специфичност (или процент на съвпадение на отрицателните резултати) на QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel с 95% доверителни интервали.

Таблица 4. Работни характеристики на QIAstat-Dx Respiratory Panel

	TP/ (TP+FN)	Чувствителност/ PPA (%)	95% CI	TN/(TN+FP)	Специфичност/ NPA (%)	95% CI
Общо	2575/2651	97,13	96,42 – 97,73	52 925/53 029	99,80	99,76 – 99,84
Вируси						
Аденовирус	136/139	97,84	93,85 – 99,26	2617/2626	99,66	99,35 – 99,82
Коронавирус 229E	38/39	97,44	86,82 – 99,55	2735/2735	100	99,86 – 100,00
Коронавирус HKU1	73/74	98,65	92,73 – 99,76	2690/2696	99,78	99,52 – 99,90
Коронавирус NL63	88/97	90,72	83,30 – 95,04	2677/2677	100	99,86 – 100,00
Коронавирус OC43	66/66	100	94,50 – 100,00	2704/2705	99,96	99,79 – 99,99

	TP/ (TP+FN)	Чувствителност/ PPA (%)	95% CI	TN/(TN+FP)	Специфичност/ NPA (%)	95% CI
					NPA (%)	
Общо	2575/2651	97,13	96,42 – 97,73	52 925/53 029	99,80	99,76 – 99,84
Вируси						
Аденовирус	136/139	97,84	93,85 – 99,26	2617/2626	99,66	99,35 – 99,82
Коронавирус 229E	38/39	97,44	86,82 – 99,55	2735/2735	100	99,86 – 100,00
Коронавирус HKU1	73/74	98,65	92,73 – 99,76	2690/2696	99,78	99,52 – 99,90
Човешки метапневмовирус A+B	142/147	96,60	92,29 – 98,54	2627/2629	99,92	99,72 – 99,98
Грип А	327/329	99,39	97,81 – 99,83	2407/2430	99,05	98,58 – 99,37
Грип А H1	0/0	НЕПРИЛОЖИМО	НЕПРИЛОЖИМО	2774/2774	100,00	99,86 – 100,00
Грип А H1N1 pdm09	124/126	98,41	94,40 – 99,56	2634/2639	99,81	99,56 – 99,92
Грип А H3	210/214	98,13	95,29 – 99,27	2558/2561	99,88	99,66 – 99,96
Грип В	177/184	96,20	92,36 – 98,15	2591/2591	100,00	99,85 – 100,00
Парагрипен вирус 1 (PIV 1)	62/62	100,00	94,17 – 100,00	2713/2713	100,00	99,86 – 100,00
Парагрипен вирус 2 (PIV 2)	8/8	100,00	67,56 – 100,00	2768/2768	100,00	99,86 – 100,00
Парагрипен вирус 3 (PIV 3)	122/123	99,19	95,54 – 99,86	2648/2649	99,96	99,79 – 99,99
Парагрипен вирус 4 (PIV 4)	38/40	95,00	83,50 – 98,62	2732/2733	99,96	99,79 – 99,99
Респираторно синцитиален вирус A+B	319/325	98,15	96,03 – 99,15	2442/2443	99,96	99,77 – 99,99
Риновирус/ентеровирус	385/409	94,13	91,42 – 96,03	2317/2339	99,06	98,58 – 99,38
SARS-CoV-2	83/88	94,32	87,38 – 97,55	171/189	90,48	85,45 – 93,89

Продължава на следващата страница

Таблица 4 (продължава от предишната страница)

	TP/(TP+FN)	Чувствителност/ PPA (%)	95% CI	TN/(TN+FP)	Специфичност/ NPA (%)	95% CI
Бактерии						
Bordetella pertussis	43/43	100	91,80 – 100,00	2716/2726	99,63	99,33 – 99,80
Mycoplasma pneumoniae	66/66	100	94,50 – 100,00	2703/2705	99,93	99,73 – 99,98
Chlamydophila pneumoniae	68/72	94,44	86,57 – 97,82	2701/2701	100,00	99,86 – 100,00

Няма годни за оценка резултати, налични за *Legionella pneumophila* и човешки бокавирус, поради ниската откриваемост (съответно 2 и 3 пъти) и отсъствието на резултати от компараторен метод. Поради тази причина са използвани изкуствени преби като заместителни клинични преби, за допълване и тестване на чувствителността на бокавирус и *Legionella pneumophila*. Остатьчни отрицателни клинични преби са допълнени с патогени при 2 x, 5 x и 10 x LoD нива (50 от всяко).

Приготвят се изкуствени положителни преби и се рандомизират заедно с 50 недопълнени отрицателни преби, така че състоянието на анализа на всяка допълнена преба да не е известно за потребителите, извършващи тестването в 1 клиничен център. Резултатите от тестването на изкуствени преби са дадени в Таблица 5.

Таблица 5. QIAstat-Dx SARS-CoV-2 Respiratory Panel при изкуствени преби

Патоген	Концентрация на аликовотната част	Честота на откриване	Дял (%)	95% CI
Бокавирус	2 x LoD	25/25	100,00	86,28 – 100
	5 x LoD	15/15	100,00	78,20 – 100
	10 x LoD	10/10	100,00	69,15 – 100
	Общо	50/50	100,00	92,89 – 100
<i>Legionella pneumophila</i>	2 x LoD	25/25	100,00	86,28 – 100
	5 x LoD	15/15	100,00	78,20 – 100
	10 x LoD	10/10	100,00	69,15 – 100
	Общо	50/50	100,00	92,89 – 100

В 370 аликовотни части анализът QIAstat-Dx Respiratory SARS CoV-2 Panel открива множество организми. Общо 316 аликовотни части са с двойни инфекции, 46 са с тройни инфекции, а оставащите аликовотни части имат 4 коинфекции (8 аликовотни части).

Проба със сух тампон

Общо 333 сдвоени клинични преби (NPS в UTM и NPS сух тампон) са тествани за оценка на клиничните работни характеристики на проби със сух тампон в сравнение с UTM пробата. Тестването е проведено в 4 клинични центъра в ЕС. Целта е да се демонстрира еквивалентност между работните характеристики при пробите със сух тампон и UTM, използвавщи QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Пациентите, участващи в проучванията, предоставят 2 назофарингеални тампона (по един от всяка ноздра). Един тампон се поставя директно в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, а другият се прехвърля в UTM за компараторно тестване с отделен QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (сдвоени аликовотни части).

Клиничната чувствителност (или PPA) е изчислена като $100\% \times [TP/(TP + FN)]$. Верен положителен (True Positive, TP) означава, че пробите от сух тампон и от UTM имат положителен резултат за конкретен организъм, а грешен отрицателен (False Negative, FN) означава, че резултатът от сух тампон е отрицателен, а този от преба в UTM е положителен за конкретен организъм. Специфичността (или NPA) е изчислена като $100\% \times [TN/(TN + FP)]$. Верен отрицателен (True Negative, TN) означава, че пробите от сух тампон и от UTM имат отрицателен резултат за конкретен организъм, а грешен положителен (False Positive, FP) означава, че резултатът от сух тампон е положителен, а този от преба в UTM е отрицателен за конкретен организъм. За всяка точкова оценка е изчислен точен биномен двустраниен 95% доверителен интервал.

За анализа от изходните 333 сдвоени преби са налични общо 319 оценими резултати за сдвоени аликовотни части. Останалите 14 сдвоени преби не отговарят на критериите за включване.

Общата клинична чувствителност (или PPA) бе изчислена от общо 189 положителни прицелни резултати, получени с пробата в UTM. Общата клинична специфичност (или NPA) бе изчислена от 6969 отделни отрицателни прицелни резултати, получени с пробата в UTM. Положителните резултати включват различни цели в панела и са представителни за епидемиологията на тестваната популация по време на проучването на клиничните работни характеристики (включително SARS-CoV-2 за 2 от центровете).

Открити са общо 179 верни положителни и 6941 верни отрицателни резултата от сух тампон, както и 10 грешни отрицателни (положителни за проба в UTM/отрицателни за проба със сух тампон) и 28 грешни-положителни (положителни за проба със сух тампон/отрицателни за проба в UTM) резултата. Като цяло PPA е 94,71% (95% CI, 90,54% – 97,10%), а NPA е 99,60% (95% CI, 99,42% – 99,72%), което показва висока обща корелация между сух тампон и типовете UTM преби (Таблица 6).

Таблица 6. Съвпадение между общия резултат със сух тампон в QIAstat-Dx Respiratory Panel и оценка на общата чувствителност и специфичност на общия резултат в UTM в QIAstat-Dx Respiratory Panel.

Групови променливи	Дял		Двустранни 95% доверителни граници	
	Фракция	Процент	Долна	Горна
NPA	6941/6969	99,60	99,42	99,72
PPA	179/189	94,71	90,54	97,10

Конкретно за прицелната на SARS-CoV-2 са открити 40 верни положителни резултата в сравнението между преби в UTM и преби със сух тампон, тествани с помощта на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. По време на сравнението между пребите не са открити грешни отрицателни резултати. Допълнително за SARS-CoV-2 са открити 181 верни отрицателни и 3 грешни положителни (положителни със сух тампон и отрицателни в UTM) резултати.

Разликите в резултатите между преба в UTM и преби със сух тампон биха могли да се дължат на разлики при вземането на различните преби и ефекта на разреждане на сухите тампони в транспортна среда. С QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel преби със сух тампон могат да бъдат тествани само веднъж, поради което за този тип преба не е възможно тестване на несъответствие.

Заключение

Мащабните многоцентрови проучвания имат за цел да оценят работните характеристики на пробите в UTM, както и еквивалентността на работните характеристики при преби със сух тампон спрямо UTM в анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Констатираната обща клинична чувствителност на пробата в UTM е 97,13% (95% доверителен интервал, 96,42% – 97,73%). Общата клинична специфичност 99,80% (95% CI, 99,76% – 99,84%).

Констатираната обща клинична чувствителност на пробата със сух тампон е 94,71% (95% доверителен интервал, 90,54% – 97,10%). Общата клинична специфичност за пробата със сух тампон е 99,60% (95% доверителен интервал, 99,42% – 99,72%).

Характеристики на анализа

Клиничните работни характеристики, показани по-долу, са демонстрирани с помощта на QIAstat-Dx Analyzer 1.0. QIAstat-Dx Analyzer 2.0 използва същия аналитичен модул като QIAstat-Dx Analyzer 1.0, поради което работните характеристики не се влияят от QIAstat-Dx Analyzer 2.0.

По отношение на QIAstat-Dx Rise бяха проведени специфични проучвания за демонстриране на пренасянето и повторяемостта. Останалите параметри на аналитичните характеристики, показани по-долу, бяха демонстрирани с помощта на QIAstat-Dx Analyzer 1.0. QIAstat-Dx Rise използва същия аналитичен модул като QIAstat-Dx Analyzer 1.0, поради което работните характеристики не се влияят от QIAstat-Dx Rise.

Чувствителност (граница на откриване)

Аналитичната чувствителност или границата на откриване (Limit of Detection, LoD) се определя като най-ниската концентрация, при която $\geq 95\%$ от тестваните аликовотни части генерират положителен сигнал.

Стойността LoD за всеки анализ е определена с избрани щамове* за отделните патогени, които могат да се откриват с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. В симулиран матрикс на аликовотни части с назофарингеален тампон (NPS) (култивирани човешки клетки в Copan UTM) за аликовотни части в течна транспортна среда и симулиран матрикс на аликовотни части със сух тампон (култивирани човешки клетки в изкуствен NPS) за сухи тампони, бяха внесени един (1) или повече патогени, и тествани в 20 повторения. Работният процес на течна аликовотна част използва NPS, елуиран в UTM, и прехвърляне на 300 μL към касетата, докато работният процес със сух тампон позволява прехвърляне на NPS директно към касетата. Фабрикувани тампони със сух тампон бяха пригответи чрез пипетиране на 50 μl от всеки разреден вирусен запас върху тампон, и бяха оставени да изсъхнат в продължение на поне 20 минути. Тампонът беше тестван според протокола за Аликовотна част със сух тампон (стр. 20).

* Поради ограничения достъп до култивиран вирус, за определяне на LoD, добавен в клинична отрицателна матрица за прицелната на SARS-CoV-2, и за определяне на LoD в сух тампон за целта бокавирус е използван синтетичен материал (gBlock).

Отделните стойности на LoD за всяка цел са дадени в Таблица 7.

Таблица 7. LoD стойности, получени за различните респираторни целеви щамове в матрикс на аликовотни части с назофарингеален тампон (NPS) (култивирани човешки клетки в Copan UTM) и/или сух тампон (култивирани човешки клетки в изкуствен NPS), тествани с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel

Патоген	Щам	Източник	Концентрация	Честота на откриване
Грип A H1N1	A/New Jersey/8/76	ATCC® VR-897	28,1 CEID ₅₀ /ml	20/20
	A/Brisbane/59/07	ZeptoMetrix® 0810244CFHI	0,04 TCID ₅₀ /ml	19/20
	A/New Caledonia/20/99	ZeptoMetrix 0810036CFHI	28,7 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Грип A H3N2	A/Virginia/ATCC6/2012	ATCC VR-1811	0,4 PFU/ml	19/20
	A/Wisconsin/67/2005	ZeptoMetrix 0810252CFHI	2,5 TCID ₅₀ /ml	20/20
	A/Port Chalmers/1/73	ATCC VR-810	3000 CEID ₅₀ /ml*	20/20
Грип A, подтип H1N1/2009	A/Virginia/ATCC1/2009	ATCC VR-1736	127 PFU/ml*	20/20
	A/SwineNY/03/2009	ZeptoMetrix 0810249CFHI	14,1 TCID ₅₀ /ml	20/20

* Тествани с течна аликовотна част и проба от сух тампон.

Продължава на следващата страница

Таблица 7 (продължава от предишната страница)

Патоген	Щам	Източник	Концентрация	Честота на откриване
Грип B	B/Virginia/ATCC5/2012	ATCC VR-1807	0,08 PFU/ml	20/20
	B/FL/04/06	ATCC VR-1804	2050 CEID ₅₀ /ml*	19/20
	B/Taiwan/2/62	ATCC VR-295	28,1 CEID ₅₀ /ml	20/20
Коронавирус 229E	–	ATCC VR-740	9,47 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Коронавирус OC43	–	ATCC-1558	0,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	–	ZeptoMetrix 0810224CFHI	1,99 TCID ₅₀ /ml	19/20
Коронавирус NL63	–	ZeptoMetrix 0810228CFHI	0,70 TCID ₅₀ /ml*	20/20
	–	ZeptoMetrix NATRVP-IDI	1/300†	19/20
	–	Клинично, S510	240 000 копия/ml	19/20
SARS-CoV-2	–	IDT (gBlock)	500 копия/ml	19/20
	England/02/2020	NIBSC 20/146	19 000 копия/ml	20/20
Парагрипен вирус 1 (PIV 1)	C35	ATCC VR-94	23,4 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Парагрипен вирус 2 (PIV 2)	Greer	ATCC VR-92	13,9 TCID ₅₀ /ml*	19/20
Парагрипен вирус 3 (PIV 3)	C 243	ATCC VR-93	44,1 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Парагрипен вирус 4 (PIV 4)	M-25	ATCC VR-1378	3,03 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Респираторен синцитиален вирус A	A2	ATCC VR-1540	2,8 TCID ₅₀ /ml‡	20/20
	A2	ATCC VR-1540	720 PFU/ml*	20/20
Респираторен синцитиален	9320	ATCC VR-955	0,02 TCID ₅₀ /ml	20/20
Човешки метапневмовирус	Peru6-2003 (тип B2)	ZeptoMetrix 0810159CFHI	1,1 TCID ₅₀ /ml	19/20
	hMPV-16, IA10-2003	ZeptoMetrix 0810161CFHI	3,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
Аденовирус	GB (аденовирус B3)	ATCC VR-3	94 900 TCID ₅₀ /ml	20/20
	RI-67 (аденовирус E4)	ATCC VR-1572	15,8 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Adenoid 75 (аденовирус C5)	ATCC VR-5	5,0 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Adenoid 71 (аденовирус C1)	ATCC VR-1	5,0 TCID ₅₀ /ml	19/20
	Аденовирус C2	ATCC VR-846	28,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Аденовирус C6	ATCC VR-6	505,6 TCID ₅₀ /ml	20/20

* Тествани с течна аликвотна част и проба от сух тампон.

† Относително разреждане от начална концентрация

‡ Две различни партиди от един и същи използван щам.

Продължава на следващата страница

Таблица 7 (продължава от предишната страница)

Патоген	Щам	Източник	Концентрация	Честота на откриване
Ентеровирус	/US/IL/14-18952 (ентеровирус D68)	ATCC VR-1824	534,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
	Ентеровирус 6 (D-1 (Cox))	ATCC VR-241	0,001 TCID ₅₀ /ml	19/20
Риновирус	1059 (риновирус B14)	ATCC VR-284	28,1 TCID ₅₀ /ml	20/20
	HGP (риновирус A2)	ATCC VR-482	169,0 TCID ₅₀ /ml*	20/20
	11757 (риновирус A16)	ATCC VR-283	8,9 TCID ₅₀ /ml	20/20
	Тип 1A	ATCC VR-1559	5,0 TCID ₅₀ /ml	20/20
Chlamydophila pneumoniae	TW183	ATCC VR-2282	0,5 TCID ₅₀ /ml†	19/20
Chlamydophila pneumoniae	TW183	ATCC VR-2282	85,3 IFU/ml‡	20/20
Mycoplasma pneumoniae	M129-B7	ATCC 29342	0,1 CFU/ml	20/20
Mycoplasma pneumoniae	PI 1428	ATCC 29085	6,01 CCU/ml	20/20
Legionella pneumophila	CA1	ATCC 700711	5370 копия/ml	19/20
Bordetella pertussis	I028	ATCC BAA-2707	5,13 CFU/ml*	19/20
	A639	ZeptoMetrix NATRVP-ID1	1/10 000†	19/20

* Тествани с течна аликвотна част и проба от сух тампон.

† Относително разреждане от начална концентрация

‡ Две различни партиди от един и същи използван щам.

Устойчивост на анализа

Утвърждаването на устойчивите работни характеристики на анализа е оценено чрез анализиране на работните характеристики на вътрешна контрола в клинични аликвотни части с назофарингеален тампон. Тридесет (30) отделни аликвотни части с назофарингеален тампон, отрицателни за всички възможни за откриване патогени, са анализирани с QIAstat-Dx Respiratory Panel. Всички тествани аликвотни части показват положителен резултат и валидни работни характеристики за вътрешната контрола на QIAstat-Dx Respiratory Panel.

Ексклузивност (аналитична специфичност)

Проучването за ексклузивност е проведено с компютърен анализ и инвирто тестване за оценка на аналитичната специфичност за респираторни или нереспираторни организми, които не са включени в панела. Тези организми включват преби, които са свързани, но се отличават от респираторните организми в панела или които може да присъстват в преби, взети от целевата популация за тестване. Избраните организми са клинично значими (разпространяват се в горните дихателни пътища или причиняват респираторни симптоми), често се срещат в кожната флора или лабораторните замърсители или са микроорганизми, с които може да е заразена голяма част от популацията.

Аликовтните части бяха пригответи чрез добавяне на потенциални кръстосано реактивни организми в симулирана матрица за аликовтни части с назофарингеален тампон при най-високата възможна концентрация за организмите – за предпочитане при 10^5 TCID₅₀/ml за целеви вирусни организми и 10^6 CFU/ml за целеви бактериални организми.

Чрез предварителен секвенционен анализ се прогнозира определено ниво на кръстосана реактивност с видове *Bordetella*, която се наблюдава при тестване на високи концентрации на *Bordetella holmesii* и на някои щамове на *Bordetella bronchiseptica*. В съответствие с насоките на CDC за анализи, използвавщи IS481 като прицелен регион, при използване на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, ако стойността CT за *Bordetella pertussis* е CT >29, се препоръчва извършване на потвърждаващ тест за специфичност. Не се наблюдава кръстосана реактивност с *Bordetella parapertussis* при високи концентрации. Целевият ген, използван за откриване на *Bordetella pertussis* (инсерционен елемент IS481), е транспозон, който присъства и в други видове *Bordetella*. В Таблица 8 е даден списъкът на тестваните патогени.

Таблица 8. Списък на патогените, тествани за аналитична специфичност

Тип	Патоген	
Бактерии	<i>Bordetella bronchiseptica</i>	<i>Neisseria elongata</i>
	<i>Bordetella holmesii</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
	<i>Bordetella parapertussis</i>	<i>Neisseria meningitidis</i>
	<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	<i>Enterobacter aerogenes</i>	<i>Serratia marcescens</i>
	<i>Escherichia coli</i> (0157)	<i>Staphylococcus aureus</i>
	<i>Haemophilus influenzae</i>	<i>Staphylococcus epidermidis</i>
	<i>Klebsiella oxytoca</i>	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Streptococcus agalactiae</i>
	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
	<i>Moraxella catarrhalis</i>	<i>Streptococcus pyogenes</i>
	<i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Streptococcus salivarus</i>
	<i>Mycoplasma hominis</i>	
Вируси	Цитомегаловирус	Херпес симплекс вирус 2
	Вирус на Епщайн-Бар	Вирус на морбили
	Херпес симплекс вирус 1	Заушка
Гъбички	<i>Aspergillus fumigatus</i>	
	<i>Candida albicans</i>	
	<i>Cryptococcus neoformans</i>	

Всички тествани патогени показват отрицателен резултат и не се наблюдава кръстосана реактивност за организмите, тествани в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (освен *Bordetella holmesii* и някои щамове на *Bordetella bronchiseptica*, както е описано по-горе).

Проведен е компютърен анализ за всички варианти праймер/сонда, включени в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, който доказва специфичната амплификация и откриване на целеви организми без кръстосана реактивност.

За целева на SARS-CoV-2 са тествани само ограничен брой организми инвирто (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pyogenes*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Mycobacterium tuberculosis*, коронавирус MERS, коронавирус SARS). Не е наблюдавана кръстосана реактивност както на компютърния анализ, така и на инвирто анализа, с каквото и да било клинично значими патогени (разпространяващи се в горните дихателни пътища или причиняващи респираторни симптоми), или обща кожна флора или лабораторни замърсители, или микроорганизми.

Инклузивност (аналитична реактивност)*

Проведено е проучване на инклузивността с цел анализиране на откриването на редица щамове, представляващи генетичното разнообразие на всеки респираторен целеви организъм в панела („щамове за оценка на инклузивността“). В проучването са включени щамове за оценка на инклузивността за всички аналити, характерни за видовете/типовете на различните организми (например редица щамове на грип А, изолирани от различни географски области и в различни календарни години). В Таблица 9 е даден списъкът на респираторните патогени, тествани в това проучване.

* Не е приложима за целевата на SARS-CoV-2 поради наличието само на един щам към момента на проучването.

Таблица 9. Списък на патогените, тествани за аналитична реактивност

Патоген	Подтип/серотип	Щам	Източник
Грип А	H1N1	A/PR/8/34	ATCC VR-1469
		A/New Jersey/8/76	ATCC VR-897
		A/Brisbane/59/07	ZeptoMetrix 0810244CFHI
		A/New Caledonia/20/99	ZeptoMetrix 0810036CFHI

(Продължава на следващата страница)

Таблица 9 (продължение)

Патоген	Подтип/серотип	Щам	Източник
Грип А	H3N2	A/Virginia/ATCC6/2012	ATCC VR-1811
		A/Wisconsin/67/2005	ZeptoMetrix 0810252CFHI
		A/Port Chalmers/1/73	ATCC VR-810
		A/Victoria/3/75	ATCC VR-822
		A/Brisbane/10/07	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
	H1N1 (пандемичен)	A/Virginia/ATCC2/2009	ATCC VR-1737
		A/Virginia/ATCC3/2009	ATCC VR-1738
		A/Virginia/ATCC1/2009	ATCC VR-1736
		A/SwineNY/03/2009	ZeptoMetrix 0810249CFHI
		H1N1/NY/02/09	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
Грип В	Няма	B/Virginia/ATCC5/2012	ATCC VR-1807
		B/FL/04/06	ATCC VR-1804
		B/Taiwan/2/62	ATCC VR-295
		B/Panama/45/90	ZeptoMetrix NATFLUB-ERCM
		B/Florida/02/06	ZeptoMetrix 810037CFHI
		B/Maryland/1/59	ATCC VR-296
	Няма	Няма	ATCC VR-740
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
		Няма	ATCC-1558
		Няма	ZeptoMetrix 0810024CFHI
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
Коронавирус NL63	Няма	Няма	ZeptoMetrix 0810228CFHI
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
	Няма	Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
		C35	ATCC VR-94
Парагрипен вирус 1	Няма	Неприложимо	ZeptoMetrix NATPARA1-ST
		Неприложимо	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
	Няма	Greer	ATCC VR-92
Парагрипен вирус 2	Няма	Няма	ZeptoMetrix 0810015CFHI
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI

(Продължава на следващата страница)

Таблица 9 (продължение)

Патоген	Подтип/серотип	Щам	Източник
Парагрипен вирус 3	Няма	C 243	ATCC VR-93
		Няма	ZeptoMetrix NATPARA3-ST
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
Парагрипен вирус 4	A	M-25	ATCC VR-1378
	B	CH 19503	ATCC VR-1377
	B	Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
RSV A	Няма	A2	ATCC VR-1540
		Long	ATCC VR-26
		Няма	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
RSV B	Няма	9320	ATCC VR-955
		18537	ATCC VR-1580
		WV/14617/85	ATCC VR-1400
		Няма	ZeptoMetrix NATRSVB-ST
		B1	ZeptoMetrix 0810156CFHI
Човешки метапневмовирус	B1	IA18-2003	ZeptoMetrix 0810162CFH
	B1	Peru3-2003	ZeptoMetrix 0810158CFHI
	B2	Peru6-2003	ZeptoMetrix 0810159CFHI
	B2	Peru1-2002	ZeptoMetrix 0810157CFHI
	A1	hMPV-16, IA10-2003	ZeptoMetrix 0810161CFHI
	A1	IA3-2002	ZeptoMetrix 0810160CFHI
	A2	IA14-2003	ZeptoMetrix 0810163CFH
Човешки метапневмовирус	B1	Peru2-2002	ZeptoMetrix 0810156CFHI
	B1	IA18-2003	ZeptoMetrix 0810162CFH
	B1	Peru3-2003	ZeptoMetrix 0810158CFHI
	B2	Peru6-2003	ZeptoMetrix 0810159CFHI
	B2	Peru1-2002	ZeptoMetrix 0810157CFHI
	A1	hMPV-16, IA10-2003	ZeptoMetrix 0810161CFHI
	A1	IA3-2002	ZeptoMetrix 0810160CFHI
	A2	IA14-2003	ZeptoMetrix 0810163CFH

(Продължава на следващата страница)

Таблица 9 (продължение)

Патоген	Подтип/серотип	Щам	Източник
Аденовирус В	B21	AV-1645 [128]	ATCC VR-256
	B7	Gomen	ATCC VR-7
	B3	GB	ATCC VR-3
	B3	Няма	ZeptoMetrix NATADV3-ST
Аденовирус С	C1	Adenoid 71	ATCC VR-1
	C2	Няма	ATCC VR-846
	C5	Adenoid 75	ATCC VR-5
	C6	Няма	ATCC VR-6
Аденовирус Е	E4	RI-67	ATCC VR-1572
Бокавирус	Няма	Няма	ZeptoMetrix 0601178NTS
		Няма	ZeptoMetrix MB-004 (партида 317954)
Ентеровирус А	EV-A71	EV-A71	ZeptoMetrix 0810236CFHI
	E-11	Gregory	ATCC VR-41
	E-30	Bastianni	ATCC VR-1660
	CV-A9	Griggs	ATCC VR-1311
	CV-B1	Conn-5	ATCC VR-28
	CV-B2	Ohio-1	ATCC VR-29
	CV-B3	Nancy	ATCC VR-30
	E-17	CHHE-29	ATCC VR-47
	Няма	Ентеровирус 6 (D-1 (Cox))	ATCC VR-241
Ентеровирус С	CV-A21	Kuykendall [V-024-001-012]	ATCC VR-850
Ентеровирус D	D68	US/IL/14-18952	ATCC VR-1824
	EV-D68	US/MO/14-18947	ATCC VR-1823
Риновирус А	A1	Няма	ZeptoMetrix NATRVP-ID1
	1A	Няма	ATCC VR-1559
	A2	HGP	ATCC VR-482
	A16	11757	ATCC VR-283
	HRV-1B	B632	ATCC VR-1645
	HRV-A39	209	ATCC VR-340
Риновирус В	B14	1059	ATCC VR-284

(Продължава на следващата страница)

Таблица 9 (продължение)

Патоген	Подтип/серотип Щам		Източник
C. pneumoniae	Няма	CWL-029	ATCC VR-1310
M. pneumoniae	1	PI 1428	ATCC 29085
	Няма	M129	ZeptoMetrix NATMPN(M129)-ERCM
	Няма	M129-B7	ATCC 29342
	Няма	Щам FH на агент на Итън [NCTC 10119]	ATCC 15531
L. pneumophila	Няма	CA1	ATCC 700711
		Legionella pneumophila подвид <i>Pneumophila/169-MN-H</i>	ATCC 43703
		Няма	ZeptoMetrix MB-004 (партида 317955)
		подвид <i>Pneumophila/Philadelphia-1</i>	ATCC 33152
B. pertussis	Няма	I028	ATCC BAA-2707
		A639	ZeptoMetrix NATRVP-IDI
		18323 [NCTC 10739]	ATCC 9797

Всички тествани патогени показват положителни резултати в тестваната концентрация.

Коинфекции

Проведено е проучване за коинфекции за потвърждаване, че от QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel могат да се открият различни аналити в една аликовотна част с назофарингеален тампон.

В една проба се комбинират високи и ниски концентрации на различни организми. Организмите са избрани въз основа на тяхната релевантност, преваленс и конфигурацията на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge (разпределение на целевите организми в различните реакционни камери).

Аналитите се внасят в симулиран матрикс на аликовотни части с NPS (култивирани човешки клетки в UTM) с висока (50 пъти над концентрацията на LoD) и ниска (5 пъти над концентрацията на LoD) концентрация и се тестват в различни комбинации. В Таблица 10 е дадена комбинацията от коинфекции, тествана в това проучване.

Таблица 10. Списък на тестваните комбинации от коинфекции

Патогени	Щам	Концентрация
Грип A/H3N2	A/Virginia/ATCC6/2012	50 x LoD
Аденовирус C5	Adenoid 75	5 x LoD
Грип A/H3N2	A/Virginia/ATCC6/2012	5 x LoD
Аденовирус C5	Adenoid 75	50 x LoD
Парагрипен вирус 3	C243	50 x LoD
Грип A/H1N1/2009	NY/03/09	5 x LoD
Парагрипен вирус 3	C243	5 x LoD
Грип A/H1N1/2009	NY/03/09	50 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	50 x LoD
Грип В	B/FL/04/06	5 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	5 x LoD
Грип В	B/FL/04/06	50 x LoD
Аденовирус C5	Adenoid 75	50 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	5 x LoD
Аденовирус C5	Adenoid 75	5 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	50 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	50 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	5 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	5 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	50 x LoD
Респираторен синцитиален вирус В	9320	50 x LoD
Бокавирус	Няма	5 x LoD
Респираторен синцитиален вирус В	9320	5 x LoD
Бокавирус	Няма	50 x LoD
Коронавирус OC43	Няма	50 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	5 x LoD
Коронавирус OC43	Няма	5 x LoD
Риновирус B, тип HRV-B14	1059	50 x LoD
Човешки металневмовирус B2	Peru6-2003	50 x LoD
Парагрипен вирус 1	C-35	5 x LoD
Човешки металневмовирус B2	Peru6-2003	5 x LoD
Парагрипен вирус 1	C-35	50 x LoD
Коронавирус 229E	Няма	50 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	5 x LoD
Коронавирус 229E	Няма	5 x LoD
Респираторен синцитиален вирус А	A2	50 x LoD
Респираторен синцитиален вирус В	9320	50 x LoD
Коронавирус NL63	Няма	5 x LoD
Респираторен синцитиален вирус В	9320	5 x LoD
Коронавирус NL63	Няма	50 x LoD

Всички тествани коинфекции дават положителен резултат за двета патогена, комбинирани във високи и ниски концентрации. Не се наблюдава влияние върху резултатите вследствие на наличието на коинфекции.

Интерфериращи вещества

В това проучване е оценено влиянието на потенциално интерфериращи вещества върху работните характеристики на QIAstat-Dx Respiratory Panel. Интерфериращите вещества включват ендогенни и екзогенни вещества, които естествено се срещат в назофаринкса или е възможно да бъдат внесени в пробите с NPS при взимането им.

За тестването на интерфериращи вещества се използват избрани аликвотни части, обхващащи всички респираторни патогени от панела. Интерфериращите вещества се внасят в избраните аликвотни части в ниво, прогнозирано да бъде над концентрацията на веществото, което е вероятно да бъде открито в действителни преби с назофарингеален тампон. Избраните аликвотни части се тестват с и без добавяне на потенциално инхибиращото вещество за директно сравнение между аликвотните части. Освен това се внасят потенциално инхибиращи вещества в аликвотни части без патогени.

Нито едно от тестваните вещества не показва интерференция с вътрешната контрола или с патогените, включени в комбинираната аликвотна част. В таблица 11, 12 и 13 са дадени концентрациите на интерфериращите вещества, тествани за QIAstat-Dx Respiratory Panel.

Таблица 11. Тествани ендогенни вещества

Вещество	Концентрация
Човешка геномна ДНК	50 ng/ μ l
Човешка цяла кръв	10% v/v
Човешки муцин	0,5% v/v

Таблица 12. Тествани конкурентни микроорганизми
Микроорганизъм (источник)

Микроорганизъм (источник)	Концентрация
<i>Staphylococcus aureus</i> (ATCC CRM-6538)	1,70E+08 CFU/ml
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (ATCC 6303)	1,25E+07 CFU/ml
<i>Haemophilus influenzae</i> (ATCC 49766)	6,20E+08 CFU/ml
<i>Candida albicans</i> (ATCC CRM-10231)	1,00E+06 CFU/ml
Херпес симплекс вирус 1 (ATCC VR-1789)	1,60E+07 TCID ₅₀ /mL
Човешки цитомегаловирус (ATCC NATCMV-0005)	2,0E+04 TCID ₅₀ /mL

Таблица 13. Тествани екзогенни вещества

Вещество	Концентрация
Спрей за нос Utabon® (деконгестант)	10% v/v
Спрей за нос Rhinomer® (разтвори на солена вода)	10% v/v
Тобрамицин	6 mg/ml
Мупироцин	2,5% w/v

Пренасяне

Проведено е проучване за пренасяне с цел оценяване на потенциалното възникване на кръстосано замърсяване между последователни изпълнения при използване на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и QIAstat-Dx Rise.

Симулиран матрикс на назофарингеални аликовотни части (NPS) с редуване на високи положителни и отрицателни аликовотни части е тестван на един QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и два апарата QIAstat-Dx Rise.

Не е наблюдавано пренасяне между пробите в QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Възпроизвеждане

За доказване на възпроизвеждането на характеристиките на QIAstat-Dx Respiratory Panel на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, в течна транспортна среда и в сух тампон е тестван набор от избрани аликовотни части с анализи с ниска концентрация (3 x LoD и 1 x LoD) и отрицателни аликовотни части.

Аликовтните части в течна транспортна среда са тествани на повторения с различни партиди касети QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge и тестовете са изпълнени на различни апарати QIAstat-Dx Analyzer 1.0 от различни оператори в различни дни.

Възпроизвеждостта и повторяемостта ще окажат влияние върху целевата на SARS-CoV-2 по същия начин, както други целеви организми, проверявани в QIAstat-Dx Respiratory Panel.

Таблица 14. Списък на респираторните патогени, тествани за възпроизвеждост на характеристиките в аликовтни части в течна транспортна среда

Патоген	Щам
Грип A H1	A/New Jersey/8/76
Грип A H3	A/Virginia/ATCC6/2012
Грип A H1N1 pdm	A/SwineNY/03/2009
Грип B	B/FL/04/06
Коронавирус 229E	Няма
Коронавирус OC43	Няма
Коронавирус NL63	Няма
Коронавирус HKU1	Няма
Парагрипен вирус 1	C35
Парагрипен вирус 2	Greer
Парагрипен вирус 3	C 243
Парагрипен вирус 4а	M-25
Риновирус	A16
Ентеровирус	/US/IL/14-18952 (ентеровирус D68)
Аденовирус	RI-67 (аденовирус E4)
RSV B	9320
hMPV	Peru6-2003 (тип B2)
Бокавирус	Клинична аликовтна част
Mycoplasma pneumoniae	M129-B7 (тип 1)
Chlamydophila pneumoniae	TW183
Legionella pneumophila	CA1
Bordetella pertussis	I028

Таблица 15. Обобщение на съвпадението на положителните и отрицателните резултати при тестването за възпроизводимост в аликвотни части в течна транспортна среда

Концентрация	Патоген	Очакван резултат	Честота на откриване	% съвпадение с очаквания резултат
3 x LoD	Грип А H1 *	Положителен	20/20	100
	Коронавирус HKU1	Положителен	20/20	100
	PIV-2	Положителен	20/20	100
	C. pneumoniae	Положителен	20/20	100
1 x LoD	RSVB	Положителен	20/20	100
	Грип А H1 *	Положителен	20/20	100
	Коронавирус HKU1	Положителен	19/20	95
	PIV-2	Положителен	19/20	95
Отрицателен	C. pneumoniae	Положителен	20/20	100
	RSVB	Положителен	20/20	100
	Грип А H1 *	Отрицателен	80/80	100
	Коронавирус HKU1	Отрицателен	80/80	100
3 x LoD	PIV-2	Отрицателен	80/80	100
	C. pneumoniae	Отрицателен	80/80	100
	RSVB	Отрицателен	80/80	100
	Бокавирус	Положителен	20/20	100
1 x LoD	Бокавирус	Положителен	20/20	100
Отрицателен	Бокавирус	Отрицателен	80/80	100
3 x LoD	Грип В	Положителен	20/20	100
	Коронавирус 229E	Положителен	20/20	100
	PIV-4a	Положителен	20/20	100
	Ентеровирус D68	Положителен	20/20	100
	hMPV B2	Положителен	20/20	100
	B. pertussis	Положителен	20/20	100
1 x LoD	Грип В	Положителен	19/20	95
	Коронавирус 229E	Положителен	20/20	100
	PIV-4a	Положителен	20/20	100
	Ентеровирус D68	Положителен	19/20	95
	hMPV B2	Положителен	19/20	95
	B. pertussis	Положителен	20/20	100
Отрицателен	Грип В	Отрицателен	80/80	100
	Коронавирус 229E	Отрицателен	80/80	100
	PIV-4a	Отрицателен	80/80	100
	Ентеровирус D68	Отрицателен	80/80	100
	hMPV B2	Отрицателен	80/80	100
	B. pertussis	Отрицателен	80/80	100

* Честотата на откриване се отнася и за двата целеви организма – грип А и H1.

(Продължава на следващата страница)

Таблица 15 (продължение)

Концентрация	Патоген	Очакван результат	Честота на откриване	% съвпадение с очаквания резултат
3 x LoD	Грип H1N1 (пандемичен) [†]	Положителен	20/20	100
	Коронавирус OC43	Положителен	20/20	100
	PIV-3	Положителен	20/20	100
	Риновирус A16	Положителен	20/20	100
	M. pneumoniae	Положителен	20/20	100
	Грип H1N1 (пандемичен) [†]	Положителен	20/20	100
3 x LoD	Коронавирус OC43	Положителен	20/20	100
	PIV-3	Положителен	20/20	100
	Риновирус A16	Положителен	20/20	100
	M. pneumoniae	Положителен	20/20	100
	Грип H1N1 (пандемичен) [†]	Положителен	20/20	100
	Коронавирус OC43	Положителен	20/20	100
1 x LoD	PIV-3	Положителен	20/20	100
	Риновирус A16	Положителен	20/20	100
	M. pneumoniae	Положителен	20/20	100
	Грип H1N1 (пандемичен) [†]	Отрицателен	80/80	100
	Коронавирус OC43	Отрицателен	80/80	100
	PIV-3	Отрицателен	80/80	100
Отрицателен	Риновирус A16	Отрицателен	80/80	100
	M. pneumoniae	Отрицателен	80/80	100
	Грип А H3*	Положителен	20/20	100
	Коронавирус NL63	Положителен	20/20	100
	PIV-1	Положителен	20/20	100
	Аденовирус E4	Положителен	20/20	100
3 x LoD	L. pneumophila	Положителен	20/20	100
	Грип А H3*	Положителен	19/20	95
	Коронавирус NL63	Положителен	20/20	100
	PIV-1	Положителен	20/20	100
	Аденовирус E4	Положителен	20/20	100
	L. pneumophila	Положителен	20/20	100
1 x LoD	Грип А H3*	Отрицателен	80/80	100
	Коронавирус NL63	Отрицателен	80/80	100
	PIV-1	Отрицателен	80/80	100
	Аденовирус E4	Отрицателен	80/80	100
	L. pneumophila	Отрицателен	80/80	100
	Грип А H3*	Отрицателен	80/80	100
Отрицателен	Коронавирус NL63	Отрицателен	80/80	100
	PIV-1	Отрицателен	80/80	100
	Аденовирус E4	Отрицателен	80/80	100
	L. pneumophila	Отрицателен	80/80	100
	Грип А H3*	Отрицателен	80/80	100
	Коронавирус NL63	Отрицателен	80/80	100

*Честотата на откриване се отнася и за двата целеви организма – грип А и H1.

[†] Честотата на откриване се отнася и за двата целеви организма – грип А и H1/пандемичен.

[‡] Честотата на откриване се отнася и за двата целеви организма – грип А и H3.

Аликовотни части със сух тампон са тествани на повторения с различни партиди QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge и тестовете са изпълнени на различни апарати QIAstat-Dx Analyzer 1.0 от различни оператори, различни центрове и в различни дни.

Представителен панел от патогени бе избран да включва поне един РНК вирус, един ДНК вирус и една бактерия, обхващащи всички (8) реакционни камери на касетата QIAstat-Dx® Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge

Таблица 16. Списък на респираторните патогени, тествани за възпроизводимост на характеристиките в аликовотни части със сух тампон

Патоген	Щам
Грип В	B/FL/04/06
Коронавирус OC43	Няма
Парагрипен вирус 3	C 243
Риновирус	HGP (риновирус A2)
Аденовирус	GB (аденовирус B3)
Mycoplasma pneumoniae	P 1428
SARS-CoV-2	England/02/2020

Таблица 17. Обобщение на съвпадението на положителните и отрицателните резултати при тестването за възпроизводимост в аликовотни части със сух тампон

Концентрация	Патоген	Център	Очакван резултат	Честота на откриване	% съвпадение с очаквания резултат
Грип В	Грип В	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
	Всички	Положителен	90/90	100	
3 x LoD	Коронавирус OC43	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
	Всички	Положителен	90/90	100	
PIV-3	PIV-3	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
	Всички	Положителен	90/90	100	

(Продължава на следващата страница)

Таблица 17. Обобщение на съвпадението на положителните и отрицателните резултати при тестването за възпроизводимост в аликовни части със сух тампон

Концентрация	Патоген	Център	Очакван резултат	Честота на откриване	% съвпадение с очаквания резултат
Грип В	Коронавирус OC43	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
3 x LoD	PIV-3	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
Риновирус	Аденовирус	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
M. pneumoniae	SARS-CoV-2	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
		Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100

(Продължава на следващата страница)

Таблица 17 (продължение)

Концентрация	Патоген	Център	Очакван резултат	Честота на откриване	% съвпадение с очаквания резултат
1 x LoD	Грип В	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
		Центрър 1	Положителен	30/30	100
	Коронавирус OC43	Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
		Центрър 1	Положителен	28/30	93,3
	PIV-3	Центрър 2	Положителен	29/30	96,6
		Центрър 3	Положителен	29/30	96,6
		Всички	Положителен	86/90	95,6
1 x LoD	Риновирус	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
	Аденовирус	Центрър 1	Положителен	30/30	100
		Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
		Центрър 1	Положителен	30/30	100
M. pneumoniae	M. pneumoniae	Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	28/30	93,3
		Всички	Положителен	88/90	97,8
		Центрър 1	Положителен	30/30	100
	SARS-CoV-2	Центрър 2	Положителен	30/30	100
		Центрър 3	Положителен	30/30	100
		Всички	Положителен	90/90	100
Отрицателен	Всички	Центрър 1	Отрицателен	690/690	100
		Центрър 2	Отрицателен	690/690	100
		Центрър 3	Отрицателен	690/690	100
		Всички	Отрицателен	2070/2070	100

Всички тествани аликовотни части генерират очаквания резултат (95 – 100% съвпадение), което показва характеристиките за възпроизводимост на QIAstat-Dx Respiratory Panel.

Тестването за възпроизводимост демонстрира, че QIAstat-Dx Respiratory Panel в QIAstat-Dx Analyzer 1.0 осигурява резултати от тестовете с висока възпроизводимост, когато са изпълнени тестове на едни и същи аликовотни части в различни дни, в различни центрове и от различни оператори на различни апарати QIAstat-Dx Analyzer 1.0 и с различни партиди касети QIAstat-Dx Respiratory Panel Cartridge.

Проведено е проучване за повторяемостта на два апарати QIAstat-Dx Rise с помощта на представителен набор от аликовотни части, съставени от анализи с ниска концентрация ($3 \times \text{LoD}$ и $1 \times \text{LoD}$), внесени в матрикс на аликовотни части и отрицателни аликовотни части от изкуствен NPS. Патогените, включени в положителните аликовотни части са грип В, коронавирус OC43, PIV3, риновирус, аденоовирус, *M. pneumoniae* и SARS-CoV-2. Аликовотните части са тествани в репликати с използване на две партиди касети. Проучването включва тестване с осем анализатора QIAstat-Dx Analyzer за сравнение. Тествани са общо 183 репликати от $1 \times \text{LoD}$ положителни пробы, 189 репликати от $3 \times \text{LoD}$ положителни пробы и 155 репликати от отрицателни пробы. Общите резултати показват честота на откриване 91,1 – 100,0% и 100,0% съответно за $1 \times \text{LoD}$ и $3 \times \text{LoD}$ пробите. Отрицателни пробы показаха 100% отрицателни сигнали за всички анализи в панела. Демонстрирано е, че ефективността на QIAstat-Dx Rise е еквивалентна на QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

Стабилност на аликовотните части

Проучване за стабилност на аликовотните части е проведено за анализиране на условията на съхранение за клинични аликовотни части (симулиран матрикс на аликовотни части за аликовотни части в течна транспортна среда и за аликовотни части със сух тампон) за тестване с QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

В симулирана матрица на пробы от NPS (култивирани човешки клетки в Copan UTM) се внася вирусен или бактериален култивиран материал с ниска концентрация (напр. $3 \times \text{LoD}$). Аликовотните части се съхраняват при следните условия за тестване:

- от 15°C до 25°C за 4 часа
- от 2°C до 8°C за 3 дни
- от -15°C до -25°C за 30 дни
- от -70°C до -80°C за 30 дни

Всички патогени се откриват успешно при различните температури и продължителност на съхранение, което демонстрира, че аликовтните части са стабилни при посочените условия и продължителност на съхранение.

Конкретно за SARS-CoV-2 не е извършено проучване за стабилност на аликовтните части в симулиран матрикс на аликовтни части в транспортна среда. Тестване на стабилността на пробата обаче е проведено с коронавирус 229E, HKU1, OC43 и NL63, патогени от същото вирусно подсемейство, без влияние върху работните характеристики, причинена от съхранението на пробите преди анализа при условията, посочени по-горе.

В симулиращ матрикс от изкуствени NPS и HeLa клетки се внася вирусен или бактериален култивиран материал с ниска концентрация (напр. 1 x LoD и 3 x LoD) преди добавяне върху тампон (от типа аликовтна част със сух тампон). Препоръчително е аликовтни части със сух тампон да се тестван непосредствено след взимане. Въпреки това е проведено допълнително проучване на стабилността на аликовтните части, за да се позволи допълнително време за пренос на сух тампон от мястото на вземане до апаратата. Аликовтните части се съхраняват при следните условия за тестване:

- 15°C до 25°C за 45 минути
- от 2°C до 8°C за 7 часа

Всички патогени се откриват успешно при различните температури и продължителност на съхранение, което демонстрира, че аликовтните части са стабилни при посочените условия и продължителност на съхранение.

Приложения

Приложение A: Инсталлиране на файла с дефиницията на анализа

Файлът с дефиницията на анализа на QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel трябва да бъде инсталлиран на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0 преди тестването с касетите QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge.


Забележка: За QIAstat-Dx Rise, моля, свържете се с отдела за техническо обслужване или с Вашия търговски представител, за да качите нови файлове с дефиниции на анализа.

Забележка: Когато излезе нова версия на анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel, новият файл с дефиницията на анализа QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel трябва да бъде инсталлиран преди тестването.

Забележка: Файлове с дефиниции на анализи могат да се изтеглят от www.qiagen.com. Файлът с дефиницията на анализа (с разширение .asy) трябва да бъде записан на USB устройство, преди да се инсталира на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0. USB устройството трябва да бъде форматирано с файлова система FAT32.


За да импортирате нови анализи от USB устройството в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, изпълнете следните стъпки:

1. Поставете USB устройството, съдържащо файла с дефиницията на анализа, в един от USB портовете на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0.
2. Натиснете бутона **Options** (Опции) и след това изберете **Assay Management** (Управление на анализите). Екранът „Assay Management“ (Управление на анализите) се показва в областта за съдържание на дисплея (Фигура 89).

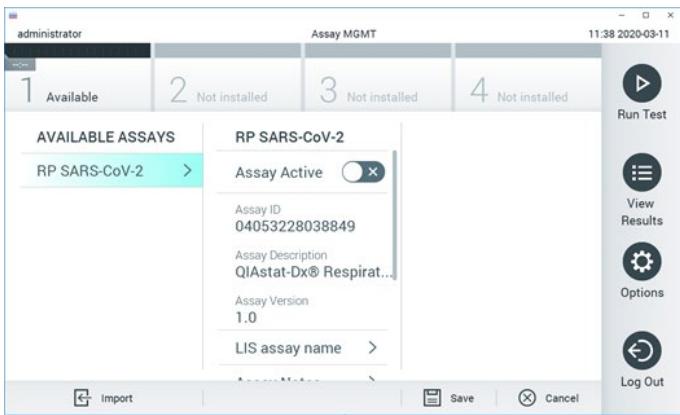


Фигура 89. Екран „Assay Management“ (Управление на анализите).

3. Натиснете иконата **Import** (Импортиране) долу вляво на екрана.
 4. Изберете файла, съответстващ на анализа за импортиране, от USB устройството.
 5. Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждаване на качването на файла.
 6. Може да се покаже диалогов прозорец за заменяне на текущата версия с нова.
- Натиснете **yes** (да) за замяна.
7. Анализът става активен при избиране на **Assay Active** (Активен анализ) (Фигура 90).

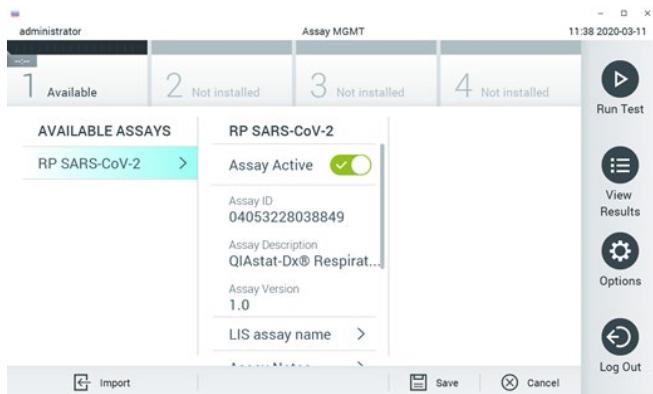

Фигура 90. Активиране на анализа.

8. Присвоете активния анализ към потребителя, като натиснете бутона **Options** (Опции), след което – бутона **User Management** (Управление на потребителите). Изберете потребителя, на когото трябва да бъде разрешено да изпълнява анализа. След това изберете **Assign Assays** (Задаване на анализи) от „User Options“ (Опции за потребител). Включете анализа и натиснете бутона **Save** (Запис) (Фигура 91 на следващата страница).

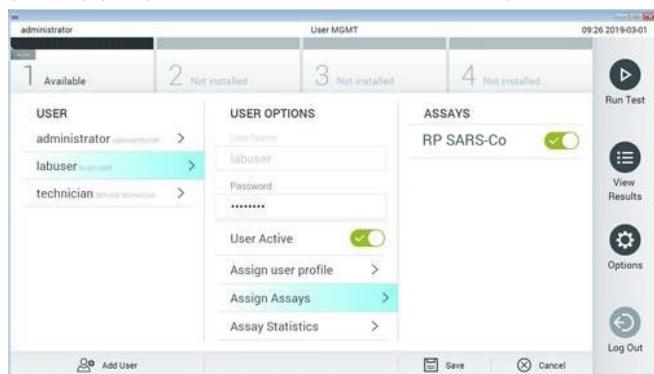

Фигура 91. Задаване на активния анализ.

Приложение В: Речник

Крива на амплификация: Графично представяне на данните за амплификацията от мултиплексната real-time RT-PCR.

Аналитичен модул (Analytical Module, AM): Основният хардуерен модул на QIAstat-Dx Analyzer 1.0 или QIAstat-Dx Analyzer 2.0, отговарящ за изпълнението на тестове с касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge. Управлява се от оперативния модул. Към един оперативен модул може да се свържат няколко аналитични модула.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 се състои от оперативен модул и аналитичен модул. Оперативният модул или оперативният модул PRO съдържат елементи, които осигуряват връзка с аналитичния модул, и позволяват на потребителя да работи с QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Аналитичният модул съдържа хардуера и софтуера за тестване и анализ на аликвотните части.

QIAstat-Dx Analyzer 2.0: QIAstat-Dx Analyzer 2.0 се състои от оперативен модул PRO и аналитичен модул. Оперативният модул PRO съдържа елементи, които осигуряват връзка с аналитичния модул, и позволяват на потребителя да работи с QIAstat-Dx Analyzer 2.0. Аналитичният модул съдържа хардуера и софтуера за тестване и анализ на аликвотните части.

QIAstat-Dx Rise: QIAstat-Dx Rise Base е изделие за инвитро диагностика за използване с анализите QIAstat-Dx и аналитичните модули QIAstat-Dx, което осигурява пълна автоматизация от подготовката на аликвотните части до откриването с real-time PCR за молекуларни приложения. Системата може да се използва както при произволен достъп, така и при тестване на партиди, а производителността ѝ може да бъде увеличена до 160 теста/ден чрез включване на до 8 аналитични модула. Системата освен това включва предно отделение за множество тестове, което може да поеме до 18 теста едновременно, както и отделение за отпадъци за автоматично изхвърляне на извършените тестове, което увеличава автономната ефективност на системата.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge: Самостоятелно пластмасово изделие за еднократна употреба с всички предварително заредени реактиви, необходими за цялостно изпълнение на напълно автоматизирани молекуларни анализи за откриване на респираторни патогени.

IFU: Инструкции за употреба.

Главен отвор: В QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, отвор за аликовотни части в течна транспортна среда.

Нуклеинови киселини: Биополимери или малки биомолекули, съставени от нуклеотиди, които представляват мономери, изградени от три компонента: 5-въглеродна захар, фосфатна група и азотна база.

Оперативен модул (Operational Module, OM): Специализираният хардуер на QIAstat-Dx Analyzer 1.0, осигуряващ потребителския интерфейс за 1 – 4 аналитични модула (Analytical Module, AM).

Оперативен модул PRO (Operational Module PRO, OM PRO): Специализираният хардуер на QIAstat-Dx Analyzer 2.0, осигуряващ потребителския интерфейс за 1 – 4 аналитични модула (Analytical Module, AM).

PCR: Полимеразна верижна реакция

RT: Обратна транскрипция

Отвор за тампон: В QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, отвор за сухи тампони.

Потребител: Лице, което работи с QIAstat-Dx Analyzer 1.0/QIAstat-Dx Analyzer 2.0/ QIAstat-Dx Rise и QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge по предназначение.

Приложение С: Освобождаване от гаранции

ОСВЕН ИЗЛОЖЕНАТА В РЕДА И УСЛОВИЯТА НА QIAGEN ЗА ПРОДАЖБА НА QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, QIAGEN НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ И СЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ВСЯКА ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА НА QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ПАТЕНТ, АВТОРСКО ИЛИ ДРУГО ПРАВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА.

Цитирани източници

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD). Division of Viral Diseases (DVD) web site.
2. World Health Organization. WHO Fact Sheet No. 221, November 2016. Influenza (seasonal). www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/index.html. Accessed November 2016.
3. Flu.gov web site. About Flu. www.cdc.gov/flu/about/index.html
4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Human Parainfluenza Viruses (HPIVs). www.cdc.gov/parainfluenza/index.html
5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV). www.cdc.gov/rsv/
6. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Adenoviruses. www.cdc.gov/adenovirus/index.html
7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Non-polio Enterovirus. www.cdc.gov/non-polio-enterovirus/about/index.html
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: *Mycoplasma pneumoniae* Infection. www.cdc.gov/pneumonia/atypical/mycoplasma/index.html
9. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Pertussis (Whooping Cough). www.cdc.gov/pertussis/
10. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline (M29)*.
11. BLAST: Basic Local Alignment Search Tool. <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
12. Schreckenberger, P.C. and McAdam, A.J. (2015) Point-counterpoint: large multiplex PCR panels should be first-line tests for detection of respiratory and intestinal pathogens. *J Clin Microbiol* **53**(10), 3110–3115.
13. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Diseases & Conditions: Coronavirus (COVID-19). www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

СИМВОЛИ

В таблицата по-долу са описани символите, използвани върху етикетите или в настоящия документ.



Съдържа достатъчно реактиви за <N> реакции



Използвайте до



Медицинско изделие за инвивто диагностика



Каталожен номер



Партиден номер



Номер на материал (т.е. етикет на компонента)



Приложение за горните дихателни пътища

Rn

„R“ означава редакция на ръководството, а „n“ – номерът на редакцията



Температурни ограничения



Производител



Направете справка с инструкциите за употреба



Внимание



Маркировка CE за европейско съответствие



Сериен номер



Да не се използва повторно



Пазете от слънчева светлина



Да не се използва, ако опаковката е повредена



Глобален номер на търговска единица

Информация за поръчка

Изделие	Съдържание	Каталожен №
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	За 6 теста: 6 поотделно опаковани касети QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Cartridge и 6 поотделно опаковани преносни пипети	691214
Свързани продукти		
QIAstat-Dx Analyzer 1.0	1 аналитичен модул QIAstat-Dx Analytical Module, 1 оперативен модул QIAstat-Dx Operational Module и съответният хардуер и софтуер за изпълнение на тестове с касети за анализ QIAstat-Dx за молекулярна диагностика	9002824
QIAstat-Dx Analyzer 2.0	1 аналитичен модул QIAstat-Dx Analytical Module, 1 оперативен модул QIAstat-Dx Operational Module PRO и съответният хардуер и софтуер за изпълнение на тестове с касети за анализ QIAstat-Dx за молекулярна диагностика	9002828
QIAstat-Dx Rise	1 апарат QIAstat-Dx Rise и съответните аксесоари и софтуер за провеждане на тестове с касети за анализ QIAstat-Dx за молекулярна диагностика	9003163

За актуална информация за лицензиране и декларации за освобождаване от отговорност за конкретни изделия вижте съответния наръчник или ръководство за потребителя на набора QIAGEN. Наръчниците и ръководствата за потребителя на комплекти QIAGEN са достъпни на адрес www.qiagen.com или могат да бъдат заявени от отдела за техническо обслужване на QIAGEN или местния Ви дистрибутор.

Хронология на редакциите на документа

Дата	Промени
Версия 2, Редакция 1	Пускане на SW версия 2.2
Версия 2, Редакция 2	Включване на QIAstat-Dx Analyzer 2.0

Ограничено лицензно споразумение за QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel

Употребата на това изделие означава, че всеки купувач или потребител на изделието приема следните условия:

1. Този продукт може да се използва единствено в съответствие с протоколите, предоставени с продукта и настоящото ръководство, както и само с компонентите, включени в набора. QIAGEN не пропоставя лиценза във връзка с никоя от интелектуалните си собствености за използване или включване на приложените компоненти в този набор с каквито и да са компоненти, които не са включени в него, с изключение на описаните в протоколите, предоставени с продукта, ръководството и допълнителните протоколи, които можете да намерите на www.qiagen.com. Някои от тези допълнителни протоколи са предоставени от потребители на QIAGEN за потребители на QIAGEN. Тези протоколи не са тествани щателно или оптимизирани от QIAGEN. QIAGEN не дава гаранция за тях и не гарантира, че те не нарушават правата на трети страни.
2. Освен изрично посочените лицензи, QIAGEN не дава гаранция, че този набор и/или неговата употреба не нарушават права на трети страни.
3. Този набор и неговите компоненти са лицензирани за еднократна употреба и не могат да се използват повторно, регенериран или препродават.
4. QIAGEN изрично се освобождава от отговорност за всякакви други лицензи – явни или подразбиращи се – освен изрично посочените.
5. Купувачът и потребителят на набора дават съгласие да не предприемат или позволяват на други лица да предприемат действия, които могат да доведат до или да улеснят някое от действията, забранени по-горе. QIAGEN може да прилага забраните в настоящото Ограничено лицензно споразумение във вски съд и ще възстанови всички свои разходи за разследване и съдебни разноски, включително адвокатските хонорари, при всяко действие за прилагане на настоящото Ограничено лицензно споразумение или упражняване на всяко от своите права върху интелектуална собственост във връзка с набора и/или неговите компоненти.

За актуалните условия на лиценза вижте www.qiagen.com.

Търговски марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx, DiagCORE® (QIAGEN Group); ACGIH® (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); ATCC® (American Type Culture Collection); BD™ (Becton Dickinson and Company); FilmArray® (BioFire Diagnostics, LLC); Copan®, FLOQSwabs®, UTM® (Copan Italia S.P.A.); Clinical and Laboratory Standards Institute® (Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.); HealthLink® (HealthLink Inc.); Rhinomer® (Novartis Consumer Health, S.A.); OSHA® (Occupational Safety and Health Administration (Администрация по безопасност и здраве при работа), UniTranz-RT® (Puritan Medical Products Company); Министерството на труда на САЩ); MicroTest™, M4®, M4RT®, M5®, M6™ (Thermo Fisher Scientific или дъщерните му дружества); Utabon® (Uralach Consumer Healthcare, S.L.); ZeptoMetrix® (ZeptoMetrix Corporation). Регистрираните имена, търговските марки и пр., използвани в настоящия документ, дори ако не са изрично обозначени като такива, не се считат за незаштитени от закона.

HB-2934-002 V2 R2 08/2024 © 2022 QIAGEN, всички права запазени.

Поръчки www.qiagen.com/shop | Техническа поддръжка support.qiagen.com | Уебсайт www.qiagen.com