

Istruzioni per l'uso di *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit



Versione 1

IVD

Per uso diagnostico in vitro

Per l'uso con strumenti Rotor-Gene[®] Q MDx 5plex HRM

CE

REF

870311



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, GERMANIA

R6 **MAT**

1127512IT

Indice

Uso previsto	5
Sommario e spiegazioni	6
Principio della procedura	7
Formato del kit	7
Esami	8
Controlli	9
Materiali in dotazione	10
Contenuto del kit	10
Materiali necessari ma non in dotazione	11
Avvertenze e precauzioni	12
Informazioni sulla sicurezza	12
Precauzioni generali	12
Conservazione e manipolazione dei reagenti	14
Conservazione e manipolazione dei campioni	16
Procedura	17
Protocollo: Rilevazione delle mutazioni EGFR	18
Protocollo: Configurazione del Rotor-Gene Q EGFR	23
Analisi dei dati relativi alla valutazione delle mutazioni	30
Guida alla risoluzione dei problemi	38
Controllo di qualità	40
Limitazioni	40
Caratteristiche delle prestazioni	42

Sensibilità analitica: limite del bianco (Limit of Blank, LOB)	42
Limite di sensibilità (Limit of Detection, LOD)	42
Sensibilità analitica – Δ Cut-off C_T e intervallo di cut-off ΔC_T	44
Ripetibilità e riproducibilità	44
Impatto del DNA iniziale sui valori C_T	45
Sostanze interferenti	45
Prestazioni cliniche	49
Bibliografia	50
Informazioni di contatto	51
Simboli	52
Appendice A: Dettagli delle mutazioni	54
Informazioni per gli ordini	55
Cronologia delle revisioni del documento	57

Uso previsto

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è un test diagnostico in vitro per la rilevazione delle delezioni nell'esone 19, delle sostituzioni degli esoni 20 e 21 (rispettivamente T790M e L858R) nel gene del recettore del fattore di crescita epidermico (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR) e fornisce una valutazione qualitativa dello stato mutazionale. I risultati possono aiutare il medico a identificare i pazienti con NSCLC che potrebbero trarre benefici dalla terapia con IRESSA® (gefitinib), quando non è possibile valutare un campione di tessuto.

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit deve essere utilizzato da professionisti qualificati in un ambiente di laboratorio professionale, con campioni di DNA estratti da plasma ottenuto da sangue di pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC).

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è destinato all'uso nella diagnostica in vitro.

Sommario e spiegazioni

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è un prodotto pronto per l'uso, destinato alla rilevazione delle mutazioni nell'oncogene EGFR tramite PCR (Polymerase Chain Reaction, reazione a catena della polimerasi) sugli strumenti Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM.

Grazie all'uso delle tecnologie Scorpions® e ARMS, il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è in grado di rilevare le mutazioni del gene EGFR elencate di seguito su un fondo di DNA genomico wild-type.

- Delezioni nell'esone 19
- T790M
- L858R

I metodi utilizzati nel kit sono altamente selettivi e, a seconda della quantità totale di DNA presente, consentono di rilevare una percentuale bassa di mutante in un fondo di DNA genomico wild-type. Questi limiti di selettività e sensibilità sono superiori, ad esempio, a quelli delle tecnologie di sequenziamento con terminatori fluorescenti.

Principio della procedura

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit utilizza due tecnologie, ARMS e Scorpions, per l'individuazione delle mutazioni tramite real-time PCR.

ARMS

La tecnologia del sistema di mutazioni refrattarie all'amplificazione (Amplification Refractory Mutation System, ARMS) consente l'amplificazione specifica di alleli o mutazioni. La Taq DNA polimerasi (Taq) è efficace per distinguere tra un appaiamento corretto e un appaiamento errato all'estremità in 3' di un primer per PCR. Viene eseguita un'amplificazione selettiva di specifiche sequenze mutate, anche nei campioni in cui prevalgono le sequenze non mutate. Quando il primer è perfettamente appaiato, l'amplificazione procede con la massima efficienza. Quando la base in 3' presenta un appaiamento errato, si osserva soltanto un'amplificazione di basso livello sul fondo.

Scorpions

La tecnologia Scorpions consente di rilevare il risultato dell'amplificazione. Il termine Scorpions è utilizzato per descrivere molecole a doppia funzione che contengono un primer per PCR legato covalentemente a una sonda. Il fluoroforo in questa sonda interagisce con un colorante quencher, anch'esso incorporato nella sonda, che riduce la fluorescenza. Quando la sonda si lega all'amplicone, durante la PCR, il fluoroforo e il colorante quencher si separano, determinando un aumento della fluorescenza nella provetta della reazione.

Formato del kit

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit include 4 esami:

- Un esame di controllo (Ctrl)
- 3 esami di mutazione

Tutte le miscele di reazione contengono reagenti sufficienti per rilevare i target marcati con FAM™, più un esame di un controllo interno marcato con HEX™. L'esame di controllo interno può rilevare la presenza di inibitori che potrebbero causare risultati falsi negativi. L'amplificazione FAM può entrare in competizione con l'amplificazione del controllo interno. La finalità del controllo interno è semplicemente dimostrare che, in assenza di amplificazione FAM, questo risultato è realmente negativo e non si tratta di una reazione PCR non riuscita.

Esami

Esame di controllo

L'esame di controllo, marcato con FAM, consente di valutare il contenuto totale di DNA in un campione. Questo esame amplifica una regione dell'esone 2 del gene EGFR. Il primer e la sonda sono formulati in modo tale da evitare qualsiasi polimorfismo noto del gene EGFR.

Esami di mutazione

Ogni esame di mutazione contiene una sonda Scorpion marcata con FAM e un primer ARMS per la discriminazione tra il DNA wild-type e un DNA con una mutazione specifica.

Controlli

I seguenti controlli devono essere inclusi in tutte le sedute analitiche:

Controllo positivo

Per ogni ciclo è necessario includere un controllo positivo nelle provette 1–4. Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit contiene il controllo positivo (Positive Control, PC) EGFR, da utilizzare come template nella reazione di controllo positivo. I risultati del controllo positivo verranno valutati per confermare se il kit funziona secondo i criteri di accettabilità dichiarati.

Controllo negativo

Per ogni seduta è necessario includere un controllo negativo senza template (No Template Control, NTC) nelle provette 9-12. Il controllo NTC è costituito dall'acqua priva di nucleasi (H₂O) da utilizzare come "stampo" per il controllo senza template. Il controllo senza template serve per valutare sia le potenziali contaminazioni durante la configurazione del processo sia le prestazioni della reazione di controllo interno.

Valutazione della reazione di controllo interno

Ogni miscela di reazione contiene un controllo interno, oltre alla reazione target. Un fallimento può indicare che sono presenti inibitori in grado di indurre risultati falsi negativi o che l'operatore ha commesso un errore di allestimento della provetta interessata.

Se l'errore del controllo interno è dovuto all'inibizione della PCR, diluendo il campione è possibile ridurre l'effetto degli inibitori, tenendo tuttavia presente che in questo modo viene diluito anche il DNA target. L'amplificazione FAM può entrare in competizione con l'amplificazione del controllo interno, cosicché il valore IC CT (HEX) generato potrebbe non rientrare nell'intervallo specificato. I risultati FAM restano comunque validi per questi campioni.

Materiali in dotazione

Contenuto del kit

<i>therascreen</i> EGFR Plasma RGQ PCR Kit			(24)
Numero di catalogo			870311
Numero di reazioni			24
Rosso	Control Reaction Mix (Miscela reazione di controllo)	Ctrl	2 x 600 µl
Viola	T790M Reaction Mix (Miscela reazione T790M)	T790M	600 µl
Arancione	Deletions Reaction Mix (Miscela reazione delezioni)	Del	600 µl
Rosa	L858R Reaction Mix (Miscela reazione L858R)	L858R	600 µl
Beige	EGFR Positive Control (Controllo positivo EGFR)	PC	300 µl
Verde menta	Taq DNA polimerasi	Taq	2 x 80 µl
Bianco	Nuclease-Free Water for No Template Control (Acqua priva di nucleasi per controllo senza templato)	NTC	1 x 1,9 ml
Bianco	Nuclease-Free Water for Dilution (Acqua priva di nucleasi per diluizione)	Dil	1 x 1,9 ml
Istruzioni per l'uso (Manuale) di <i>therascreen</i> EGFR Plasma RGQ PCR Kit			1

Materiali necessari ma non in dotazione

Durante la manipolazione di sostanze chimiche, è opportuno indossare sempre un camice da laboratorio, guanti monouso e occhiali protettivi. Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) disponibili presso il fornitore.

- Kit di estrazione del DNA (vedere "Procedura" a pagina 17)
- Pipette dedicate* (regolabili) per la preparazione dei campioni
- Pipette dedicate* (regolabili) per la preparazione della miscela master PCR
- Pipette dedicate* (regolabili) per la dispensazione del DNA stampo
- Puntali per pipette sterili prive di DNAsi, RNAsi e DNA dotate di filtri (per evitare contaminazioni crociate, è consigliabile utilizzare puntali per pipette dotati di barriere anti-aerosol)
- Bagno d'acqua o dispositivo simile, capace di mantenere a 60°C le provette per centrifuga da 50 ml.
- Blocco riscaldante o dispositivo simile, capace di mantenere l'incubazione a 56°C†
- Ghiaccio tritato
- Centrifuga da tavolo* con rotore per provette di reazione da 2 ml
- Vortex
- Strumento Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM* † con canali di fluorescenza per Cycling Green e Cycling Yellow (rilevazione di FAM ed HEX, rispettivamente)
- Software Rotor-Gene Q, versione 2.3.5 o successive
- Strip Tubes and Caps, 0.1 ml, da usare con 72-Well Rotor (n. cat. 981103 o 981106)
- Provette per microcentrifuga prive di DNAsi, RNAsi e DNA per la preparazione di miscele master
- Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes, blocco in alluminio per l'allestimento manuale delle reazioni con una pipetta a canale singolo (QIAGEN, n. cat. 9018901)

* Assicurarsi che gli strumenti siano stati controllati e calibrati nel rispetto delle istruzioni del produttore.

† In alcuni paesi è possibile utilizzare lo strumento Rotor-Gene Q 5plex HRM con data di produzione maggio 2011 o successiva. La data di produzione può essere ricavata dal numero di serie sul retro dello strumento. Il numero di serie è nel formato "mmaannn", dove "mm" indica il mese di produzione in cifre, "aa" indica le ultime due cifre dell'anno di produzione e "nnn" indica l'ID univoco dello strumento.

Avvertenze e precauzioni

Per uso diagnostico in vitro

Per uso professionale

Informazioni sulla sicurezza

Durante la manipolazione di sostanze chimiche, è opportuno indossare sempre un camice da laboratorio, guanti monouso e occhiali protettivi. Per ulteriori informazioni, consultare le relative schede tecniche di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS). Le schede sono disponibili online nel pratico formato PDF sul sito www.qiagen.com/safety, dove è possibile cercare, visualizzare e stampare la scheda SDS di ogni kit e di ogni componente del kit QIAGEN.

Precauzioni generali

L'utente deve prestare sempre attenzione alle seguenti precauzioni:

- Utilizzare puntali per pipette sterili privi di DNAsi, RNAsi e DNA e dotati di filtro; assicurarsi che le pipette siano state calibrate nel rispetto delle istruzioni fornite dal produttore.
- Conservare ed estrarre il materiale positivo (campioni e controlli positivi) separatamente da tutti gli altri reagenti e aggiungerli alla miscela di reazione in un'area del laboratorio separata.
- Prima dell'inizio dell'esame scongelare tutti i componenti a temperatura ambiente (15–25°C).
- Dopo aver scongelato i componenti, miscelarli capovolgendo ogni provetta per 10 volte e centrifugare brevemente.

Nota: agire con la massima cautela in modo da prevenire la contaminazione delle reazioni PCR con il materiale di controllo sintetico. Si raccomanda l'uso di pipette dedicate per la preparazione delle miscele delle reazioni e l'aggiunta del DNA template. La preparazione e l'aliquotazione delle miscele delle reazioni devono essere eseguite in un'area separata dall'area in cui avviene l'aggiunta del template. Non aprire le provette Rotor-Gene Q dopo che il ciclo PCR è terminato. In questo modo è possibile prevenire la contaminazione da laboratorio con i prodotti post-PCR.

Nota: i reagenti sono validati per l'allestimento manuale. Se si utilizza un metodo automatizzato, il numero di possibili reazioni potrebbe ridursi a causa dei reagenti necessari per riempire i "volumi morti" su tali strumenti.

Nota: tutti i reagenti del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono formulati in modo specifico per l'uso con i test indicati. Tutti i reagenti forniti nel *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono destinati esclusivamente all'uso con gli altri reagenti del medesimo *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit.

Se si desidera mantenere un livello di prestazioni ottimale, non sostituire nessuno dei reagenti del kit.

Nota: utilizzare soltanto la *Taq* DNA polimerasi (*Taq*) inclusa nel kit. Non sostituirla con *Taq* DNA polimerasi di altri kit dello stesso tipo o di qualsiasi altro tipo o con *Taq* DNA polimerasi di altri fornitori.

Nota: i reagenti del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono diluiti in percentuali ottimali. L'ulteriore diluizione dei reagenti è sconsigliata, in quanto potrebbe provocare una perdita di prestazioni. L'uso di volumi delle reazioni inferiori a 25 µl è sconsigliato, in quanto potrebbe determinare un aumento del rischio di falsi negativi.

Conservazione e manipolazione dei reagenti

Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit viene spedito in ghiaccio secco. Qualora uno dei componenti del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit non dovesse essere congelato alla consegna, o la confezione esterna dovesse essersi aperta durante il tragitto, o la scatola non dovesse contenere la nota di accompagnamento, le istruzioni per l'uso o i reagenti, contattare uno dei reparti del servizio tecnico QIAGEN o il distributore locale (visitare il sito www.qiagen.com).

Alla consegna riporre immediatamente il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit in un congelatore termoregolato e conservarlo tra -30°C e -15°C al riparo dalla luce. Se conservato alle condizioni specificate, il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è stabile fino alla data di scadenza indicata.

Dopo l'apertura, i reagenti possono essere conservati nella loro confezione originale a una temperatura compresa tra -30 e -15°C per 12 mesi o fino alla data di scadenza riportata sulla confezione (a seconda di quale delle due date viene prima). Evitare di scongelare e congelare ripetutamente. Non superare il numero massimo di otto cicli di congelamento-scongelamento.

I reagenti devono scongelarsi a temperatura ambiente per minimo 1 ora e massimo 4,5 ore. Quando i reagenti sono pronti per l'uso, è possibile preparare le reazioni PCR e le provette Rotor-Gene Q, che contengono le miscele master e il campione di DNA, devono essere caricate immediatamente sul Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM. Fare attenzione a non superare il tempo totale dall'inizio della preparazione della PCR all'avvio del processo:

- 6 ore se la conservazione avviene a temperatura ambiente
Nota: il tempo indicato include sia la preparazione della PCR che la conservazione.
- 18 ore se la conservazione avviene in frigorifero (2–8°C)
Nota: il tempo indicato include sia la preparazione della PCR che la conservazione.

Nota: come tutte le molecole marcate con fluorescenza, le molecole Scorpions sono sensibili alla luce. Per prevenire il fotodecadimento dei reagenti di controllo e delle miscele delle reazioni, proteggerli dalla luce.

I reagenti contenuti nel *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono diluiti in modo ottimale e non richiedono ulteriori trattamenti o purificazioni prima del loro impiego nelle analisi secondo le modalità descritte nelle *Istruzioni per l'uso (Manuale) del therascreen EGFR Plasma RGQ PCR Kit*.

Prestare attenzione alle date di scadenza e alle condizioni di conservazione stampate sulla confezione e sulle etichette di tutti i componenti. Non utilizzare componenti scaduti o conservati in modo scorretto.

Conservazione e manipolazione dei campioni

Nota: tutti i campioni devono essere trattati come materiale potenzialmente infettivo.

Il materiale campione deve essere DNA genomico umano estratto da plasma. Il trasporto deve avvenire secondo la metodologia di patologia standard per garantire la qualità dei campioni.

Procedura

Estrazione del DNA

Le caratteristiche delle prestazioni di questo kit sono state generate utilizzando DNA estratto con il QIAamp® Circulating Nucleic Acid Kit (n. cat. 55114). Se si utilizza il QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit, l'estrazione del DNA deve essere eseguita nel rispetto delle istruzioni contenute nel manuale, osservando quanto segue:

- Il volume iniziale di plasma deve essere 2 ml.
- Prima di procedere all'estrazione del DNA, centrifugare 2 ml di plasma a 3000 rpm per 2 minuti e trasferire il supernatante in una provetta pulita.
- Il volume di proteinasi K deve essere 250 µl.
- La digestione con proteinasi K deve durare 1 ora a 60°C.
- Il DNA genomico purificato deve essere eluito in 55 µl di Buffer AVE (fornito con il QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit).
- Conservare il DNA genomico purificato tra -30°C e -15°C.

Nota: tutti i gli esami inclusi nel *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit generano prodotti della PCR di piccole dimensioni. Il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit non funzionerà tuttavia con DNA fortemente frammentato.

Protocollo: Rilevazione delle mutazioni EGFR

Punti importanti prima di iniziare

- Per ottenere risultati corretti, assicurarsi che ad ogni passaggio di miscelazione del processo di impostazione dell'esame venga eseguita la procedura di miscelazione descritta.
- Possono essere analizzati fino a 16 campioni per ogni sessione.
- Prima di avviare la procedura, leggere "Precauzioni generali", pag. 12.
- Acquisire esperienza con l'uso del Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM prima di avviare il protocollo. Fare riferimento al manuale utente dello strumento.
- Non agitare in vortex la *Taq* DNA polimerasi (*Taq*) o qualsiasi miscela contenente *Taq* DNA polimerasi, in quanto l'enzima potrebbe inattivarsi.
- Pipettare la *Taq* inserendo il puntale della pipetta appena sotto la superficie del liquido, per evitare che il puntale si cosparga eccessivamente di enzima.
- Per ogni campione di DNA, è necessario analizzare gli esami di controllo e di mutazione nella stessa seduta PCR, così da evitare eventuali variazioni tra le sedute.
- Per un utilizzo efficiente dei reagenti nel *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit, è consigliabile raggruppare il più possibile i campioni di DNA in batch e formare sedute complete. Analizzando i campioni singolarmente o a piccoli gruppi si consuma una maggiore quantità di reagenti e, conseguentemente, si riduce il numero di campioni che complessivamente possono essere analizzati con un unico *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Operazioni da eseguire prima di iniziare

- Prima di ogni uso, è necessario lasciare scongelare tutti i reagenti per almeno 1 ora a temperatura ambiente (15–25°C) ma senza superare 4,5 ore, quindi miscelare capovolgendo per 10 volte e centrifugare brevemente affinché il contenuto si depositi sul fondo della provetta.
- Prima di ogni uso, assicurarsi che la *Taq* abbia raggiunto la temperatura ambiente (15–25°C). Centrifugare brevemente la provetta affinché l'enzima si depositi sul fondo.
- Miscelare tutti i campioni capovolgendo 10 volte e centrifugando brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.

Procedura

1. Lasciare scongelare completamente a temperatura ambiente (15–25°C) per almeno 1 ora tutte le miscele delle reazioni, l'acqua priva di nucleasi per il controllo NTC e il controllo positivo (Positive Control, PC) EGFR (Tabella 1). Quando i reagenti si saranno scongelati, miscelarli capovolgendo ogni provetta 10 volte per prevenire concentrazioni localizzate di sali, quindi centrifugare brevemente affinché il contenuto si depositi sul fondo.

Tabella 1. Tempi di scongelamento, tempi di allestimento della PCR e temperature di conservazione

Tempo minimo di scongelamento	Tempo massimo di scongelamento	Temperatura di conservazione dopo allestimento PCR	Tempi massimi per allestimento PCR e conservazione
1 ora	4,5 ore	Temperatura ambiente (15–25°C)	6 ore
1 ora	4,5 ore	2–8°C	18 ore

Nota: l'allestimento della PCR deve avvenire a temperatura ambiente. Il termine "conservazione" si riferisce al tempo compreso tra il completamento dell'allestimento PCR e l'inizio dell'esecuzione della PCR sul Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM.

Nota: portare la *Taq* DNA polimerasi (*Taq*) a temperatura ambiente (15–25°C) contemporaneamente agli altri reagenti (vedere “Conservazione e manipolazione dei reagenti”, a pagina 14). Centrifugare brevemente la provetta affinché l’enzima si depositi sul fondo.

2. Eseguire le seguenti operazioni:

- 2a. Etichettare 4 provette per microcentrifuga (non fornite) corrispondenti a ognuna delle miscele di reazione illustrate nella Tabella 2.
- 2b. Preparare le miscele master (miscela di controllo o miscela di reazione di mutazione [provetta CTRL, T790M, delezioni, L858R] più la *Taq* DNA polimerasi [*Taq*]) in quantità sufficiente per i campioni di DNA, per una reazione di controllo positivo EGFR (provetta PC) e una reazione di controllo senza templatato con acqua priva di nucleasi (provetta NTC), rispettando i volumi indicati nella Tabella 2.

Nota: includere i reagenti per un campione extra, in modo da avere a disposizione un’eccedenza per l’allestimento della PCR.

Le miscele master contengono tutti i componenti necessari per la PCR, tranne il campione.

Tabella 2. Preparazione delle miscele master*

Esame	Provetta con miscela di reazione	Volume della miscela di reazione	Volume di <i>Taq</i> DNA polimerasi (provetta <i>Taq</i>)
Controllo	CTRL	19,50 µl x (n+1)	0,50 µl x (n+1)
T790M	T790M	19,50 µl x (n+1)	0,50 µl x (n+1)
Delezioni	Del	19,50 µl x (n+1)	0,50 µl x (n+1)
L858R	L858R	19,50 µl x (n+1)	0,50 µl x (n+1)

* Durante la preparazione della miscela master, predisporre una quantità sufficiente per un campione in più, in modo da avere a disposizione un’eccedenza per l’allestimento della PCR.

Nota: durante la preparazione della miscela master, dapprima viene aggiunto nella provetta il volume richiesto di miscela di controllo o di reazione alla mutazione e, in ultimo, viene aggiunta la *Taq* DNA polimerasi.

- Caricare il numero necessario di strisce da 4 provette per PCR (ogni striscia ha 4 provette) sul blocco di caricamento in base alla disposizione illustrata nella Tabella 3. Non tappare le provette.

Nota: lasciare i tappi nel contenitore di plastica finché non servono.

- Chiudere la provetta della miscela master e capovolgerla 10 volte per miscelare il contenuto, quindi centrifugare brevemente affinché la miscela si depositi sul fondo della provetta. Aggiungere immediatamente 20 µl di miscela master in ogni provetta della striscia per PCR.
- Aggiungere immediatamente 5 µl di acqua priva di nucleasi (H₂O) nella striscia di provette per PCR del controllo senza template (provette per PCR 9-12), quindi tappare le provette.
- Aggiungere 5 µl di ciascun campione nelle provette campione (provette per PCR 5-8, 13-16 e 17-20), quindi tappare le provette.
- Aggiungere 5 µl di controllo positivo (Positive Control, PC) EGFR nelle provette del controllo positivo (provette per PCR 1-4). Ogni campione di DNA deve essere analizzato con il controllo e con tutti gli esami di mutazione. La configurazione è illustrata nella Tabella 3.

Tabella 3. Disposizione degli esami di controllo e di mutazione

Esame	Controlli		N° campione						
	PC	NTC	1	2	3	4	5	6	7
Ctrl	1	9	17	25	33	41	49	57	65
T790M	2	10	18	26	34	42	50	58	66
Delezioni	3	11	19	27	35	43	51	59	67
L858R	4	12	20	28	36	44	52	60	68
			N° campione						
Esame	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ctrl	5	13	21	29	37	45	53	61	69
T790M	6	14	22	30	38	46	54	62	70
Delezioni	7	15	23	31	39	47	55	63	71
L858R	8	16	24	32	40	48	56	64	72

8. Con un pennarello indelebile contrassegnare i tappi delle prime provette nella posizione numerica più bassa di ogni striscia di 4 provette per PCR (cioè le posizioni 1, 5, 9 ecc.) per mostrare l'orientamento con cui devono essere caricate le provette sul 72-well rotor (rotore a 72 pozzetti) del Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM.
9. Capovolgere 4 volte le provette tappate per miscelare il campione e la miscela della reazione.
10. Collocare tutte le 4 strisce di provette per PCR nelle posizioni appropriate sul 72-well rotor (rotore a 72 pozzetti), quindi verificare a occhio che tutte le provette contengano lo stesso volume.

Nota: assicurarsi che le strisce di provette non vengano invertite durante il trasferimento sul rotore.
11. Se il rotore non è pieno, riempire gli spazi liberi con provette vuote tappate.
12. Caricare immediatamente il rotore sul Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM. Assicurarsi che l'anello di bloccaggio (accessorio del Rotor-Gene Q MDx) sia montato esattamente sopra al rotore, di modo che le provette restino ferme durante il processo.
13. Fare riferimento alle istruzioni per la configurazione del Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM (vedere "Protocollo: Configurazione del Rotor-Gene Q EGFR", a pagina 23) per creare il profilo delle temperature e avviare la seduta.

Protocollo: Configurazione del Rotor-Gene Q EGFR

I parametri di ciclaggio sono riportati nella Tabella 4.

Tabella 4. Parametri di ciclaggio

Cicli	Temperatura	Durata	Acquisizione di dati
1	95°C	15 minuti	Nessuna
40	95°C	30 secondi	Nessuna
	60°C	60 secondi	Green e Yellow

1. Fare doppio clic sull'icona del software Rotor-Gene Q versione 2.3 sul desktop del computer portatile collegato allo strumento Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM. Selezionare la scheda "Advanced" ("Avanzate") nella finestra "New Run" ("Nuovo processo") che viene visualizzata.
2. Per creare un nuovo modello, selezionare Empty Run (Processo a vuoto), quindi fare clic su New (Nuovo).
Viene visualizzata la finestra di dialogo "New Run Wizard" ("Procedura guidata nuovo processo").
3. Come tipo di rotore selezionare 72-Well Rotor (Rotore a 72 pozzetti). Confermare che l'anello di bloccaggio è montato selezionando la casella Locking Ring Attached (Anello bloccante applicato). Fare clic su Next (Avanti) (Figura 1).

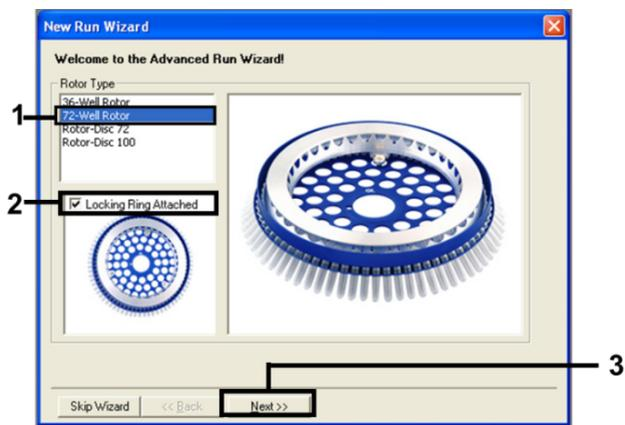


Figura 1. Finestra di dialogo "New Run Wizard" (Procedura guidata nuovo processo).

4. Immettere il nome dell'operatore nel campo Operator (Operatore). Aggiungere eventuali note e impostare il valore nel campo Reaction Volume (Volume di reazione) su 25. Verificare che i valori nel campo Sample Layout (Configurazione campioni) siano 1, 2, 3.... Fare clic su Next (Avanti) (Figura 2).

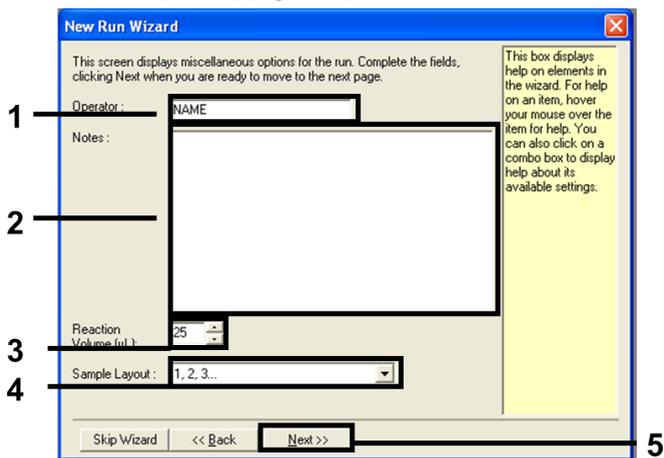


Figura 2. Immissione del nome dell'operatore e dei volumi delle reazioni.

5. Fare clic su Edit Profile (Modifica profilo) nella finestra di dialogo “New Run Wizard” (Procedura guidata nuovo processo) (Figura 3), quindi controllare i parametri del processo sulla base dei seguenti passaggi.

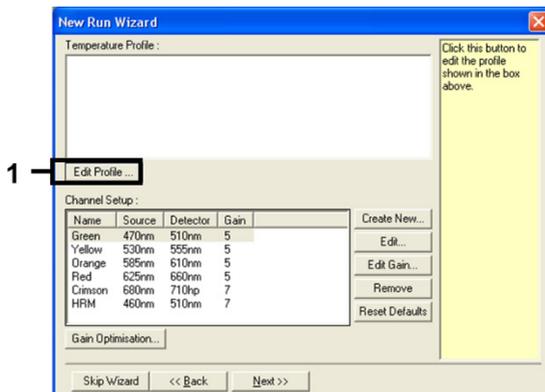


Figura 3. Modifica del profilo.

6. Fare clic su Insert after (Inserisci dopo), quindi selezionare New Hold at Temperature (Nuova sospensione alla temperatura) (Figura 4).

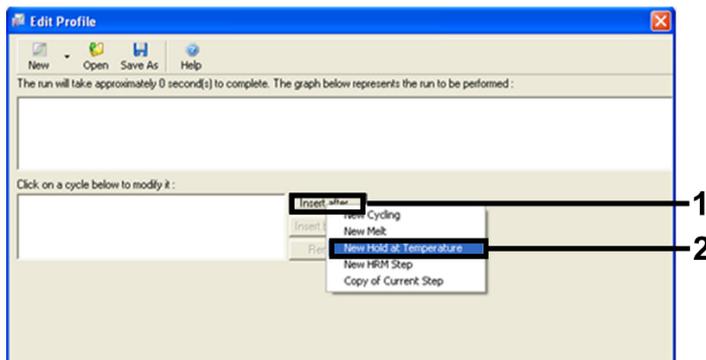


Figura 4. Aggiunta di una fase di incubazione iniziale.

7. Impostare il valore nel campo Hold Temperature (Temperatura di sospensione) su 95°C e Hold Time (Durata sospensione) su 15 mins 0 secs (15 minuti e 0 secondi). Fare clic su Insert After (Inserisci dopo), quindi selezionare New Cycling (Nuovo ciclaggio) (Figura 5).

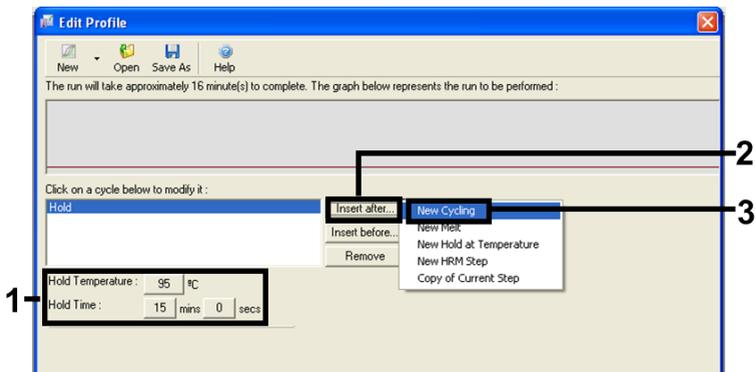


Figura 5. Fase di incubazione iniziale a 95°C.

8. Impostare 40 come numero di ripetizioni del ciclo. Selezionare il primo passaggio e impostare su 95°C for 30 seconds (95°C per 30 secondi) (Figura 6).

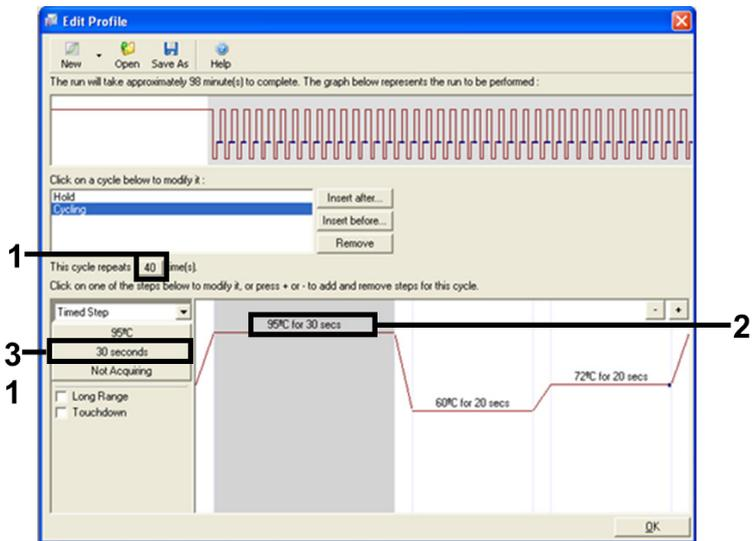


Figura 6. Fase di ciclaggio a 95°C.

9. Evidenziare il secondo passaggio e impostare su 60°C for 60 seconds (60°C per 60 secondi). Fare clic su Not Acquiring (Senza acquisizione) per abilitare l'acquisizione di dati durante questo passaggio. (Figura 7).

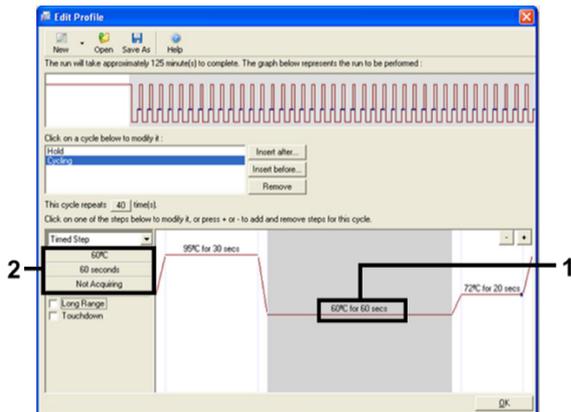


Figura 7. Fase di ciclaggio a 60°C.

10. Selezionare Green e Yellow dall'elenco Available Channels (Canali disponibili), quindi fare clic su > per spostarli nell'elenco Acquiring Channels (Canali di acquisizione). Fare clic su OK (Figura 8).

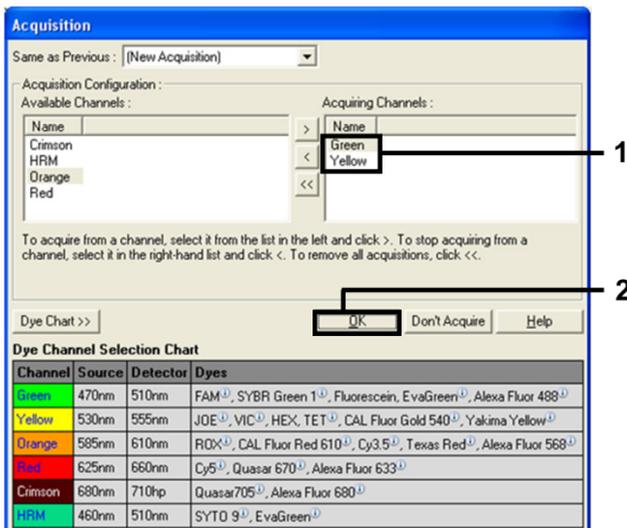


Figura 8. Acquisizione durante la fase di ciclaggio a 60°C.

11. Evidenziare il terzo passaggio e fare clic sul pulsante - per eliminare. Fare clic su OK (Figura 9).

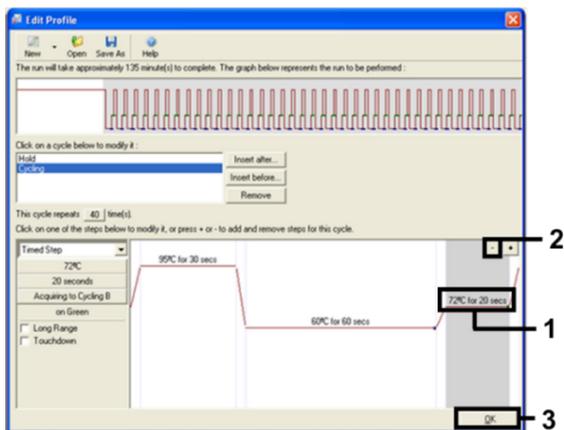


Figura 9. Rimozione del passaggio di estensione.

12. Nella finestra di dialogo successiva fare clic su Gain Optimisation (Ottimizzazione gain) (Figura 10).

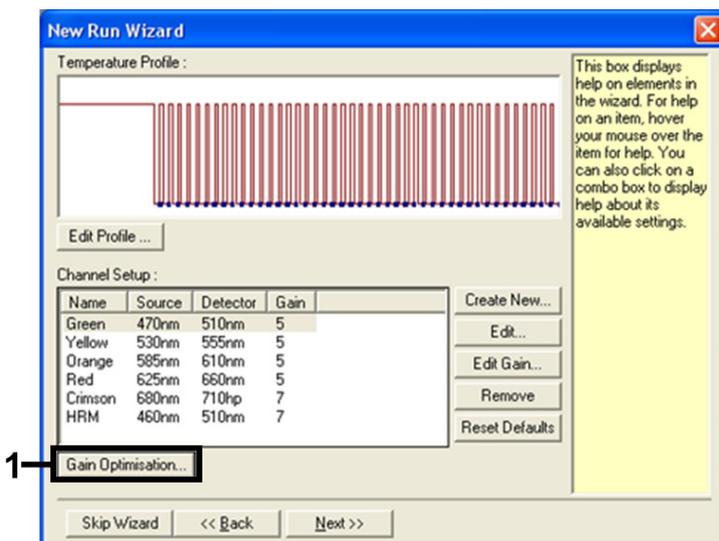


Figura 10. Ottimizzazione del gain.

13. Fare clic su Optimise Acquiring (Ottimizza acquisizione). Per ogni canale vengono visualizzate le impostazioni corrispondenti. Fare clic su OK per accettare questi valori predefiniti per entrambi i canali. (Figura 11).

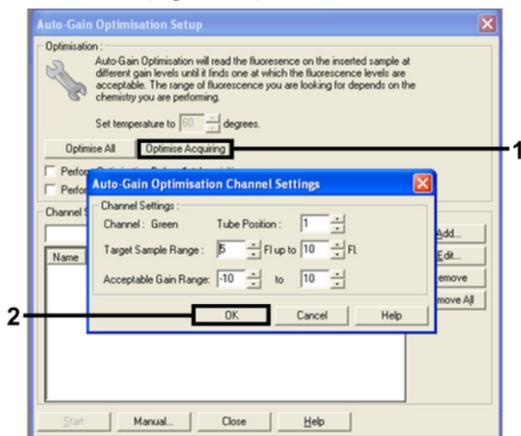


Figura 11. Ottimizzazione automatica del guadagno per il canale Green.

14. Selezionare la casella Perform Optimisation before 1st Acquisition (Esegui ottimizzazione prima della 1a acquisizione), quindi fare clic su Close (Chiudi) per tornare alla procedura guidata (Figura 12).

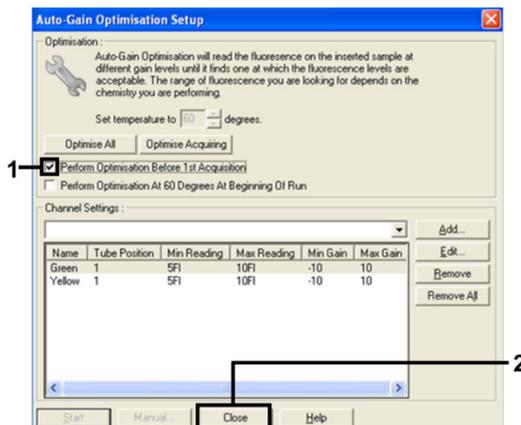


Figura 12. Selezione dei canali verde e giallo.

15. Fare clic su Next (Avanti) per salvare il modello in un percorso appropriato, selezionando "Save Template" (Salva modello).

Analisi dei dati relativi alla valutazione delle mutazioni

Al termine della seduta, analizzare i dati nel modo descritto di seguito.

Configurazione dell'analisi software

1. Aprire il file desiderato utilizzando il software Rotor-Gene Q versione 2.3.5 o superiore.
2. Se ai campioni non viene assegnato un nome prima di eseguire la sequenza, fare clic su Edit Samples (Modifica campioni).
3. Inserire i nomi dei campioni nella colonna Name (Nome).
Nota: lasciare bianchi i nomi degli eventuali pozzetti vuoti.
4. Fare clic su Analysis (Analisi). Nella pagina dell'analisi fare clic su Cycling A Yellow per controllare il canale HEX.
5. Verificare che sia evidenziata l'opzione Dynamic Tube (Provetta dinamica). Fare clic su Slope Correct (Correzione pendenza) e Linear Scale (Scala lineare).
6. Fare clic su Take Off Adj (Correzione take-off) e immettere 15,01 e 20,01 come mostrato nella Figura 13.

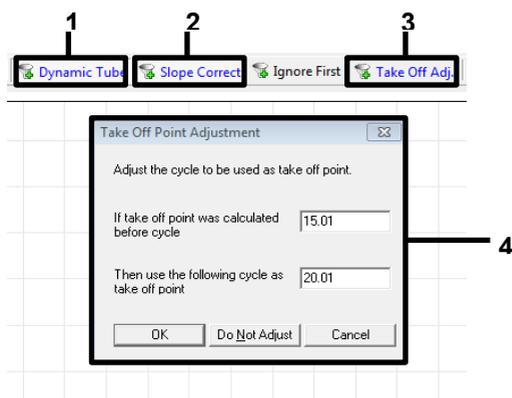


Figura 13. Impostazioni di normalizzazione per l'analisi EGFR. 1 = "Dynamic Tube" (Provetta dinamica), 2 = "Slope Correct" (Correzione pendenza), 3 = "Take Off Adj" (Correzione take-off), 4 = finestra di dialogo "Take Off Point Adjustment" (Correzione punto take-off) con i valori dei parametri.

7. Impostare 0,02 per la soglia e controllare i valori C_T HEX.
8. Nella pagina dell'analisi fare clic su Cycling A Green per visualizzare il canale FAM.
Impostare i parametri secondo il contenuto della Figura 13 precedente.
La provetta dinamica dovrebbe essere evidenziata.
9. Fare clic su Slope Correct (Correzione pendenza) e Linear Scale (Scala lineare).
10. Impostare 0,075 per la soglia e controllare i valori C_T FAM.

Analisi dei controlli della seduta

Al termine della seduta, analizzare i dati nel modo descritto di seguito.

- **Controllo negativo:** per confermare la totale assenza di contaminazione da template, il controllo NTC non deve generare un valore C_T inferiore a 40 nel canale verde (FAM). Per confermare la correttezza dell'allestimento della seduta, l'amplificazione del controllo NTC deve essere compresa tra 29,85 e 35,84 nel canale giallo (HEX) (controllo interno).
In presenza di amplificazione positiva nel canale verde e/o amplificazione al di fuori dell'intervallo compreso tra 29,85 e 35,84 nel canale giallo, la seduta non è valida.
- **Controllo positivo:** per ogni miscela di reazione, il controllo positivo (Positive Control, PC) EGFR deve generare un valore C_T compreso entro l'intervallo illustrato nella Tabella 5. Una seduta con un controllo positivo che non rientra in questo intervallo può indicare un problema di allestimento dell'esame, pertanto la seduta deve essere considerata fallita. Se il controllo positivo genera un valore C_T compreso entro l'intervallo (FAM), ma un controllo interno (HEX) genera un valore C_T al di fuori dell'intervallo compreso tra 29,85 e 35,84, proseguire l'analisi.
Nota: i dati del campione non devono essere utilizzati se entrambi i controlli, positivo e negativo, falliscono.

Tabella 5. Intervallo C_T accettabile per i controlli della seduta

Controllo della reazione	Esame	Canale	Intervallo C _T
Controllo positivo	Controllo	Green (FAM)	28,13-34,59
	T790M	Green (FAM)	30,22-34,98
	Delezioni	Green (FAM)	28,90-34,90
	L858R	Green (FAM)	29,97-34,81
Controllo senza template	Tutte e 4 le miscele di reazione	Green (FAM)	≥40,00
	Tutte e 4 le miscele di reazione	Yellow (HEX)	29,85-35,84

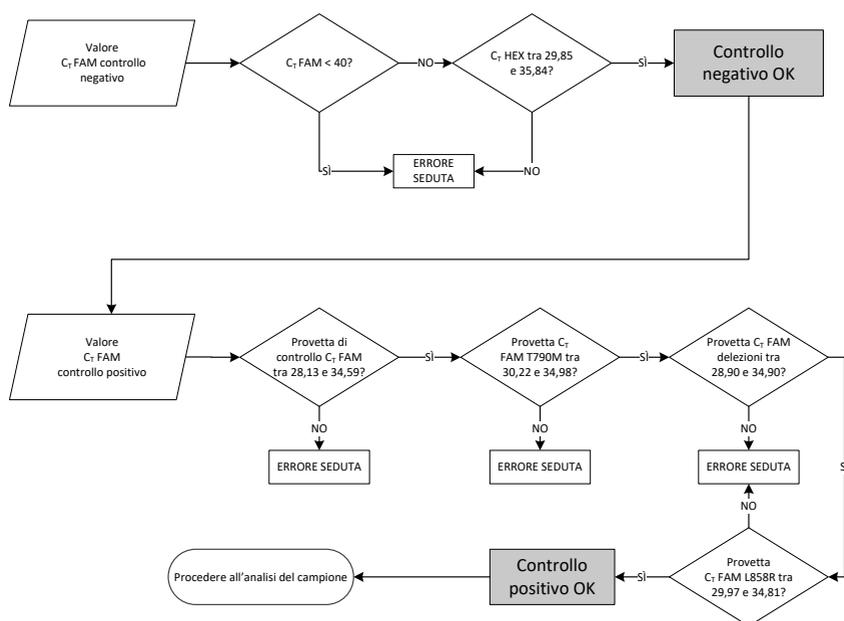


Figura 14. Flusso di lavoro per l'analisi dei controlli della seduta.

Posto che entrambi i controlli della seduta siano validi, ogni valore CT dell'esame di controllo del campione deve essere compreso nell'intervallo tra 23,70 e 31,10 nel canale verde (FAM) (Tabella 6).

Tabella 6. Intervallo di valori C_T FAM accettabili per la reazione di controllo del campione

Reaction mix (Miscela di reazione)	Canale	Intervallo C_T accettabile
Controllo	Green (FAM)	23,70 – 31,10

Se il campione non rientra in questo intervallo di valori, attenersi alle indicazioni seguenti.

- Valore C_T dell'esame di controllo del campione < 23,70: i campioni con un valore C_T di controllo < 23,70 determineranno un sovraccarico per gli esami di mutazione, pertanto devono essere diluiti. Per rilevare ogni mutazione a un livello basso, i campioni troppo concentrati devono essere diluiti in modo da rientrare nell'intervallo di valori indicato, tenendo presente che diluendo della metà si aumenterà il C_T di 1.
- Valore C_T dell'esame di controllo del campione > 31,10: il campione non contiene una quantità di DNA sufficiente per l'analisi.

Posto che entrambi i controlli della seduta siano validi e che l'esame di controllo rientri nell'intervallo indicato nella Tabella 6, ogni valore C_T dell'esame di mutazione deve rientrare nell'intervallo indicato nella Tabella 7 nel canale verde (FAM). Se il campione non rientra in questo intervallo di valori, attenersi alle indicazioni seguenti.

Tabella 7. Valori accettabili per la reazione di mutazione del campione

Reazione	Reaction mix (Miscela di reazione)	Canale	Intervallo C_T
Reazione di mutazione	T790M	Green (FAM)	0,00-40,00
	Delezioni	Green (FAM)	0,00-40,00
	L858R	Green (FAM)	0,00-40,00
	Tutte e tre le mutazioni	Yellow (HEX)	29,85-35,84

Nota: se un campione non genera un valore C_T (vale a dire, $C_T > 40$), la causa potrebbe essere la presenza di un inibitore, un errore nell'allestimento dell'esame o l'assenza di DNA di EGFR amplificabile.

- Il valore C_T del controllo interno è compreso tra 29,85 e 35,84: non è presente DNA di EGFR amplificabile.
- Il valore C_T del controllo interno non è compreso tra 29,85 e 35,84: ciò potrebbe indicare un errore di allestimento dell'esame o la presenza di un inibitore. L'effetto di un inibitore può essere attutito diluendo il campione, ma in questo modo viene diluito anche il DNA.

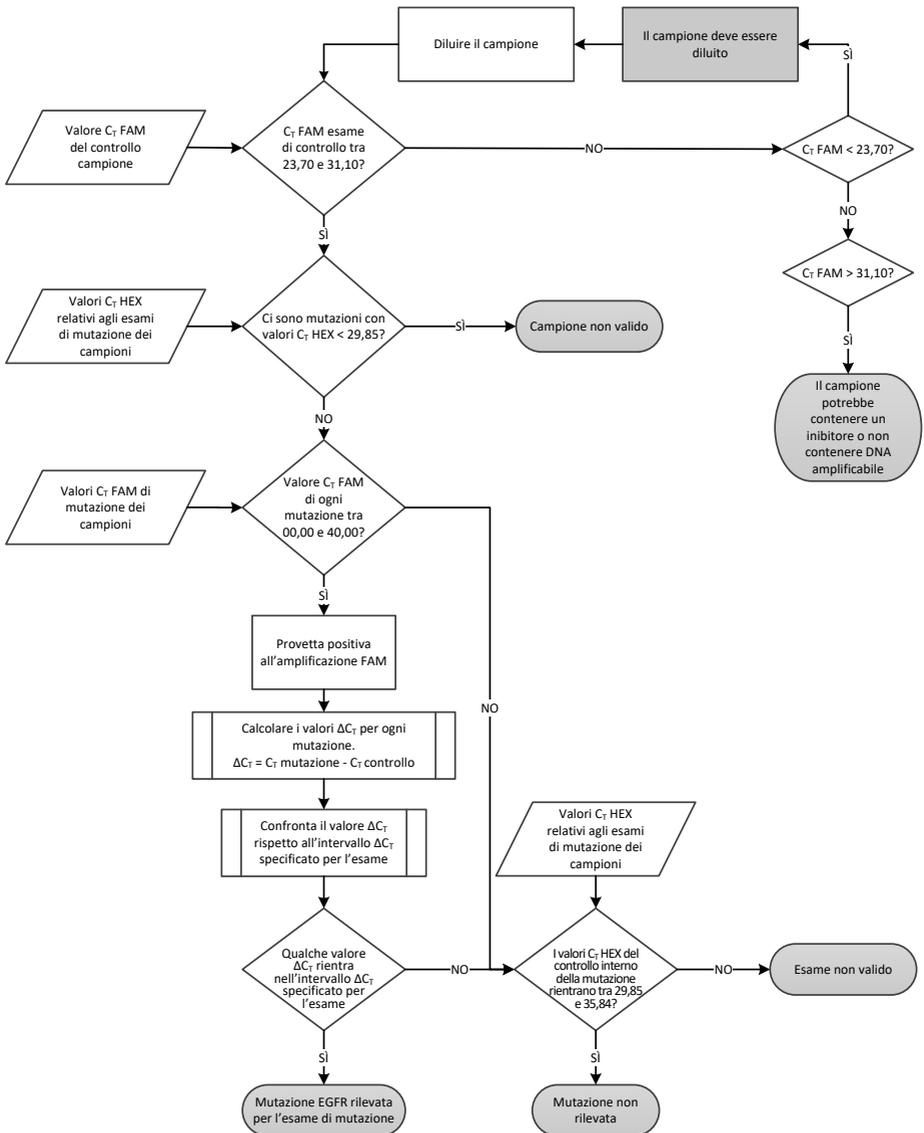


Figura 15. Diagramma di flusso dell'analisi mutazionale.

Valore C_T FAM relativo agli esami di mutazione dei campioni

I valori FAM per tutte e tre le miscele di reazione di mutazione devono essere confrontati con i valori riportati nella Tabella 8.

Per ogni campione di mutazione che genera un'amplificazione positiva, calcolare il valore di cut-off ΔC_T nel modo indicato di seguito, verificando che i valori C_T della mutazione e del controllo provengano dallo stesso campione.

$$\Delta C_T = C_T \text{ mutazione} - C_T \text{ controllo}$$

Confrontare il valore ΔC_T per il campione con l'intervallo di cut-off ΔC_T per l'esame in questione (Tabella 8), verificando che ad ogni esame venga applicato il punto di cut-off corretto.

Tabella 8. Intervallo di cut-off ΔC_T dell'esame di mutazione

Esame delle mutazioni	Intervallo di cut-off ΔC_T
T790M	tra -10,00 \geq e \leq 7,40
Delezioni	tra -10,00 \geq e \leq 8,00
L858R	tra -10,00 \geq e \leq 8,90

Il limite superiore dell'intervallo di cut-off ΔC_T è il punto al di sopra del quale un potenziale segnale positivo potrebbe essere causato dal segnale di fondo del primer ARMS su DNA wild-type. Se il valore ΔC_T del campione è più alto del punto superiore dell'intervallo di cut-off ΔC_T , il campione viene classificato con "Mutation not detected" (Mutazione non rilevata) oppure oltre i limiti di sensibilità del kit. Se il valore del campione rientra nei punti di cut-off ΔC_T , il campione viene classificato come positivo a una mutazione rilevata dall'esame. Se il valore del campione è al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di cut-off ΔC_T , ciò potrebbe essere dovuto a un artefatto di fluorescenza.

Nota: per i campioni che non presentano nessun valore C_T di mutazione FAM, è necessaria una valutazione del C_T del controllo interno (HEX) al fine di determinare se la mutazione non viene rilevata o se l'esame non è valido. Se il valore C_T HEX è compreso tra 29,85 e 35,84, la mutazione non viene rilevata. Se il valore cut-off ΔC_T HEX non rientra nell'intervallo, il campione non è valido.

Riassumendo, per ciascun campione, a ogni reazione di mutazione verrà assegnato uno stato di mutazione rilevata, mutazione non rilevata, oppure non valida sulla base dei criteri seguenti.

- Mutazione rilevata: Il valore positivo all'amplificazione FAM e il valore ΔC_T rientrano nell'intervallo di cut-off ΔC_T . Se vengono rilevate più mutazioni, possono essere indicate tutte nel report.
- Mutazione non rilevata:
 - Il valore positivo all'amplificazione FAM e il valore di cut-off ΔC_T è al di sopra dell'intervallo di cut-off ΔC_T e l'HEX (controllo interno) rientra nell'intervallo compreso tra 29,85 e 35,84.
 - Risultato negativo all'amplificazione FAM ed HEX (controllo interno) nel range compreso tra 29,85 e 35,84.
- Non valido: risultato negativo all'amplificazione FAM e amplificazione HEX al di fuori delle specifiche.
 - Il valore ΔC_T calcolato è al di sotto dell'intervallo di cut-off ΔC_T ed HEX (controllo interno) rientra nel range previsto. Un valore ΔC_T inferiore a -10,00 indica la possibilità che si sia verificato un artefatto di fluorescenza.

Guida alla risoluzione dei problemi

Questa guida alla risoluzione dei problemi può essere utile per risolvere eventuali situazioni problematiche. Per maggiori informazioni, consultare anche la pagina relativa alle domande frequenti (Frequently Asked Questions, FAQ) nel nostro servizio di assistenza tecnica: www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Gli esperti del servizio dei servizi tecnici QIAGEN sono sempre disponibili per rispondere a qualsiasi domanda riguardante informazioni e protocolli presentati in questo manuale o le tecnologie per campioni ed esami (per le informazioni sui contatti vedere il retro di copertina o visitare il sito www.qiagen.com).

Commenti e suggerimenti

Nessun segnale con il controllo positivo (Positive Control, PC) EGFR nel canale di fluorescenza Cycling Green

- | | |
|---|--|
| a) Il canale di fluorescenza selezionato per l'analisi dei dati PCR non è conforme al protocollo. | Per l'analisi dei dati, selezionare il canale di fluorescenza Cycling Green per la PCR analitica EGFR e il canale di fluorescenza Cycling Yellow per la PCR del controllo interno. |
| b) Programmazione non corretta del profilo delle temperature dello strumento Rotor Gene Q MDx 5plex HRM. | Confrontare il profilo di temperatura con il protocollo e, in caso di discrepanza, ripetere la seduta. |
| c) Configurazione errata della PCR | Controllare i passaggi della procedura facendo riferimento allo schema di pipettamento, quindi ripetere la PCR se necessario. |
| d) Le condizioni di conservazione per uno o più componenti del kit non corrispondevano alle istruzioni fornite in "Conservazione e manipolazione dei reagenti" (pag. 14). | Controllare le condizioni di conservazione e la data di scadenza (vedere l'etichetta del kit) dei reagenti e, se necessario, utilizzare un nuovo kit. |
| e) Il <i>therascreen</i> EGFR Plasma RGQ PCR Kit è scaduto | Controllare le condizioni di conservazione e la data di scadenza (vedere l'etichetta del kit) dei reagenti e, se necessario, utilizzare un nuovo kit. |

Commenti e suggerimenti

Segnali con i controlli negativi nel canale di fluorescenza per Cycling Green della PCR analitica

- a) Si è verificata una contaminazione durante la preparazione della PCR
- Ripetere la PCR in replicati con reagenti nuovi.
Se possibile, chiudere le provette per PCR subito dopo l'aggiunta del campione da testare.
Assicurarsi che l'area di lavoro e gli strumenti vengano decontaminati a intervalli regolari.

Superamenti della soglia multipli o Δ valore C_T al di sotto dell'intervallo di cut-off

- a) Miscelazione errata durante la configurazione dell'esame
- Ripetere la PCR se questo influisce su un controllo o ripetere il test del campione problematico.
Seguire le Istruzioni per l'uso, facendo molta attenzione ai passaggi della miscelazione.

Controllo di qualità

In conformità con il Sistema di Gestione della Qualità di QIAGEN, dotato di certificazione ISO, ogni lotto del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit è stato sottoposto a test sulla base di specifiche tecniche predefinite, in modo da garantire la costante qualità del prodotto.

Limitazioni

I risultati ottenuti usando il prodotto devono essere interpretati congiuntamente a tutti i riscontri clinici e di laboratorio pertinenti e non devono essere utilizzati da soli a scopo di diagnosi.

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale adeguatamente preparato e specializzato nelle procedure di diagnostica in vitro e nell'uso dello strumento Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM.

Gli studi di validazione analitica hanno riguardato il DNA umano estratto dai campioni di plasma.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso sul termociclatore per real-time PCR Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM.

Per ottenere risultati ottimali, è necessario osservare scrupolosamente le istruzioni contenute nel *Manuale del theascreen EGFR Plasma RGQ PCR Kit*. La diluizione dei reagenti, salvo con le modalità descritte in questo manuale, è sconsigliata in quanto potrebbe determinare un decadimento delle prestazioni.

Prestare attenzione alle date di scadenza e alle condizioni di conservazione stampate sulla confezione e sulle etichette di tutti i componenti. Non utilizzare componenti scaduti o conservati in modo scorretto.

I primer nella miscela di reazione delle delezioni EGFR sono stati progettati per più delezioni dell'esone 19, comprendenti i nucleotidi da 55174772 a 55174795 (GRCh38 chr7), un intervallo di 23 bp.

Mentre è stato dimostrato e convalidato in modo analitico che l'esame delle delezioni dell'esone 19 è in grado rilevare determinate delezioni all'interno dell'esone 19 (vedere la Tabella 13 di questo manuale), è tuttavia possibile che altre mutazioni (incluse, tra le altre, ulteriori delezioni dell'esone 19, inserzioni nell'esone 19 e la mutazione L747P) vengano amplificate dalla miscela di reazione delle delezioni.

Se presenti, tali ulteriori mutazioni daranno luogo a un risultato "Deletions Detected" (Delezioni rilevate) per un dato campione paziente.

Inoltre, è possibile che la mutazione L858Q venga rilevata dalla miscela di reazione L858R. Pertanto, se presente in un campione paziente, la mutazione L858Q può dar luogo a un risultato "L858R Mutation Detected" (Rilevata la mutazione L858R).

Caratteristiche delle prestazioni

Sensibilità analitica: limite del bianco (Limit of Blank, LOB)

Per valutare le prestazioni del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit in assenza di template e per assicurare che un campione bianco o un campione con DNA wild-type non generino un segnale analitico che potrebbe indicare una mutazione con bassa concentrazione, è stato analizzato il DNA wild-type EGFR di plasma NSCLC ottenuto da 59 campioni diversi. In base ai criteri di accettabilità rispettati dallo studio, almeno il 95% dei campioni wild-type doveva avere un valore di cut-off ΔC_T al di sopra del cut-off corrispondente.

Limite di sensibilità (Limit of Detection, LOD)

Il limite di sensibilità (Limit of Detection, LOD) è la percentuale minima di DNA mutante che è possibile rilevare in un fondo di DNA wild-type, quando si ottengono classificazioni corrette delle mutazioni per il 95% del DNA amplificabile totale (entro l'intervallo iniziale) per ogni campione positivo a ciascuna mutazione (C95). L'intervallo di lavoro del DNA iniziale per l'esame è definito dal valore C_T ed è preimpostato sull'intervallo compreso tra 23,70 e 31,10.

Il limite LOD è stato determinato con livelli bassi di DNA iniziale (valore C_T di controllo di circa 30,10), utilizzando il DNA ottenuto da tessuti FFPE per il *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit. Il limite LOD è stato determinato utilizzando sia campioni clinici FFPE che linee cellulari FFPE a livelli bassi di DNA iniziale per queste mutazioni EGFR.

I valori LOD definiti utilizzando il tessuto FFPE sono stati verificati per il kit *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR, con DNA ottenuto da campioni di plasma positivi con mutanti artificiali.

I valori LOD finali forniti nella Tabella 9 nella pagina successiva indicano la percentuale di mutazione che ha fornito una probabilità prevista di classificazione corretta pari al 95% per ognuna delle mutazioni.

Tabella 9. Valori LOD per ognuno degli esami di mutazione EGFR

Esone	Mutazione	ID COSMIC*	LOD % dichiarato
20	T790M	6240	17,5*
		6223	6,4*
		13551	4,24*
		12728	2,43 [†]
		12419	16,87 [†]
		12422	3,24 [†]
		6218	9,83 [†]
		6210	7,44 [†]
		6254	10,2*
		12370	8,1*
19	Delezioni	12678	10,40 [†]
		12367	4,39 [†]
		12384	7,54 [†]
		6225	6,5*
		6220	2,7*
		6255	0,81*
		12382	1,45*
		12383	4,58*
21	L858R	6224	5,94*
		12387	4,91 [†]
		12369	4,94*

*Valori LOD dichiarati, verificati in plasma nell'ambito dello studio di conferma dei limiti LOD del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit.

[†] Queste mutazioni non sono state confermate nel plasma.

Sensibilità analitica – Δ Cut-off C_T e intervallo di cut-off ΔC_T

Per impostare i valori cut-off degli esami, è stato scelto un approccio basato sul rischio rispetto alle percentuali di falsi positivi. Come uno dei componenti nello sviluppo dei valori cut-off sono stati utilizzati i valori LOB stimati.

I rispettivi intervalli di cut-off ΔC_T stabiliti per ciascun esame di mutazione incluso nel *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono illustrati nella Tabella 10.

Tabella 10. Intervalli di cut-off ΔC_T del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit

Esame di mutazione	Intervallo di cut-off ΔC_T
T790M	tra -10,00 \geq e \leq 7,40
Delezione	tra -10,00 \geq e \leq 8,00
L858R	tra -10,00 \geq e \leq 8,90

Ripetibilità e riproducibilità

La ripetibilità e la riproducibilità sono state valutate analizzando un livello di mutazione 3 x LOD in un fondo di DNA genomico wild-type presso 3 laboratori, utilizzando più lotti del kit, operatori e sedute in giorni diversi ed eseguendo 2 ripetizioni per ogni campione. Per tutti e 3 gli esami di mutazione, i campioni con DNA mutante hanno prodotto il 100% di risultati positivi alla mutazione. I campioni wild-type sono risultati negativi alla mutazione per tutti gli esami eseguiti in tutti i laboratori.

Impatto del DNA iniziale sui valori C_T

Il livello di DNA iniziale è definito come la quantità totale di DNA EGFR amplificabile in un campione, calcolato sulla base dei valori C_T ricavati dalla reazione di controllo. Per dimostrare che le prestazioni del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit sono coerenti e uniformi lungo tutto l'intervallo C_T della reazione di controllo (23,70-31,10), tutti e 3 gli esami di mutazione EGFR sono stati eseguiti su una serie di diluizioni 1:3 a sei punti (DNA estratto da linee cellulari FFPE). Il valore C_T target per la diluizione uno è stato di circa 24,70 per ogni mutazione. La diluizione finale, che ha generato un valore C_T di circa 32-33, non è rientrata nell'intervallo C_T della reazione di controllo. Nel complesso, i valori di cut-off ΔC_T misurati a vari livelli di DNA totale iniziale sono risultati coerenti e uniformi lungo tutto l'intervallo valido del *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit.

Sostanze interferenti

Sostanze interferenti endogene

Sono state aggiunte alcune sostanze potenzialmente interferenti, con una concentrazione $3 \times \text{LOD}$, nei campioni di plasma positivi con mutante artificiale. Successivamente questi campioni sono stati analizzati con il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit. I campioni che contengono sostanze potenzialmente interferenti sono stati confrontati con i campioni di plasma positivi con mutante artificiale, a una concentrazione $3 \times \text{LOD}$ non contenenti alcuna sostanza interferente aggiunta. Ogni sostanza interferente è stata sottoposta a 4 ripetizioni del test.

Una differenza $> 2 \times$ deviazioni standard (DS) (come da studio sulla precisione) tra ΔC_T del "test" e del "controllo" (ovvero, nessuna sostanza interferente) è stata interpretata come indicativa di una possibile interferenza. In questi casi, viene riferita la differenza osservata in ΔC_T .

Le concentrazioni dei test illustrate nella Tabella 11 sono state selezionate sulla base delle linee guida EP07-A2 del CLSI e sono rappresentative delle concentrazioni massime che si presume di trovare in un campione clinico.

Nota: queste sostanze endogene sono state introdotte nei campioni di plasma positivi alla mutazione artificiale, costituiti da plasma ottenuto da donatori sani. Si tratta dunque di sostanze endogene che potevano essere presenti naturalmente nei campioni, a concentrazioni ignote, prima del loro arricchimento. Probabilmente la concentrazione finale di ogni sostanza endogena potenzialmente interferente che è stata sottoposta ai test era quindi maggiore della concentrazione dichiarata dal test.

Tabella 11. Sostanze endogene potenzialmente interferenti

Sostanze potenzialmente interferenti	Concentrazione nel test
Bilirubina non coniugata	15 mg/dl
Emoglobina (umana)	0,2 g/dl
Trigliceridi	3 g/dl

Esame T790M

Le seguenti sostanze endogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 11, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,40 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame T790M:

- Trigliceridi, differenza di $1,37 \Delta C_T$

Esame delle delezioni

Le seguenti sostanze endogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 11, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,71 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame delle delezioni:

- Emoglobina, differenza di $0,80 \Delta C_T$

Esame L858R

Le seguenti sostanze endogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 11, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,56 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame L858R:

- Bilirubina, differenza di $1,13 \Delta C_T$
- Trigliceridi, differenza di $1,53 \Delta C_T$

Sostanze interferenti esogene

Sono state aggiunte alcune sostanze potenzialmente interferenti, con una concentrazione $3 \times LOD$, nei campioni di plasma positivi con mutante artificiale. Successivamente questi campioni sono stati analizzati con il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit. I campioni che contengono sostanze potenzialmente interferenti sono stati confrontati con i campioni di plasma positivi con mutante artificiale, a una concentrazione $3 \times LOD$ non contenenti alcuna sostanza interferente aggiunta. Ogni sostanza interferente è stata sottoposta a 4 ripetizioni del test.

Una differenza $> 2 \times$ deviazioni standard (come da studio sulla precisione) tra ΔC_T del "test" e ΔC_T del "controllo" (ovvero, nessuna sostanza interferente) è stata interpretata come indicativa di una possibile interferenza. In questi casi, viene riferita la differenza osservata in ΔC_T .

Le concentrazioni dei test riportate nella Tabella 12 sono state selezionate sulla base delle linee guida EP07-A2 del CLSI e sono superiori alla concentrazione terapeutica in tutti i casi.

Tabella 12. Sostanze endogene potenzialmente interferenti

Sostanza potenzialmente interferente	Concentrazione nel test ($\mu\text{g/ml}$)
Citalopram idrobromuro	0,75
Paroxetina cloridrato emiidrato	1,14
Sertralina cloridrato	0,67
Fluoxetina cloridrato	3,87
Acetaminofene	200,7
EDTA K_2	3600

Esame T790M

Le seguenti sostanze esogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 12, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,40 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame T790M:

- Citalopram idrobromuro, differenza di $0,52 \Delta C_T$
- Sertralina cloridrato, differenza di $0,47 \Delta C_T$
- Fluoxetina cloridrato, differenza di $0,48 \Delta C_T$

Esame delle delezioni

Le seguenti sostanze esogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 12, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,71 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame delle delezioni:

- Fluoxetina, differenza di $0,73 \Delta C_T$

Esame L858R

Le seguenti sostanze esogene, alle concentrazioni riportate nella Tabella 12, hanno avuto un effetto $> 2 \times DS$ ($0,56 \Delta C_T$) sulle prestazioni dell'esame L858R:

- Citalopram idrobromuro, differenza di $0,72 \Delta C_T$
- Paroxetina cloridrato, differenza di $0,92 \Delta C_T$
- Sertralina cloridrato, differenza di $0,82 \Delta C_T$
- Fluoxetina cloridrato, differenza di $0,98 \Delta C_T$
- Acetaminofene, differenza di $0,81 \Delta C_T$
- EDTA K_2 , differenza di $0,57 \Delta C_T$

Prestazioni cliniche

La sperimentazione clinica NCT01203917 è consistita in uno studio in aperto a braccio singolo di fase IV, il cui obiettivo era valutare l'efficacia e la sicurezza/tollerabilità del gefitinib come trattamento di prima linea in pazienti caucasici con diagnosi di NSCLC in stadio IIIA/B/IV e positivi alla mutazione EGFR.

L'idoneità dei pazienti per la sperimentazione clinica NCT01203917 era subordinata alla presenza di mutazioni di sensibilizzazione EGFR. Lo stato mutazionale EGFR dei pazienti NSCLC è stato valutato utilizzando l'autorizzazione dell'esame per studio clinico (Clinical Trial Assay, CTA) con il DNA ottenuto da campioni di tessuto e di plasma appartenenti allo stesso donatore. L'obiettivo esplorativo pre-programmato dello studio relativamente ai biomarcatori consisteva nel capire se fosse possibile eseguire l'analisi mutazionale sui campioni di plasma in caso di irreperibilità dei campioni di tessuto. La concordanza tra i risultati è stata molto elevata (94,3%) per quanto riguarda i campioni di tessuto e i campioni di plasma appartenenti allo stesso donatore. La specificità dell'esame è stata del 99,8% e la sensibilità del 65,7%.

I campioni di plasma appartenenti ai pazienti sottoposti allo screening per la sperimentazione clinica NCT01203917 sono stati analizzati retrospettivamente con il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit. È stato svolto uno studio integrativo per valutare la concordanza tra il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit e il CTA utilizzato per selezionare i pazienti idonei alla sperimentazione clinica NCT01203917. La conclusione a cui si è giunti è che il CTA e il *therascreen* EGFR Plasma RGQ PCR Kit si equivalgono.

Bibliografia

1. Douillard, J.Y., et al. (2014). First-line gefitinib in Caucasian EGFR mutation-positive NSCLC patients: a phase-IV, open-label, single-arm study. *Br J Cancer* 110(1), 55.
2. Walsh, K., et. al. (2014) A cautionary lesson on the use of targeted methods for EGFR mutation analysis; a case report. *J. Clin. Pathol.* 67, 734
3. Huang, J., Wang, Y., Zhai, Y., and Wang, J. (2018) Non-small cell lung cancer harboring a rare EGFR L747P mutation showing intrinsic resistance to both gefitinib and osimertinib (AZD9291): A case report. *Thorac. Cancer.* 9, 745

Informazioni di contatto

Per assistenza tecnica e ulteriori informazioni, consultare i servizi tecnici QIAGEN all'indirizzo www.qiagen.com/Support, chiamare il numero 00800-22-44-6000 oppure contattare uno dei reparti di assistenza tecnica QIAGEN o i distributori locali (vedere il retro della copertina o visitare il sito www.qiagen.com).

Simboli

I seguenti simboli possono apparire nelle istruzioni per l'uso o sulla confezione e sull'etichettatura:

Simbolo	Definizione del simbolo
 Σ <N>	Contenuto di reagenti sufficiente per <N> reazioni
	Data di scadenza
	Dispositivo medico-diagnostico in vitro
	Numero di catalogo
	Numero di lotto
	Numero di materiale (vale a dire, l'etichetta del componente)
	Componenti
	Contiene
	Numero
	Codice GTIN
Rn	R sta per revisione delle istruzioni per l'uso e n è il numero di revisione
	Limite di temperatura
	Produttore

Simbolo

Definizione del simbolo



Consultare le istruzioni per l'uso



Avvertenza/Cautela

Appendice A: Dettagli delle mutazioni

La Tabella 13 mostra gli ID COSMIC tratti dal Catalogue of Somatic Mutations in Cancer (www.sanger.ac.uk/genetics/CGP/cosmic).

Tabella 13. Elenco delle mutazioni e degli ID COSMIC*

Mutazione	Esone	Cambiamento delle basi	ID COSMIC
T790M	20	2369C>T	6240
L858R	21	2573T>G	6224
		2235_2249del15	6223
		2235_2252>AAT (complesso)	13551
		2236_2253del18	12728
		2237_2251del15	12678
		2237_2254del18	12367
		2237_2255>T (complesso)	12384
		2236_2250del15	6225
		2238_2255del18	6220
		2238_2248>GC (complesso)	12422
Delezioni	19	2238_2252>GCA (complesso)	12419
		2239_2247del9	6218
		2239_2253del15	6254
		2239_2256del18	6255
		2239_2248TTAAGAGAAG>C (complesso)	12382
		2239_2258>CA (complesso)	12387
		2240_2251del12	6210
		2240_2257del18	12370
		2240_2254del15	12369
		2239_2251>C (complesso)	12383

Informazioni per gli ordini

Prodotto	Indice	N. cat.
<i>therascreen</i> EGFR Plasma RGQ PCR Kit – per la rilevazione delle mutazioni nel gene EGFR		
<i>therascreen</i> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)	Per 24 reazioni: 1 esame di controllo, 7 esami di mutazione, controllo positivo, <i>Taq</i> DNA polimerasi	870311
Rotor-Gene Q MDx e accessori		
Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM System	Termociclatore per real-time PCR e analizzatore per fusione ad alta risoluzione a 5 canali (verde, giallo, arancio, rosso, cremisi) più canale per fusione ad alta risoluzione (High Resolution Melt, HRM), notebook, software, accessori, 1 anno di garanzia su parti e materiali, installazione e addestramento non inclusi	9002033
Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM Platform	Termociclatore per real-time PCR e analizzatore per fusione ad alta risoluzione a 5 canali (verde, giallo, arancio, rosso, cremisi) più canale per fusione ad alta risoluzione (High Resolution Melt, HRM), notebook, software, accessori, 1 anno di garanzia su parti e manodopera, installazione e addestramento	9002032
Loading Block 72 x 0.1 ml Tubes	Blocco in alluminio per la configurazione manuale delle reazioni con una pipetta a canale singolo in 72 provette da 0,1 ml	9018901
Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (250)	250 strisce di 4 provette e tappi per 1000 reazioni	981103

Prodotto	Indice	N. cat.
Strip Tubes and Caps, 0.1 ml (2500)	10 x 250 strisce di 4 provette e tappi per 10.000 reazioni	981106
Prodotti correlati		
QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit	Per 50 preparazioni: colonnine QIAamp Mini, prolungher per provette (20 ml), QIAGEN Proteinase K, RNA trasportatore, tamponi, VacConnectors e Collection Tubes (1.5 ml e 2 ml)	55114

Per informazioni aggiornate sulle licenze e sulle esclusioni di responsabilità specifiche del prodotto, vedere il manuale del kit o il manuale dell'utente QIAGEN. I manuali dei kit e i manuali utente QIAGEN sono disponibili sul sito www.qiagen.com oppure possono essere richiesti ai servizi tecnici QIAGEN o al distributore locale.

Cronologia delle revisioni del documento

Revisione

Descrizione

R4, ottobre 2019

Modificato il produttore legale (**copertina**)
Adattamento del nome dello strumento da Rotor-Gene Q MDx a Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM per allinearlo al nome sull'etichetta dello strumento
Correzione delle istruzioni di conservazione dei reagenti da 90 giorni a 12 mesi o alla data di scadenza
Aggiornamento della sezione Limitazioni con le informazioni relative all'esame delle delezioni dell'esone 19 e all'esame L858R
Revisione della **Tabella 9** per sostituire l'esone 21 L858R duplicato con le delezioni dell'esone 19
Rimozione del simbolo EC + REP dalla prima di copertina e dalla sezione Simboli

R5, giugno 2020

Aggiornamento dei riferimenti alla versione del software RGQ dalla 2.3 alla 2.3.5 o successive
Aggiornamento delle Tabelle 8 e 10 per implementare il nuovo intervallo di cut-off ΔC_T e regolazione di tutte le descrizioni correlate in tutto il manuale
Aggiornamento dei capitoli relativi al protocollo per includere informazioni sull'importanza della miscelazione nei punti "Importante" prima dell'inizio della sezione; evidenziazione dei dettagli della miscelazione in tutti i passaggi della miscelazione stessa.
Aggiunta di un passaggio di miscelazione alla sezione "Protocollo: Rilevazione delle mutazioni EGFR"
Aggiornamento della sezione Risoluzione dei problemi per aggiungere la soluzione per superamenti di soglia multipli

R6, giugno 2022

Aggiornamento di una tabella nella sezione Sostanze interferenti per modificare la concentrazione nel test per la bilirubina non coniugata da 150 a 15 mg/dbl

Pagina lasciata vuota intenzionalmente

Pagina lasciata vuota intenzionalmente

Pagina lasciata vuota intenzionalmente

Contratto di licenza limitata per il *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit

L'uso di questo prodotto implica l'accordo di qualsiasi acquirente o utente del prodotto ai seguenti termini:

1. Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente in conformità ai protocolli forniti insieme al prodotto e al presente manuale e soltanto con i componenti contenuti nel pannello. QIAGEN non concede nessuna licenza, nell'ambito della sua proprietà intellettuale, per l'utilizzo o l'integrazione dei componenti di questo pannello con qualsiasi componente non incluso in questo pannello, fatta eccezione per i protocolli forniti con il prodotto, il presente manuale e i protocolli aggiuntivi disponibili sul sito www.qiagen.com. Alcuni di questi protocolli aggiuntivi sono stati messi a punto da utenti QIAGEN a beneficio degli utenti QIAGEN. Si tratta di protocolli che non sono stati collaudati o ottimizzati da QIAGEN. QIAGEN non offre alcuna garanzia in merito a essi né alla violazione da parte di essi di eventuali diritti di terzi.
2. Al di fuori delle licenze espressamente dichiarate, QIAGEN non garantisce che questo pannello e/o il suo utilizzo non violino i diritti di terzi.
3. Questo pannello e i relativi componenti sono concessi in licenza per un unico uso e non possono essere riutilizzati, rinnovati o rivenduti.
4. QIAGEN esclude specificamente qualunque altra licenza, espressa o implicita, che non rientri tra quelle espressamente dichiarate.
5. L'acquirente e l'utente del pannello accettano di non prendere o permettere a chiunque altro di prendere misure che potrebbero portare o facilitare qualsiasi atto vietato sopra. QIAGEN farà valere i divieti di questo Contratto di licenza limitata presso qualsiasi foro e otterrà il risarcimento di tutte le spese sostenute a scopo di indagine e consulenza legale, ivi comprese le parcelle degli avvocati, con riferimento a qualsiasi causa legale intentata per fare rispettare questo Contratto di licenza limitata o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale correlato a questo pannello e/o ai relativi componenti.

Per i termini di licenza aggiornati, visitare il sito www.qiagen.com.

Marchi commerciali: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], QIAamp[®], *therascreen*[®], Rotor-Gene[®], Scorpions[®] (QIAGEN Group); FAM[™], HEX[™] (Thermo Fisher Scientific Inc.); IRESSA[®] (AstraZeneca Group). I marchi registrati, di fabbrica e così via utilizzati in questo documento, anche se non indicati in modo specifico come tali, devono essere considerati come protetti dalla legge.

Giugno-2022 HB-1898-007 1127512IT © 2022 QIAGEN, tutti i diritti riservati.

