

Fevereiro de 2023

# Instruções de utilização do QIASymphony<sup>®</sup> PAXgene<sup>®</sup> Blood ccfDNA Kit (manual)



192

Versão 1



Para utilização em diagnóstico in vitro



768566



PreAnalytiX GmbH

Garstligweg 8, 8634 Hombrechtikon, Suíça

1130770PT



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, ALEMANHA

PreAnalytiX Company

PreAnalytiX GmbH

8634 Hombrechtikon

Suíça

[www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com)

Marcas comerciais: PAXgene®, PreAnalytiX® (PreAnalytiX GmbH)  
QIAGEN®, QIAamp®, QIAcube®, QIASymphony® (Grupo QIAGEN)  
BD™ (Becton Dickinson and Company)  
Corning®, Falcon® (Corning, Inc.)  
Eppendorf® (Eppendorf AG)  
SpeedVac® (Thermo Fisher Scientific ou as respetivas subsidiárias).

PreAnalytiX GmbH, 8634 Hombrechtikon, CH.

1130770PT HB-2866-003

© 2023 PreAnalytiX GmbH. Salvo indicação em contrário, PreAnalytiX, o logótipo do PreAnalytiX e todas as outras marcas comerciais são propriedade da PreAnalytiX GmbH, Hombrechtikon, CH.

### **Acordo de licença limitada para o QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit**

A utilização deste produto implica a aceitação dos seguintes termos por parte de qualquer comprador ou utilizador do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit:

1. O produto deverá ser utilizado unicamente em conformidade com os protocolos fornecidos com o produto e com o presente manual e recorrendo à utilização exclusiva de componentes contidos no kit. Nos termos dos direitos de propriedade intelectual, a PreAnalytiX® não concede nenhuma licença para utilizar ou incluir os componentes englobados neste kit com qualquer componente não incluído neste kit, salvo conforme descritos nos protocolos fornecidos com o produto, no presente manual e em quaisquer protocolos adicionais disponíveis em **[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)** e **[www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com)**.
2. À exceção de licenças expressamente declaradas, a PreAnalytiX não fornece qualquer garantia de que este kit e/ou a sua utilização ou utilizações não infringem os direitos de terceiros.
3. Estes consumíveis e respetivos componentes estão licenciados para uma única utilização e não podem ser reutilizados, recondicionados ou objeto de revenda.
4. A PreAnalytiX recusa especificamente qualquer outra licença, expressa ou implícita, à exceção das expressamente declaradas.
5. O comprador e o utilizador do kit concordam em não tomar nem permitir que terceiros tomem medidas que possam conduzir a ou facilitar qualquer dos atos acima proibidos. A PreAnalytiX pode fazer cumprir as proibições do presente Contrato de licença limitada em qualquer tribunal e deverá recuperar todos os custos legais e de investigação em que incorra, incluindo honorários de advogados, em qualquer processo destinado a fazer cumprir o presente Contrato de licença limitada ou qualquer um dos seus direitos de propriedade intelectual relativos ao kit e/ou aos seus componentes.

Para obter os termos de licença atualizados, visite **[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)** e **[www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com)**.

## **Distribuidores da PreAnalytiX**

Os produtos PreAnalytiX são fabricados e distribuídos pela QIAGEN e BD para a PreAnalytiX.

# Conteúdo

Conteúdo .....	3
Utilização prevista.....	5
Utilizador previsto .....	5
Descrição e princípio .....	6
Resumo e explicação .....	6
Princípios do procedimento.....	7
Materiais fornecidos.....	9
Conteúdo do kit.....	9
Materiais necessários, mas não fornecidos.....	10
Equipamento .....	10
Avisos e precauções.....	11
Informações de segurança .....	11
Precauções.....	12
Armazenamento e manuseamento de reagentes .....	14
Componentes do kit .....	14
Colheita e preparação de amostras.....	16
Procedimento .....	20
Visão geral: Purificação automatizada de ccfDNA no instrumento QIASymphony SP .....	20
Visão geral do protocolo.....	26
Protocolo: Purificação automatizada de ccfDNA no instrumento QIASymphony SP .....	29

Controlo de qualidade.....	33
Limitações .....	33
Guia de resolução de problemas .....	34
Símbolos .....	37
Anexo: Quantificação de ccfDNA .....	39
Informações para encomendas .....	40
Histórico de revisões do documento.....	42

## Utilização prevista

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit, a ser utilizado com o instrumento QIASymphony SP, foi concebido para realizar o isolamento e a purificação automatizados de ADN de circulação livre de células (circulating cell free DNA, ccfDNA) de plasma gerado a partir de sangue total venoso humano colhido no PAXgene Blood ccfDNA Tube.

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit utiliza tecnologia de partículas magnéticas para o isolamento e a purificação automatizados de ADN de circulação livre de células (circulating cell free DNA, ccfDNA) de plasma humano.

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit destina-se a ser utilizado para diagnóstico *in vitro* por utilizadores profissionais, tais como técnicos e médicos com formação em técnicas de biologia molecular.

## Utilizador previsto

Este kit destina-se a utilização profissional.

O produto deve ser utilizado apenas por pessoal com formação específica, especializado em técnicas de biologia molecular e familiarizado com esta tecnologia.

# Descrição e princípio

## Resumo e explicação

O ADN de circulação livre de células (circulating cell-free DNA, ccfDNA) está presente no plasma geralmente como fragmentos curtos (<1000 bp). A concentração de ccfDNA no plasma é geralmente baixa (de 1 a 100 ng/ml) e varia significativamente entre indivíduos. O PreAnalytiX PAXgene Blood ccfDNA Tube com a marca CE, juntamente com o QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit constituem um fluxo de trabalho padronizado para a colheita, armazenamento e transporte de sangue; estabilização de ADN num tubo fechado; subsequente isolamento de ccfDNA e purificação do plasma humano utilizando o instrumento QIAGEN® QIASymphony SP.


Os protocolos no instrumento QIASymphony SP são fornecidos para a extração de ccfDNA de 2,4 e 4,8 ml de plasma gerado a partir de PAXgene Blood ccfDNA Tubes por dupla centrifugação. O plasma é transferido e processado num tubo secundário no instrumento QIASymphony SP.

Em alternativa, os protocolos de manuseamento do tubo primário no instrumento QIASymphony SP estão disponíveis para volumes de entrada de plasma de 2,4 e 4 ml. Neste caso, não é necessário um segundo passo de centrifugação ou transferência de plasma para um tubo secundário.

A tecnologia de partículas magnéticas do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit permite a purificação de ccfDNA de alta qualidade, isento de proteínas, nucleases e outras impurezas. O instrumento QIASymphony SP executa todos os passos do procedimento de purificação. Até 96 amostras, em lotes de 24, são processadas numa única execução. Para o isolamento de ADN genómico (ADNg) da fração celular nucleada de sangue colhido nos PAXgene Blood ccfDNA Tubes no instrumento QIASymphony SP, consulte as indicações fornecidas nas Instruções de utilização do PAXgene Blood ccfDNA Tube ([www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com)).


# Princípios do procedimento

A tecnologia do instrumento QIASymphony SP combina a velocidade e a eficiência da purificação de ácidos nucleicos por troca aniônica com o prático manuseamento das partículas magnéticas (Figura 1). O procedimento de purificação destina-se a assegurar o manuseamento seguro e reproduzível de amostras potencialmente infecciosas e consiste em 3 passos: ligação, lavagem e eluição (Figura 2). Os utilizadores podem escolher entre diferentes volumes de entrada da amostra.

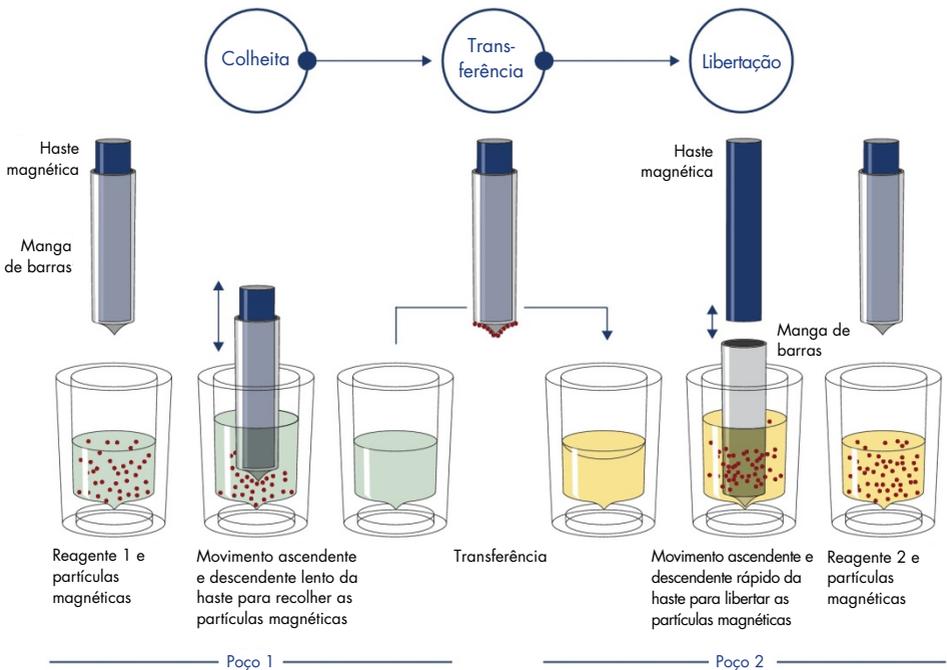

**Figura 1. Diagrama esquemático do princípio do instrumento QIASymphony SP.** O instrumento QIASymphony SP processa uma amostra que contém partículas magnéticas da seguinte forma: uma haste magnética protegida por uma manga entra num poço contendo a amostra e atrai as partículas magnéticas. A manga da haste magnética é posicionada sobre outro poço e as partículas magnéticas são libertadas. Estes passos são repetidos várias vezes durante o processamento da amostra. O instrumento QIASymphony SP utiliza uma cabeça magnética contendo uma variedade de 24 hastes magnéticas pelo que processa até 24 amostras simultaneamente.

## QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit

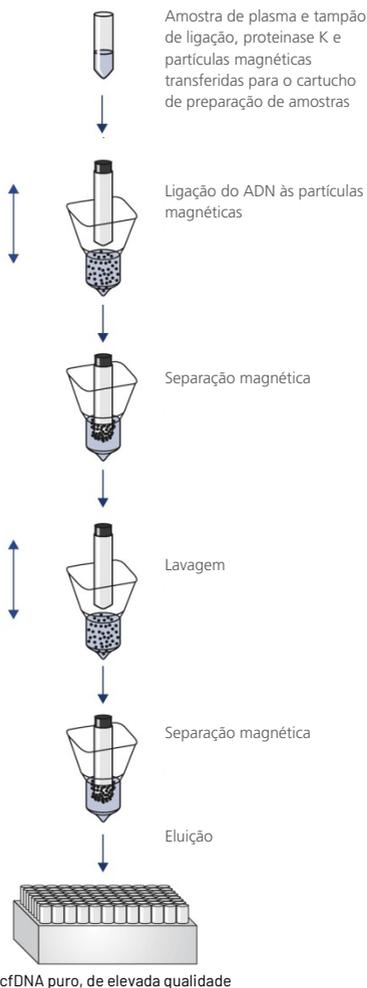

**Figura 2. Passos para a extração de ccfDNA com o QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit.** Os fragmentos de ccfDNA são isolados do plasma gerado a partir de sangue total venoso humano colhido no PAXgene Blood ccfDNA Tube. Durante o primeiro passo de processamento, as proteínas do plasma são digeridas pela Proteínase K, enquanto o ccfDNA se liga à superfície das partículas magnéticas. Três etapas de lavagem garantem a remoção dos contaminantes. Finalmente, o ccfDNA é eluído das partículas magnéticas e está pronto a utilizar em aplicações a jusante.

# Materiais fornecidos

## Conteúdo do kit

QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD) N.º de catálogo Número de reações		(192) 768566 192		
Abreviatura	Identificação	Quantidade	Ingredientes ativos	Concentração [%]**
RC	Reagent cartridge (Cartucho de reagentes)*†	2	Detergente não iónico Partícula magnética por troca aniónica NaOH  Etanol	≥0,5 – <10 [p/p] –  ≥0,05 – <0,1 [p/p] ≥70 – <90 [v/v]
PROTK	Proteinase K†	5 × 10 ml	Proteinase K	≥1 a <3 [p/p]
PL	Piercing lid (Tampa perfurável)	2	–	–
RSS	Reuse Seal Set (Conjunto de vedantes reutilizáveis)‡	2	–	–
	Caps for Elution Microtubes (Tampas para microtubos de eluição)§	2	–	–
	Tampas para microtubos de eluição#	1 × (55 × 8)	–	–
	Instruções de utilização (Manual)	1	–	–
	PAXgene Blood ccfDNA Purification Protocol Selection Tool	1	–	–

\* Contém azida de sódio como conservante.

† Consultar na página 37 uma lista de símbolos e respetivas definições.

‡ Um Reuse Seal Set contém 8 tiras vedantes reutilizáveis.

# Também disponível separadamente, consulte Informações para encomendas.

\*\* Concentração máxima num único poço.

## Materiais necessários, mas não fornecidos

Ao trabalhar com amostras químicas e biológicas, siga sempre as precauções universais e use uma bata de laboratório, luvas descartáveis e óculos de proteção adequados, de acordo com as políticas e procedimentos da sua instalação. Para mais informações, consultar as fichas de dados de segurança (FDS) adequadas, disponíveis junto do fornecedor do produto.

Certifique-se de que os equipamentos foram verificados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante.

- Sample Prep Cartridges, 8-well (QIAGEN, n.º de cat. 997002)
- 8-Rod Covers (QIAGEN, n.º de cat. 997004)
- Filter-Tips, 200 µl e 1500 µl (QIAGEN, n.º de cat. 990332 e 997024, respetivamente)
- Tip Disposal Bags (QIAGEN, n.º de cat. 9013395)
- PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD) (PreAnalytiX, n.º de cat. 768165)
- Tubos de amostras. Para formatos de tubos primários e secundários compatíveis, consulte a lista de material de laboratório, que pode ser encontrada nos separadores Product Resources (Recursos do produto) e Resources (Recursos) das páginas do produto em **www.qiagen.com** e **www.PreAnalytiX.com**, respetivamente.
- Para formatos de tubos de eluição compatíveis, consulte a lista de material de laboratório, que pode encontrar nos separadores Product Resources (Recursos do Produto) e Resources (Recursos) das páginas do produto em **www.qiagen.com** e **www.PreAnalytiX.com**, respetivamente.

## Equipamento\*

- Pipeta (5 ml)
- Instrumento QIASymphony SP (QIAGEN, n.º de cat. 9001297)

\* Antes de utilizar, certifique-se de que os instrumentos foram verificados e calibrados de acordo com as recomendações do fabricante.

# Avisos e precauções

Para utilização em diagnóstico in vitro.

Ler atentamente todas as instruções antes de utilizar o kit.

Para os clientes na União Europeia, tenha em atenção que poderá ser necessário comunicar incidentes graves, que tenham ocorrido em relação ao dispositivo, ao fabricante e à autoridade reguladora do estado-membro onde o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

## Informações de segurança

Ao trabalhar com amostras químicas e biológicas, siga sempre as precauções universais e use uma bata de laboratório, luvas descartáveis e óculos de proteção adequados, de acordo com as políticas e procedimentos da sua instalação. Para obter mais informações, consulte as fichas de dados de segurança (FDS) adequadas. Estas estão disponíveis online no formato PDF, em [www.qiagen.com/safety](http://www.qiagen.com/safety), onde é possível encontrar, visualizar e imprimir as FDS de cada kit PreAnalytiX e respetivos componentes.

- Todos os produtos químicos e materiais biológicos são potencialmente perigosos. Os espécimes e as amostras de sangue são potencialmente infecciosos e devem ser tratados como materiais de risco biológico.
- Elimine os materiais biológicos perigosos e os resíduos dos kits de acordo com os procedimentos de segurança locais.

## Informações para casos de emergência

CHEMTREC

EUA e Canadá 1-800-424-9300

Fora dos EUA e Canadá +1 703-527-3887

## Precauções

Os tampões no cartucho de reagentes (reagent cartridge, RC) contêm azida de sódio. Em caso de derramamento dos tampões do kit, limpar com detergentes apropriados para utilização em laboratório e água. Se o líquido derramado contiver agentes potencialmente infecciosos, limpar primeiro a área afetada com detergente apropriado para utilização em laboratório e água e, em seguida, com 1% (v/v) de solução de hipoclorito de sódio (lixívia).

As frases que se seguem, de perigo e precaução, aplicam-se aos componentes do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit.

### MBS3

Contém: Azida de sódio. Aviso! Pode ser prejudicial se ingerido. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

### Proteinase K



Contém: Proteinase K. Perigo! Provoca uma ligeira irritação da pele. Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias. Evitar respirar poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. Usar proteção respiratória. Em caso de exposição ou suspeita de exposição: Contactar um centro de informação antivenenos ou um médico. Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

## QSE2



Contém: Hidróxido de sódio. Perigo! Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Eliminar o conteúdo/recipiente em instalação de eliminação de resíduos aprovada. **Se entrar em contacto com os olhos:** enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. **Se entrar em contacto com a pele (ou o cabelo):** Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Contactar imediatamente um centro de informação antivenenos ou um médico. Armazenar num local fechado à chave. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

## QSW9



Contém: Etanol. Perigo! Líquido e vapor altamente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado de calor/faíscas/chamas a descoberto/superfícies quentes. Não fumar. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

# Armazenamento e manuseamento de reagentes

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit deve ser armazenado na vertical à temperatura ambiente (15–25 °C). As partículas magnéticas nos cartuchos de reagentes (reagent cartridge, RC) mantêm-se ativas quando armazenadas neste intervalo de temperatura.

**Nota:** O rótulo na caixa do QIASymphony PAXgene ccfDNA Kit apresenta a data de validade do mesmo. O prazo de validade é para o cartucho de reagentes.

Não utilizar o QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit após o prazo de validade.

## Componentes do kit

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit contém solução Proteinase K pronta a utilizar que pode ser armazenada à temperatura ambiente (15–25 °C).

Não armazenar os RC a temperaturas inferiores a 15 °C.

Os RC do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA abertos podem ser armazenados à temperatura ambiente (15–25 °C) durante até 4 semanas, o que permite uma reutilização eficaz em termos de custo dos reagentes e um processamento de amostras mais flexível, se forem selados corretamente após a utilização. Se um RC for apenas parcialmente utilizado, recolocar a cobertura da cavidade contendo as partículas magnéticas e vedar o RC com as tiras vedantes reutilizáveis imediatamente após a execução do protocolo terminar, para evitar a evaporação.

Para evitar a evaporação do reagente, o RC deve permanecer aberto 15 horas, no máximo (incluindo o tempo de execução) à temperatura ambiente máxima de 32 °C. O armazenamento incorreto dos componentes do kit pode levar ao envelhecimento prematuro dos tampões.

A execução de lotes com um número reduzido de amostras (<24) irá aumentar o tempo de abertura do RC e os volumes de tampão necessários, reduzindo potencialmente o número total de preparações de amostras possíveis por cartucho.

Evitar a exposição dos RC a luz UV (por exemplo, utilizada para a descontaminação), uma vez que a exposição pode acelerar o envelhecimento dos RC e dos tampões.

Devem ser observados os prazos de validade e as condições de armazenamento impressos na caixa e nos rótulos de todos os componentes. Não utilize componentes fora do prazo de validade ou armazenados de forma incorreta.

# Colheita e preparação de amostras

O procedimento de purificação é otimizado para utilização com plasma gerado a partir de sangue colhido nos PAXgene Blood ccfDNA Tubes. Para obter informações sobre a colheita de sangue, o manuseamento desses tubos e a preparação do plasma, consulte as Instruções de utilização do PAXgene Blood ccfDNA Tube que podem ser encontradas nos separadores Product Resources (Recursos do produto) e Resources (Recursos) das páginas do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) e [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente.

A preparação do plasma pode ser efetuada utilizando (A) o protocolo padrão de dupla centrifugação ou (B) através do manuseamento do tubo primário: processamento direto dos PAXgene Blood ccfDNA Tubes submetidos uma vez a centrifugação no instrumento QIASymphony SP.

## A) Preparação do plasma a partir de sangue para protocolos padrão

1. Centrifugue o PAXgene Blood ccfDNA Tube à temperatura ambiente (15–25 °C) durante 15 minutos a 1600–3000 × g (primeira centrifugação) utilizando uma centrífuga de cabeça oscilante equilibrada. Se for preferível a travagem, recomenda-se a utilização de um nível médio de travagem e este deve ser validado para o seu fluxo de trabalho específico.

**Nota:** Para um melhor desempenho com amostras refrigeradas antes da centrifugação, volte a misturar a amostra invertendo-a três vezes e deixe que os tubos se aclimatizem à temperatura ambiente antes de os processar.

2. Pipete o plasma para um tubo de centrifuga com base cónica de 15 ml (não fornecido), certificando-se de que não interfere com a fração celular nucleada.
3. Centrifugue o tubo de centrifuga com base cónica de 15 ml à temperatura ambiente (15–25 °C) durante 10 minutos a 1600–3000 × g (segunda centrifugação) utilizando uma centrífuga equilibrada.

**Nota:** Não exceda a velocidade de centrifugação máxima recomendada pelo fabricante do tubo secundário.

4. Pipete o volume de plasma necessário (consulte a secção "Volume de amostra" na página 20) para um tubo com base redonda de 14 ml, 17 × 100 mm, em polistireno, certificando-se de que não interfere com o pellet de células sanguíneas residual, se presente.
5. Transfira o tubo com base redonda com a amostra de plasma para o transportador de tubos e coloque o transportador de tubos na gaveta de entrada da amostra do instrumento QIASymphony SP.

**Nota:** Para um rendimento máximo do ADN de circulação livre de células (circulating cell free DNA, ccfDNA), processe o volume máximo de plasma disponível.

**Nota:** Previna a formação de espuma nas amostras de plasma ou sobre as mesmas durante a pipetagem. Espuma ou bolhas de ar em amostras podem levar à pipetagem do volume de amostra errado.

**Nota:** Depois da transferência do plasma no tubo secundário, o ccfDNA permanece estável no plasma a 15–25 °C durante até 3 dias ou a 2–8 °C durante até 7 dias. Para armazenamento mais prolongado, recomendamos que as alíquotas sejam congeladas a –20 °C ou –80 °C.

**Nota:** Quando forem utilizadas amostras de plasma previamente armazenadas (por exemplo, armazenadas a 2–8 °C ou congeladas a –20 °C ou –80 °C), estas devem ser aclimatizadas à temperatura ambiente (15–25 °C) antes de iniciar a execução; para amostras congeladas, consulte a secção "C) Congelamento e descongelamento de amostras de plasma processadas do PAXgene Blood ccfDNA Tube".

## B) Preparação do plasma a partir de sangue para manuseamento do tubo primário no instrumento QIASymphony SP

1. Centrifugue o PAXgene Blood ccfDNA Tube à temperatura ambiente (15–25 °C) durante 15 minutos a 3000 x g utilizando uma centrífuga de cabeça oscilante equilibrada. Se for preferível a travagem, recomenda-se a utilização de um nível médio de travagem e este deve ser validado para o seu fluxo de trabalho específico.

**Nota:** Para um melhor desempenho com amostras refrigeradas antes da centrifugação, volte a misturar a amostra invertendo-a três vezes e deixe que os tubos se aclimatizem à temperatura ambiente antes de os processar.

2. Quantifique o volume de plasma em cada tubo após a remoção da cabeça da centrífuga, utilizando a PAXgene Blood ccfDNA Purification Protocol Selection Tool fornecida como conteúdo de kit (Figura 3). Após a remoção do tubo da centrífuga, a seta verde-azulada na ferramenta é alinhada com a interface plasma/células. As linhas azuis indicam se o nível de plasma é suficiente para o protocolo de manuseamento do tubo primário de 2,4 ou 4,0 ml. É necessária uma altura mínima de 2,3 cm da coluna de plasma para o protocolo de 2,4 ml e um mínimo de 3,4 cm para o protocolo de 4,0 ml.

**Nota:** Caso não tenha ocorrido uma clara separação do plasma e da fração celular ou caso as fases tenham sido acidentalmente misturadas após a remoção da centrífuga, a centrifugação deve ser repetida.

**Nota:** Verifique uma separação clara antes de colocar o tubo no instrumento.

3. Remova a Hemogard Closure Cap dos PAXgene Blood ccfDNA Tubes antes da colocação no instrumento QIASymphony SP para extração direta do ADN de circulação livre de células (ccfDNA).

**Nota:** A remoção da tampa do tubo e o manuseamento de tubos abertos devem ser realizados com cuidado para reduzir o risco potencial de derrame de amostra, contaminação cruzada entre tubos e exposição do sangue.

4. Coloque os PAXgene Blood ccfDNA Tubes abertos contendo plasma suficiente no transportador de tubos e coloque o transportador de tubos na gaveta de entrada da amostra do instrumento QIASymphony SP.

**C) Congelamento e descongelamento de amostras de plasma processadas do PAXgene Blood ccfDNA Tube**

1. Para o congelamento, transfira o plasma para tubos adequados (por exemplo, criotubos) colocados num suporte adequado.
2. Congele e armazene o plasma a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Para um armazenamento inferior a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , congele primeiro as amostras de plasma a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  durante pelo menos 24 horas e, de seguida, transfira-as para  $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
3. Descongele o plasma à temperatura ambiente ( $15\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

**Nota:** Não descongele a temperaturas baixas (por exemplo,  $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).

4. Em caso de formação de crioprecipitados no plasma, agite o tubo no vórtex durante 30 segundos após o descongelamento e utilize a amostra para o procedimento de isolamento do ccfDNA no instrumento QIASymphony SP sem qualquer tratamento adicional.

**Nota:** Não é recomendável centrifugar o plasma para remover crioprecipitados, uma vez que podem conter ccfDNA.

**Nota:** Para evitar a formação de crioprecipitados, o plasma pode ser descongelado a  $30\text{ }^{\circ}\text{C}$  durante 30 minutos, em vez de à temperatura ambiente.

# Procedimento

## Visão geral: Purificação automatizada de ccfDNA no instrumento QIASymphony SP

O instrumento QIASymphony SP torna fácil e prática a preparação automatizada de amostras. As amostras, os reagentes e os consumíveis, e os eluatos são separados em gavetas diferentes. Carregar simplesmente as amostras, os reagentes fornecidos em cartuchos especiais, e consumíveis previamente colocados em suportes na devida gaveta antes de iniciar uma execução. Iniciar o protocolo e remover o ccfDNA purificado da gaveta "Eluate"(Eluato) após o processamento. Consultar os manuais de utilizador que acompanham o instrumento para obter instruções de utilização.

**Nota:** A manutenção opcional não é obrigatória para o funcionamento do instrumento, mas é altamente recomendada para reduzir o risco de contaminação.

### Volume de amostra

Para garantir que no fluxo de trabalho habitual são transferidas amostras de 2,4 ml (protocolo PAXcircDNA\_2400) e de 4,8 ml (protocolo PAXcircDNA\_4800) pelo instrumento, é necessário um volume morto de 0,4 e 0,5 ml respetivamente, o que significa que devem ser fornecidos no mínimo 2,8 e 5,3 ml de entrada de amostra. Se o volume de plasma disponível for inferior a 2,8 ou 5,3 ml, o **modo Less Sample** (Menos amostra) como função integrada do protocolo permite automaticamente a transferência de volumes de plasma inferiores aos listados. Neste caso, o instrumento transfere menos amostra. A diferença do volume de plasma pipetado será registado no ficheiro de resultados. Além disso, as respetivas amostras são sinalizadas como **ambíguas** (código de erro 140043, **modo Enable Less Sample** [Permitir menos amostra]). Os volumes de entrada de plasma mínimos para ativar o **modo Less Sample** (Menos amostra) são 1,6 e 4,1ml. Se for fornecido um volume inferior de amostra, as amostras não serão processadas e serão sinalizadas como **inválidas**.

Para o fluxo de trabalho de manuseamento do tubo primário, é assegurado o volume de amostra adequado utilizando a PAXgene Blood ccfDNA Purification Protocol Selection Tool fornecida como conteúdo de um kit (descrita em "Preparação do material de amostra" na página 25).

### **Carregar os RC na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis)**

Os reagentes para a purificação de ccfDNA estão contidos num cartucho de reagentes (reagent cartridge, RC) inovador (Figura 3). Cada cavidade RC contém um reagente específico, como por exemplo partículas magnéticas, tampão de ligação, tampão de lavagem ou tampão de eluição. Os RC parcialmente utilizados podem voltar a ser fechados com tiras vedantes reutilizáveis para reutilização posterior, evitando a geração de resíduos devido a sobras de reagentes no fim do procedimento de purificação.



**Figura 3.** Cartucho de reagente QIASymphony (RC). O RC contém todos os reagentes necessários para a execução do protocolo.

Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que as partículas magnéticas estão completamente ressuspensas. Remova a cavidade das partículas magnéticas da estrutura do RC, agite-a vigorosamente no vórtex durante, pelo menos, 3 minutos, e coloque-a novamente na estrutura do RC, antes da primeira utilização.

**Nota:** As partículas magnéticas podem mudar de cor. Essa mudança não tem qualquer influência no desempenho.

Coloque o RC no suporte de RC. Antes de utilizar um RC pela primeira vez, coloque a tampa perfurável em cima do RC (Figura 3).

**Nota:** A tampa de perfuração é afiada. Tenha cuidado ao colocá-la no RC. Certifique-se de que a tampa perfurável é colocada sobre o RC na orientação correta.

Após a remoção da cobertura da cavidade das partículas magnéticas, o RC é subsequentemente carregado na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis).

Os RC parcialmente utilizados podem ser armazenados até voltarem a ser necessários (consulte "Armazenamento e manuseamento de reagentes" na página 14).

**Nota:** É necessário adicionar Proteinase K (consulte "Passos a seguir antes de iniciar o procedimento" na página 27).

**Nota:** Certifique-se de que os RC, cavidades das partículas magnéticas e frascos de Proteinase K não são trocados entre diferentes lotes de kits.

## **Carregar material de plástico na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis)**

Os cartuchos de preparação de amostras, as 8-Rod Covers (ambas pré-embaladas em caixas de unidades) e as pontas com filtros descartáveis (pontas de 200 µl fornecidas em suportes azuis, pontas de 1500 µl fornecidas em suportes pretos) são carregados na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis).

**Nota:** Certifique-se de que as coberturas das caixas de unidades são removidas antes de carregar as caixas na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis).

**Nota:** As pontas têm filtros para prevenir contaminação cruzada.

As ranhuras do suporte de pontas na mesa de trabalho do instrumento QIASymphony SP podem ser preenchidas com qualquer tipo de suporte de pontas. O instrumento QIASymphony SP identificará o tipo de pontas carregadas durante a inventariação.

**Nota:** Não reechar os suportes de pontas ou caixas de unidades para cartuchos de preparação de amostras ou 8-Rod Covers antes de dar início a outra execução do protocolo. O instrumento QIASymphony SP pode utilizar suportes de pontas e caixas de unidades parcialmente usadas.

Para informações de encomenda para material de plástico, consultar a página 40.

## Carregar a gaveta "Waste" (Resíduos)

Os cartuchos de preparação de amostras e 8-Rod Covers utilizados durante a execução são recolocados no suporte em caixas de unidades vazias na gaveta "Waste" (Resíduos). Certifique-se de que a gaveta "Waste" (Resíduos) contém caixas de unidades vazias suficientes para os resíduos plásticos gerados durante a execução do protocolo.

**Nota:** Assegurar que as coberturas das caixas de unidades são removidas antes de carregar as caixas de unidades na bandeja "Waste". Se estiverem a ser utilizadas caixas de 8-Rod Cover para recolher os cartuchos de preparação de amostras e as 8-Rod Covers usados, assegurar que o espaçador da caixa foi removido.

Deve fixar-se à parte frontal da gaveta "Waste" (Resíduos) um saco para pontas com filtros usadas.

**Nota:** A presença de um saco para eliminação de pontas não é verificada pelo sistema. Certifique-se de que o saco de eliminação de pontas está devidamente fixado, antes de dar início à execução do protocolo. Para mais informações, consultar os manuais do utilizador que acompanham o instrumento. Esvazie o saco de pontas após o processamento de um máximo de 96 amostras para evitar o encravamento de uma ponta.

Um recipiente de resíduos recolhe os resíduos líquidos gerados durante o procedimento de purificação. A gaveta "Waste" (Resíduos) apenas pode ser fechada se o recipiente de resíduos estiver devidamente posicionado. Eliminar os resíduos líquidos, de acordo com os regulamentos ambientais e de segurança locais. Não autoclave o frasco de resíduos cheio. Esvazie o frasco de resíduos após o processamento de um máximo de 96 amostras.

## Carregar a gaveta "Eluate" (Eluato)

Colocar o suporte de eluição necessário na gaveta "Eluate" (Eluato). Uma vez que o armazenamento a longo prazo dos eluatos na gaveta "Eluate" (Eluato) pode conduzir à evaporação ou condensação, deve ser utilizada a posição de arrefecimento. Utilizar a "Elution slot 1" (Ranhura de eluição 1) apenas com o adaptador de arrefecimento correspondente.

Volume de eluição selecionado ( $\mu$ l)*	Volume de eluição inicial ( $\mu$ l) <sup>†</sup>
60	75

\* Este é o volume acessível mínimo de eluato no tubo de eluição final para QIAGEN EMT rack (n.º de cat. 19588) e 1,5 ml Sarstedt screw cap tubes (n.º de cat. no 72.607). Em casos específicos, o volume de eluato final para amostras individuais pode ter até menos 5  $\mu$ l.

<sup>†</sup> O volume inicial de tampão de eluição necessário para assegurar que o volume real de eluato é igual ao volume selecionado.

## Inventariação

Antes de iniciar uma execução, o instrumento verifica se foram carregados nas respetivas gavetas consumíveis suficientes para o(s) lote(s) em espera.

## Preparação do material de amostra

Consulte "Colheita e preparação de amostras", na página 16.

## Armazenamento de ccfDNA

Após a preparação da amostra, os eluatos de ccfDNA podem ser armazenados a -20 ou -80 °C. Os eluatos congelados não devem ser descongelados mais de três vezes. Para obter as informações mais recentes sobre a estabilidade de ccfDNA em eluatos, consulte a página do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ou [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com).

## Visão geral do protocolo

Tabela 1. Visão geral do protocolo

Amostra	Processamento do PAXgene Blood ccfDNA Tube	Volume de entrada da amostra (incluindo volume morto) (ml)	Volume de amostra utilizado para extração de ADN de circulação livre de células (circulating cell free DNA, ccfDNA) (ml)	Volume de eluição (µl)	Protocolo do instrumento QIASymphony SP
Plasma gerado a partir de sangue total venoso humano colhido em PAXgene Blood ccfDNA Tubes	2× centrifugação, transferência de plasma para um tubo secundário	2,8	2,4	60	PAXcircDNA_2400
		5,3	4,8	60	PAXcircDNA_4800
	1 centrifugação, processamento direto no instrumento QIASymphony SP	De acordo com a ferramenta de seleção	2,4	60	PAXcircDNA PrimaryTube_2400
			4,0	60	PAXcircDNA PrimaryTube_4000

### Pontos importantes antes de começar

- Ao trabalhar com amostras químicas e biológicas, use sempre uma bata de laboratório adequada, luvas descartáveis e óculos de proteção. Para obter mais informações, consulte as FDS adequadas.
- Certifique-se de que está familiarizado com o funcionamento do instrumento QIASymphony SP. Consultar os manuais de utilizador que acompanham o instrumento para obter instruções de utilização.

**Nota:** A configuração de software necessária para utilização em IVD é **Default Profile 1** (Perfil predefinido 1).

- Antes do início do procedimento, leia a secção "Princípios do procedimento".

- Certifique-se de que está familiarizado com a folha de protocolo e a lista de material de laboratório (podem ser encontradas nos separadores Product Resources [Recursos do produto] e Resources [Recursos] das páginas do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) and [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente).
- Evite a agitação vigorosa do RC, caso contrário poderá formar-se espuma que pode conduzir a problemas de deteção do nível líquido.
- O sangue deve ser colhido em PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD; PreAnalytiX, n.º de cat. 768165). Para obter instruções sobre a colheita sanguínea e o manuseamento e processamento de plasma, consulte as Instruções de utilização, disponíveis nos separadores **Product Resources** (Recursos do produto) e Resources (Recursos) da página do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ou [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente.

## Passos a seguir antes de iniciar o procedimento

- Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que as partículas magnéticas estão completamente ressuspensas. Agite vigorosamente no vórtex a cavidade contendo as partículas magnéticas, durante, pelo menos, 3 minutos antes da primeira utilização.
- Certifique-se de que a tampa perfurável é colocada no RC e a cobertura da cavidade das partículas magnéticas foi removida. Se for utilizado um RC parcialmente usado, certifique-se de que a tira vedante reutilizável foi removida.
- A Proteinase K não está incluída no RC, mas deve ser fornecida pelo utilizador (gaveta Sample (Amostra), ranhura A, posição 1 e/ou 2). Certifique-se de que está disponível o volume correto de Proteinase K.

O QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit contém uma solução de Proteinase K pronta a utilizar. A Proteinase K pode ser conservada à temperatura ambiente (15–25 °C). Para armazenamento por um período de tempo prolongado, sugerimos manter os frascos de enzimas com Proteinase K a 2–8 °C.

Número de amostra	PAXcircDNA_2400/PAXcircDNA PrimaryTube_2400* (µl)	PAXcircDNA_4800/PAXcircDNA PrimaryTube_4000* (µl)
8	1980	2860
24	3740	6380
48	6380	11660 <sup>†</sup>
96	11660 <sup>†</sup>	23320 <sup>†</sup>

\* Para cada amostra, são necessários 110 µl (para 2400 µl de plasma) ou 220 µl (para 4800/4000 µl de plasma), mais um volume morto adicional de 1100 µl [(n × 110 ou 220 µl) + 1100 µl].

† Se forem necessários mais do que 11660 µl, utilize um segundo tubo (Corning, n.º de cat. 352051). Para o segundo tubo, é necessário utilizar um volume morto adicional de 1100 µl.

**Nota:** Os tubos que contêm Proteinase K são colocados num transportador de tubos. O transportador de tubos que contém Proteinase K deve ser colocado nas posições 1 e 2 na ranhura A da gaveta "Sample" (Amostra). Recomendamos a utilização de tubos com base redonda de 14 ml, 17 × 100 mm em polistireno (Corning, n.º de cat. 352051) para Proteinase K.

- Caso as amostras tenham códigos de barras, oriente as amostras no transportador de tubos para que os códigos de barras fiquem virados para o leitor de códigos de barras, no lado esquerdo do instrumento QIASymphony SP.
- Para obter mais informações sobre os tubos de amostras e os volumes mínimos de amostra compatíveis com os protocolos, consulte a respetiva lista de material de laboratório, disponível nos recursos separadores Product Resource (Recursos do produto) e Resources (Recursos) das páginas do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) and [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente.

## Protocolo: Purificação automatizada de ccfDNA no instrumento QIASymphony SP

São fornecidas informações detalhadas para cada protocolo, incluindo volumes e tubos, na folha de protocolo e na lista de material de laboratório que podem ser encontradas nos separadores Product Resources (Recursos do produto) e Resources (Recursos) da página do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) and [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente. Para a preparação do material de amostra (plasma gerado a partir de sangue total venoso humano colhido no PAXgene Blood ccfDNA Tube), consulte as secções "Colheita e preparação de amostras" e "Preparação do material de amostra" deste manual, bem como as Instruções de utilização que podem ser encontradas no separador **Product Resources** (Recursos do produto) da página do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) or [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente.

1. Feche todas as gavetas e coberturas.
2. Ligue o instrumento QIASymphony SP e aguarde até que o ecrã Sample Preparation (Preparação da amostra) apareça e o procedimento de inicialização seja concluído.
3. O interruptor de alimentação está localizado no canto inferior esquerdo do instrumento QIASymphony SP.
4. Iniciar sessão no instrumento.

Colocar o suporte de eluição necessário na gaveta "Eluate" (Eluato).

Não colocar uma placa de 96 poços na "Elution slot 4" (Ranhura de eluição 4).

Utilize a "Elution slot 1" (Ranhura de eluição 1) com o adaptador de arrefecimento correspondente.

Quando é utilizada a placa de 96 poços, assegure que a mesma está na orientação correta, uma vez que a colocação incorreta pode causar a mistura de análises a jusante.

Ao utilizar o suporte de Elution Microtubes CL, retire a parte de baixo rodando o suporte até que se solte.

5. Certifique-se de que a gaveta "Waste" (Resíduos) está devidamente preparada e realize uma inventariação da gaveta "Waste" (Resíduos), incluindo o coletor de pontas, a estação de armazenamento de pontas, o recipiente de resíduos líquidos vazio e as caixas de unidades vazias. Substitua o saco de eliminação de pontas, se necessário.
6. Carregue os RC e os consumíveis necessários na gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis).
7. Efetue uma inventariação da gaveta "Reagents and Consumables" (Reagentes e consumíveis).
8. Coloque as amostras no transportador de amostras apropriado e coloque-os dentro da gaveta "Sample" (Amostra).

**Nota:** Para além do processamento habitual, incluindo a transferência do plasma para um tubo secundário adequado (tubo Falcon® com base redonda de 14 ml, 17 x 100 mm, em polistireno) colocado no transportador de amostras adequado, o fluxo de trabalho de manuseamento do tubo primário do PAXgene Blood ccfDNA Tube permite a extração de ccfDNA diretamente do PAXgene Blood ccfDNA Tube (PAXgene Blood ccfDNA Tube de 10 ml, 16 x 100 mm). Para obter mais informações sobre o manuseamento do tubo primário, consulte a folha de protocolo, a lista de material de laboratório e as Instruções de utilização do tubo que podem ser encontradas nos separadores Product Resources (Recursos do produto) e Resources (Recursos) da página do produto em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ou [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com), respetivamente.

9. Utilizando o ecrã tátil, introduza as informações necessárias para cada lote de amostras e Proteinase K a ser processado.

Introduza as seguintes informações:

- Informações da amostra (dependendo dos suportes de amostras utilizados, seleccione BD #352051 FalconPP 17 x 100 ou BD\_#768165 PAXgene ccfDNA 16 x 100)
- Protocolo a executar (Conjunto de controlos do ensaio)
- Volume de eluição e posição de saída

Após a introdução das informações sobre o lote, o estado é alterado de LOADED (Carregado) para QUEUED (Em fila de espera). Assim que o lote é colocado em fila, o botão Run (Executar) aparece.

10. Coloque a Proteinase K no transportador de amostras adequado, nas posições 1 e 2, e coloque-os na ranhura A da gaveta "Sample" (Amostra).
11. Defina a Proteinase K premindo o botão **IC** (Cl).
12. Prima o botão Run (Executar) para iniciar o procedimento de purificação. Todos os passos de processamento são totalmente automatizados. No final da execução do protocolo, o estado do lote muda de RUNNING (Em execução) para COMPLETED (Concluído).
13. Recupere o suporte de eluição contendo o ccfDNA purificado da gaveta "Eluate" (Eluato). Confirme a remoção do suporte de eluição com o software do instrumento QIASymphony SP.
14. O ccfDNA está pronto a utilizar ou pode ser armazenado a  $-20^{\circ}\text{C}$  ou  $-80^{\circ}\text{C}$  até 6 meses. A QIAGEN recomenda a remoção imediata da placa de eluição da gaveta "Eluate" (Eluato) após a conclusão da execução. Dependendo da temperatura e da humidade, as placas de eluição deixadas no instrumento QIASymphony SP após a conclusão da execução podem experimentar condensação ou evaporação.

**Nota:** Utilizando a função de arrefecimento do instrumento QIASymphony SP, são possíveis execuções durante a noite.

Geralmente, as partículas magnéticas não passam para os eluatos. Em caso de transferência, as partículas magnéticas no eluato não irão afetar a maioria das aplicações a jusante.

Se for necessário remover as partículas magnéticas antes de realizar aplicações a jusante, os tubos ou placas que contêm eluato devem primeiro ser colocados num ímã adequado e o eluato transferido para um tubo limpo (consulte "Anexo: Quantificação de ccfDNA"). São gerados ficheiros de resultados para cada placa de eluição.

15. Se um RC foi apenas parcialmente usado, sele-o com as tiras vedantes reutilizáveis após a execução do protocolo, para evitar a evaporação.

**Nota:** Para obter mais informações sobre o armazenamento de RC parcialmente usados, consulte "Armazenamento e manuseamento de reagentes".

16. Elimine os tubos de amostras usados e os resíduos de acordo com os regulamentos de segurança locais. Consulte "Avisos e precauções", para obter informações de segurança.

17. Limpe o instrumento QIASymphony SP.

Siga as instruções de manutenção nos manuais de utilizador fornecidos com o instrumento. É necessário certificar-se de que limpa regularmente as proteções das pontas para minimizar o risco de contaminação cruzada.

18. Feche as gavetas do instrumento e desligue o instrumento QIASymphony SP.

# Controlo de qualidade

De acordo com o Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela norma ISO da QIAGEN, todos os lotes do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit são testados face a especificações predeterminadas para garantir uma qualidade constante do produto.

## Limitações

Foi estabelecido o desempenho do sistema em estudos de avaliação do desempenho na purificação de ccfDNA de plasma gerado a partir de sangue total venoso humano colhido no PAXgene Blood ccfDNA Tube.

As características de desempenho do QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit foram estabelecidas com fragmentos de ccfDNA ribossomais 18S e cromossómicos Y DYS14 no plasma.

O utilizador é responsável por verificar o desempenho do sistema para quaisquer procedimentos utilizados no laboratório que não estejam abrangidos pelos estudos de avaliação de desempenho da QIAGEN e da PreAnalytiX.

Para minimizar o risco de um impacto negativo nos resultados de diagnóstico, devem ser utilizados controlos adequados para aplicações a jusante. Quaisquer resultados de diagnóstico gerados têm de ser interpretados juntamente com outros resultados clínicos ou laboratoriais.

# Guia de resolução de problemas

Este guia de resolução de problemas pode ser útil para resolver problemas que possam surgir. Para informações de contacto e uma lista das perguntas frequentes, visite a respetiva página do produto em [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com) ou [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Comentários e sugestões	
<b>Manuseamento geral</b>	
a) Mensagem de erro visualizada no ecrã tátil	Se for visualizada uma mensagem de erro durante um protocolo, consulte os manuais do utilizador fornecidos com os instrumentos.
b) Volume de eluato variável após execuções durante a noite	Para otimizar o rendimento, o QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit suporta o processamento de amostras durante a noite, arrefecendo eluatos no instrumento QIASymphony SP. Durante longos períodos de arrefecimento, os volumes de eluato podem alterar-se consoante a temperatura e humidade no laboratório. Por exemplo, se o volume escolhido foi de 60 µl a 15-25 °C e 30-60% de humidade, o volume pode estar entre 50 e 85 µl após um período de armazenamento de 12 horas no instrumento.
<b>Crioprecipitados após o descongelamento de amostras de plasma</b>	
a) Formação de crioprecipitados no plasma	Para evitar a formação de crioprecipitados, o plasma pode ser descongelado a 30 °C durante 30 minutos, em vez de à temperatura ambiente. Não descongele a temperaturas baixas (por exemplo, 4 °C). Agite no vórtex durante 30 segundos depois do descongelamento
b) Rendimento baixo de ccfDNA do plasma após a remoção dos crioprecipitados	Não centrifugue o plasma para remover crioprecipitados, uma vez que pode conter ccfDNA.
<b>Volume de plasma insuficiente dos PAXgene Blood ccfDNA Tubes</b>	
a) Menos de 10 ml de sangue colhidos no PAXgene Blood ccfDNA Tube	Certifique-se de que são colhidos 10 ml de sangue no PAXgene Blood ccfDNA Tube. Consulte as Instruções de utilização do PAXgene Blood ccfDNA Tube.
b) Alta fração celular	Um nível alto de fração celular (hematócrito) no sangue total humano (por exemplo, superior a 51% para indivíduos do sexo masculino ou 47% para indivíduos do sexo feminino) pode levar a volumes de plasma diminuídos.
c) Baixo rendimento de plasma após a centrifugação	Um armazenamento de sangue e durações de transporte prolongados ou condições de centrifugação diferentes das especificadas podem ter um impacto nos rendimentos do plasma.

Comentários e sugestões	
<b>Precipitado na cavidade do cartucho de reagentes (reagent cartridge, RC) aberto no QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit</b>	
a) Evaporação do tampão	A evaporação excessiva pode conduzir ao aumento da concentração salina em tampões. Elimine o RC. Certifique-se de que as cavidades do tampão de um RC parcialmente usado são seladas com tiras vedantes reutilizáveis quando este não estiver a ser utilizado para purificação.
b) Armazenamento do RC	O armazenamento do RC a temperaturas inferiores a 15 °C pode conduzir à formação de precipitados.
<b>Baixo rendimento de ccfDNA</b>	
a) As partículas magnéticas não foram completamente ressuspensas	Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que as partículas magnéticas estão completamente ressuspensas. Agite no vórtex, durante pelo menos 3 min antes de usar. Uma ressuspensão incompleta pode conduzir a erros de pipetagem.
b) Clogging of pipette tip due to insoluble material (Entupimento da ponta da pipeta devido a material insolúvel)	O material insolúvel não foi removido da amostra antes de iniciar o procedimento de purificação no instrumento QIASymphony SP.
c) O material de amostra contém uma concentração baixa de ccfDNA	Devido às quantidades muito baixas de ccfDNA em amostras de plasma, a medição da concentração de ccfDNA pode ser um desafio, dependendo do método de quantificação utilizado. Recomenda-se a utilização de qPCR sensível para verificar a concentração de ccfDNA em eluatos.
d) Selagem incompleta do RC	A troca com ar circulante pode provocar uma estabilidade reduzida dos tampões, diminuindo a eficiência da extração de ccfDNA com um RC parcialmente usado. Certifique-se de que as cavidades do tampão de um RC parcialmente usado são cuidadosamente seladas com tiras vedantes reutilizáveis quando este não estiver a ser utilizado para purificação.
<b>Baixo desempenho de ccfDNA em aplicações a jusante</b>	
a) Eluato concentrado por centrifugação a vácuo	Não concentre o eluato por centrifugação a vácuo (por exemplo, num SpeedVac® ou instrumento semelhante). Tal pode causar a degradação devido a temperaturas altas e sais concentrados no eluato e interferir possivelmente com aplicações a jusante.
b) Transferência de esferas	Geralmente, as partículas magnéticas não passam para os eluatos. Em caso de transferência, as partículas magnéticas no eluato não irão afetar a maioria das aplicações a jusante. Caso sejam necessárias porções muito elevadas de eluatos para ensaios específicos a jusante, os eluatos podem ser centrifugados e transferidos para um tubo limpo.

## Comentários e sugestões

### Nenhuma transferência de amostras ou transferência incompleta

a)	Foi carregado um volume de amostra incorreto para protocolos padrão	Se for carregado um volume de amostra inferior ao especificado, existe um risco acrescido de sinalização ambígua das amostras ou de não transferência da amostra (sinalização inválida). Carregue o volume de amostra correto, tal como descrito na folha de protocolo correspondente e na lista de material de laboratório.
b)	Bolhas e/ou espuma no tubo de amostra	As bolhas ou espuma no tubo de amostra e/ou tubo de entrada de amostra podem resultar na detecção incorreta do nível de líquido e subsequente transferência incompleta de amostras. Remova as bolhas do tubo de amostra.

# Símbolos

Os seguintes símbolos poderão aparecer nas Instruções de utilização ou na embalagem e nos rótulos. Os símbolos adicionais são descritos em Conteúdo do kit (página 9).

Símbolo	Definição do símbolo
	Contém reagentes suficientes para <N> testes Indica o número total de testes IVD que podem ser realizados com o IVD.
	Prazo de validade
	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro
	Marcação CE. Este produto cumpre os requisitos do Regulamento europeu 2017/746 para dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.
	Número de catálogo
	Número de lote
	Número de material (por exemplo, rotulagem do componente)
	Componentes (por exemplo, uma lista do que é incluído)
	Contém (conteúdo)
	Número (por exemplo: frascos)
	Número global de item comercial
Rn	R é a revisão das instruções de utilização (manual) e n é o número da revisão



Limites de temperatura



Fabricante



Consultar as instruções de utilização



Cuidado

**PROTK**

Proteinase K

**WELL**

Número do poço (por exemplo, poço do RC)

**REAG** | **CART**

Cartucho de reagentes

Sodium azide

Azida de sódio

**EC** | **REP**

Representante autorizado europeu de acordo com o Regulamento (UE) 2017/746

## Anexo: Quantificação de ccfDNA

Devido às concentrações muito baixas de ccfDNA em materiais de amostra, não é recomendada a medição de ADN com um espectrofotómetro. Para determinar a concentração de ccfDNA, deve ser utilizado um ensaio de quantificação sensível e preciso baseado em fluorescência ou um ensaio de real-time PCR.

Se for necessário remover partículas magnéticas, aplicar o tubo que contém o ADN num separador magnético adequado (por exemplo, QIAGEN 12-Tube Magnet, n.º de cat. 36912) até que as partículas magnéticas estejam separadas.

Se o ADN estiver em microplacas, aplicar a microplaca num separador magnético adequado (por exemplo, QIAGEN 96-Well Magnet Type A, n.º de cat. 36915) até que as partículas magnéticas estejam separadas. Se não estiver disponível um separador magnético adequado, centrifugue o tubo que contém o ADN durante 1 minuto à velocidade máxima numa microcentrífuga para formar um pellet de todas as partículas magnéticas restantes.

# Informações para encomendas

Produto	Conteúdo	N.º de cat.
<b>PreAnalytiX</b>		
QIASymphony PAXgene Blood ccfDNA Kit (CE-IVD) (192)	Inclui 2 RC, tubos de Proteinase K e acessórios	768566
PAXgene Blood ccfDNA Tubes (CE-IVD)(100)	100 tubos: 16 × 100 mm, 1,5 ml de aditivo, 10 ml de volume de colheita de sangue	768165
<b>QIAGEN</b>		
QIASymphony SP instrument	Módulo de preparação de amostras QIASymphony, 1 ano de garantia em componentes e mão de obra	9001297
<b>Produtos QIAGEN relacionados</b>		
Proteinase K (10 mL)	1 × frasco de 10 ml	19134
Reagent Cartridge Holder (2)	Suporte de RC para utilização com o instrumento QIASymphony SP	997008
Cooling Adapter, 2 mL, v2, Qsym	Adaptador de arrefecimento para os tubos com tampas roscadas de 2 ml. Para utilização com a gaveta "Eluate" (Eluato) do instrumento QIASymphony SP	9020674
Cooling Adapter, EMT, v2, Qsym	Adaptador de arrefecimento para os suportes EMT. Para utilização com a gaveta "Eluate" (Eluato) do instrumento QIASymphony SP	9020730
Cooling Adapter, Snap-Cap Microtube QIASymphony, Qsym	Adaptador de arrefecimento para tubos Eppendorf® LoBind Snap Cap Safe-Lock de 1,5 ml. Para utilização com a gaveta "Eluate" (Eluato) do instrumento QIASymphony SP	9020731
Sample Prep Cartridges, 8-well (336)	Cartuchos de preparação de amostras de 8 poços para utilização com o instrumento QIASymphony SP	997002

Produto	Conteúdo	N.º de cat.
8-Rod Covers (144)	8-Rod Covers para utilização com o instrumento QIASymphony SP	997004
Filter-Tips, 200 µL (1024)	Pontas com filtro descartáveis, em suporte; (8 × 128). Para utilização com o QIAcube® e os instrumentos QIASymphony SP/AS	990332
Filter-Tips, 1500 µL, Qsym SP (1024)	Pontas com filtro descartáveis, em suporte; (8 × 128). Para utilização com os instrumentos QIASymphony SP/AS	997024
Tip Disposal Bags (15)	Sacos de eliminação de pontas para utilização com o instrumento QIASymphony SP	9013395
12-Tube Magnet	Ímã para a separação de partículas magnéticas em 12 tubos × 1,5 ml ou 2 ml	36912
96-Well Magnet Type A	Ímã para a separação de partículas magnéticas em poços de placas de 96 poços, 2 × microplacas FB de 96 poços	36915
Reuse Seal Set (20)	Conjuntos de vedantes reutilizáveis para selar RC QIASymphony parcialmente usados	997006
Elution Microtubes CL (24 × 96)	Tubos de polipropileno não esterilizados (0,85 ml de capacidade máxima, menos de 0,7 ml de capacidade de armazenamento, 0,4 ml de capacidade de eluição); 2304 em suportes de 96; inclui tiras de tampas	19588
Caps for Elution Microtubes (50 × 8)	Tampas para microtubos de eluição (50 × 8)	19591
14 mL Falcon Tube	Tubo com base redonda em poliestireno 17 × 100 mm utilizado como transportador de amostras para o instrumento QIASymphony SP	Corning, 352051

# Histórico de revisões do documento

Revisão	Descrição
R1, maio de 2021	Versão inicial
R2, maio de 2022	Remoção de "(CE-IVD)" em certas ocorrências. Atualização da tabela do conteúdo do kit. Inclusão de <a href="http://www.PreAnalytiX.com">www.PreAnalytiX.com</a> como ligação para encontrar os respectivos recursos. Especificação de "espécimes" como "espécimes de sangue" na seção Informações de segurança. Alteração de "Elimine os resíduos de amostras e dos ensaios" para "Elimine os materiais biológicos perigosos e os resíduos dos kits" na seção Informações de segurança. Atualização das seções "A) Preparação do plasma a partir de sangue para protocolos padrão" e "B) Preparação do plasma a partir de sangue para manuseamento do tubo primário no instrumento QIA Symphony SP".
R3, fevereiro de 2023	Endereço postal da PreAnalytiX GmbH alterado de "Feldbachstrasse" para "Garstligweg 8". Seção Precauções atualizada. Informações de emergência adicionadas à seção Informações de segurança. Número de catálogo de Proteinase K (100 ml) atualizado em Informações para encomendas. Alterações de composição e edição.

## Notas

## Notas



Para obter informações de licenciamento atualizadas e renúncias de responsabilidades específicas do produto, consulte o manual do utilizador ou o manual do PreAnalytiX® ou QIAGEN® respetivo. Os manuais do utilizador e os manuais dos kits PreAnalytiX e QIAGEN estão disponíveis em [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com) ou podem ser solicitados aos Serviços de Assistência da QIAGEN ou ao seu distribuidor local.

Explore mais em: [www.PreAnalytiX.com](http://www.PreAnalytiX.com)

HB-2866-003 02/2023



A QIAGEN / BD Company